CAMLOG®
SYSTEM

Catalogo prodotti
Sistema implantare CAMLOG®

Valido a partire da maggio 2024

biohorizons camlog

Indice

Servizi

Evidenze cliniche e fondamenti scientifici 2

Informazioni sul sistema

Il sistema implantare CAMLOG® 3

Chirurgia

Pianificazione 18
PROGRESSIVE-LINE Impianti e strumenti 20
PROGRESSIVE-LINE Guide System Strumenti 26
PROGRESSIVE-LINE Flex Strumenti 33
SCREW-LINE Impianti e strumenti 37
SCREW-LINE Guide System Strumenti 45
Strumenti chirurgici generali 48
SCREW-LINE Set per osteotomia 54
Viti tappo 59
Cappette di guarigione 59

Tecnica protesica

Scanbody 64
Presa d'impronta 65
Registrazione del morso 66
Realizzazione del modello 67
Abutment provvisori 68
Basi in titanio CAD/CAM 69
Basi in titanio CAD/CAM free 70
CAM Blank 71
Abutment Esthomic® 73
Abutment universali 75
Abutment in oro-resina 75
COMFOUR® 76
Pilastro a sfera 81
Locator® 82
Locator R-Tx® 84
Ricostruzione a doppia corona 86
Viti per abutment e da laboratorio 87
Strumenti protesici 88
Strumenti odontotecnici 91
Selezione dell'abutment 92

Articoli aggiuntivi

Impianti per esercitazione 94
Applicatore 94
Modelli dimostrativi 95
Macromodelli 95
Letteratura 96

Informazioni aggiuntive

Prospetto delle indicazioni 98
Panoramica degli impianti 100
Prospetto dei componenti protesici 101
Prospetto delle viti 110
Prospetto dei torque di serraggio 114
Materiali 118

Documentazione supplementare

Documentazione supplementare 121
Note legali 121

Evidenze cliniche e fondamenti scientifici

Camlog ha imposto fin dall'inizio standard elevati per la documentazione scientifica di tutte le caratteristiche fondamentali dei propri sistemi implantari.

Nel documento **Evidenze cliniche e fondamenti scientifici** abbiamo sintetizzato l'attuale stato dell'arte della ricerca sui sistemi implantari Camlog.

Siamo lieti di poter offrire queste pillole di conoscenza ai nostri clienti. La versione cartacea del documento è disponibile su richiesta.

E-book

Il sistema implantare CAMLOG®

Il sistema implantare CAMLOG® si basa su una pluriennale esperienza clinica e di laboratorio e si caratterizza per la sua facilità d'uso e la sua versatilità protesica.

Tutti i prodotti CAMLOG® vengono fabbricati secondo il più recente stato dell'arte. Il sistema implantare CAMLOG® viene costantemente perfezionato dal team di ricerca e sviluppo interno all'azienda in collaborazione con cliniche, università e odontotecnici, quindi continuamente allineato alle ultime tecnologie.

I sistemi implantari CAMLOG® e CONELOG® sono documentati in modo ottimale a livello scientifico. Lo dimostrano studi* riguardanti i più svariati parametri, come ad esempio la superficie dell'impianto, la procedura di inserimento e/o del carico dell'impianto, la stabilità primaria e il design della connessione.

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 121

Impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE

Gli impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE consentono di realizzare più facilmente moderni concetti di trattamento come la protesizzazione immediata o il carico immediato, che richiedono un'elevata stabilità primaria.[1, 2*]

La geometria dell'impianto mira di conseguenza ad ottenere un'elevata stabilità iniziale:
- L'impianto a vite automaschiante presenta una parte apicale conica, che consente di ottenere un'eccellente stabilità primaria anche in presenza di osso morbido.[1, 2*]
- Filettatura estesa fino all'apice per un efficace ancoraggio in interventi di impianto immediato.[1, 2*]
- Filettatura crestale per una migliore tenuta in presenza di altezza ossea residua limitata.[2*]

Gli impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE sono disponibili con la superficie Promote® plus, che presenta una parte macchinata del collo dell'impianto di un'altezza pari a 0.4 mm. In base alla situazione clinica, questa configurazione superficiale consente di ottenere un posizionamento dell'impianto epicrestale o leggermente sopracrestale.

Gli impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE con applicatore avvitato possono essere utilizzati per procedure di chirurgia guidata.

Gli impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE sono dotati della comprovata connessione impianto-abutment Tube-in-Tube® e presentano tre scanalature quadrate disposte simmetricamente nella parte cilindrica del collo dell'impianto. La ricostruzione protesica viene eseguita con gli abutment CAMLOG®, in via opzionale anche con componenti per Platform Switching.

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 121

Promote® plus

Diametro dell'impianto

3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm

Lunghezze dell'impianto

9 mm | 11 mm | 13 mm | 16 mm

Superficie Promote®

Gli impianti CAMLOG® sono disponibili con la superficie Promote® sabbiata e mordenzata con acido. La superficie risponde agli attuali requisiti in campo scientifico e favorisce una rapida osteointegrazione. I risultati scientifici di indagini con colture cellulari, istologia ossea e prove di estrazione confermano queste straordinarie caratteristiche.[3*]

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 121

Impianti CAMLOG® SCREW-LINE

Gli impianti CAMLOG® SCREW-LINE sono impianti a vite leggermente conici con filettatura automaschiante. Consentono un facile inserimento grazie all'auto-centratura e al contatto uniforme con l'osso, garantendo un'elevata stabilità primaria.

Gli impianti CAMLOG® SCREW-LINE sono disponibili sia con superficie Promote® (parte macchinata del collo dell'impianto di 1.4 mm) che con superficie Promote® plus (parte macchinata del collo dell'impianto di 0.4 mm), quindi consentono la massima flessibilità nella determinazione della posizione verticale dell'impianto. L'arrotondamento della geometria apicale garantisce un inserimento conservativo degli impianti CAMLOG® SCREW-LINE nell'osso, anche in prossimità del seno mascellare.

Gli impianti CAMLOG® SCREW-LINE con applicatore avvitato possono essere utilizzati per procedure di chirurgia guidata.

Gli impianti CAMLOG® SCREW-LINE sono dotati della comprovata connessione impianto-abutment Tube-in-Tube® e presentano tre scanalature quadrate disposte simmetricamente nella parte cilindrica del collo dell'impianto.
La ricostruzione protesica viene eseguita con gli abutment CAMLOG®, in via opzionale anche con componenti per Platform Switching.

Diametro dell'impianto

3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm | 6.0 mm

Lunghezze dell'impianto

9 mm	11 mm	13 mm	16 mm

Tutti gli impianti CAMLOG® vengono forniti in confezione sterile, pre-montati su un applicatore con codifica di colore in base al diametro dell'impianto.
L'opzione del Platform Switching è possibile esclusivamente utilizzando gli impianti CAMLOG® con codice articolo K.

Gli applicatori degli impianti CAMLOG®

Gli impianti PROGRESSIVE-LINE e SCREW-LINE sono disponibili rispettivamente con due varianti di applicatore. Gli strumenti necessari per inserire l'impianto sono gli stessi indipendentemente dalla variante di applicatore prescelta. Per la chirurgia guidata non sono necessari strumenti separati.

- Parte di trasferimento pre-montata – applicazione e trasferimento semplificati nel cavo orale del paziente
- Diametro piccolo – accesso facilitato negli spazi interdentali e nella regione posteriore
- Applicatore codificato per colore in base al diametro dell'impianto – facile orientamento durante l'intervento
- Utilizzo come perno parallelizzatore – per allineare la posizione di più impianti

Adattatore di rimozione –
una misura per tutti i diametri





Applicatore innestato (snap-in)

- Applicatore standard: facile rimozione dopo l'inserimento dell'impianto
- Il punto di rottura prestabilito protegge la connessione dell'impianto dall'eccessiva sollecitazione
- Adattatore di rimozione per rimuovere l'impianto dopo la rottura dell'applicatore nel punto di rottura prestabilito

Applicatore avvitato (screw-mounted)

- Per la chirurgia guidata (Guide)
- Fissaggio con l'impianto tramite una vite: consente adattamenti verticali della posizione dell'impianto nel sito implantare

Connessione impianto-abutment CAMLOG® Tube-in-Tube®

L'inconfondibile principio Tube-in-Tube® con tre scanalature e tre camme a incastro crea una connessione impianto-abutment molto precisa, stabile e anti-rotazionale. Questa connessione è frutto di una progettazione biomeccanica basata su accurate analisi agli elementi finiti. Continua a dimostrare da diversi anni la sua validità in milioni di applicazioni e il suo successo duraturo è ben documentato a livello scientifico.

La connessione CAMLOG® Tube-in-Tube® è stata oggetto di estesi studi scientifici e vanta risultati superiori alla media in termini di precisione.[4,5*]

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 121

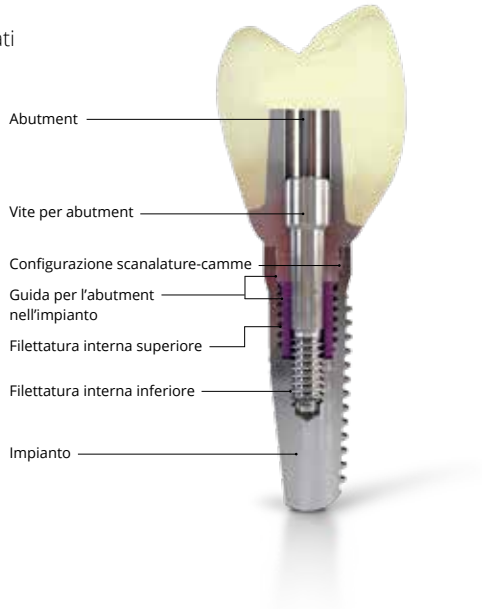

Tutti i vantaggi della connessione Tube-in-Tube®

- Facile indicizzazione grazie alle tre possibili posizioni degli abutment
- Posizionamento preciso con eccellente riscontro tattile
- Platform matching e Platform Switching
- Stop verticale predefinito: nessuno sfasamento in altezza nell'intero flusso di lavoro
- Risultati a lungo termine scientificamente documentati

Per un posizionamento ottimale dell'abutment, l'impianto deve essere inserito nell'osso in modo che una delle tre scanalature sia orientata in direzione vestibolare. Per quanto riguarda gli impianti CAMLOG®, gli inseritori sono provvisti di apposite tacche corrispondenti alle tre scanalature della configurazione interna dell'impianto.

Componenti protesici CAMLOG®

Per la protesizzazione degli impianti CAMLOG® è disponibile un'ampia gamma di componenti protesici versatili e ottimizzati dal punto di vista anatomico. Gli abutment CAMLOG® sono codificati per colore in base al diametro dell'impianto.

Geometria a camme corte

Abutment CAMLOG® con codice articolo K

Nella parte apicale gli abutment sono allungati a forma tubolare (5.4 mm) e, nella parte superiore, presentano tre camme corte corrispondenti alle tre scanalature dell'impianto.

Durante l'inserimento, l'allungamento a forma tubolare nella parte apicale degli abutment ne garantisce il facile, rapido e sicuro orientamento secondo l'asse longitudinale dell'impianto, prima che le tre camme appoggino sulla spalla dell'impianto. Successivamente, si ruota l'abutment finché le camme non si incastrano percettibilmente nelle scanalature dell'impianto, scivolando in posizione finale.

La connessione impianto-abutment presente nel sistema implantare CAMLOG® è una connessione prevalentemente ad accoppiamento geometrico. Tale connessione con geometria a camme è stata ottimizzata a livello biomeccanico sulla base di accurate analisi agli elementi finiti.

La figura sottostante mostra la distribuzione della tensione Von Mises nella connessione impianto-abutment a fronte di un carico di 200 N secondo la norma ISO 14801.

Cappette di guarigione CAMLOG®

Le diverse cappette di guarigione vengono impiegate per procedure in uno o due tempi in base all'indicazione. Le cappette di guarigione CAMLOG® sono disponibili in tre geometrie (cilindrica, wide body e bottleneck). Sono provviste di una protezione anti-rotazione e vengono avvitate nella filettatura interna superiore degli impianti.

Presa d'impronta CAMLOG®

La presa d'impronta dell'impianto CAMLOG® può essere effettuata con transfer da impronta per porta-impronte forato o chiuso. I transfer da impronta CAMLOG® sono codificati per colore in base al diametro dell'impianto, hanno un profilo d'emergenza formalmente congruente con le cappette di guarigione e sono forniti sterili. I componenti ultraprecisi assicurano il corretto trasferimento delle caratteristiche anatomiche intraorali. La protezione anti-rotazione è garantita dalla configurazione scanalature-camme CAMLOG®.

Abutment provvisori CAMLOG®

Sono disponibili per il sistema implantare CAMLOG® vari tipi di abutment per realizzare una ricostruzione protesica provvisoria. Gli abutment provvisori CAMLOG® in lega di titanio (Ti-6Al-4V ELI) sono disponibili nelle versioni per corona e per ponte.

Se si desidera, è possibile realizzare una ricostruzione provvisoria su impianti CAMLOG® anche utilizzando abutment provvisori in PEEK (poli-etere-etere-chetone). Gli abutment possono essere utilizzati sia per un impianto immediato sia in seguito ad esposizione della gengiva.

Abutment CAMLOG® Esthomic®

Gli abutment anatomici consentono una realizzazione ottimale del moncone. Gli abutment CAMLOG® Esthomic® sono disponibili sia in versione diritta che angolata, in diverse altezze gengivali, con profilo della spalla anatomico, di forma ovale. Gli abutment Esthomic® angolati sono disponibili nelle varianti A e B, che si differenziano per una disposizione delle camme sfalsata di 60°. Si ottengono in tal modo sei diverse posizioni di rotazione per un orientamento assiale protesico ottimale.

Orientamento delle camme dell'abutment CAMLOG® Esthomic®

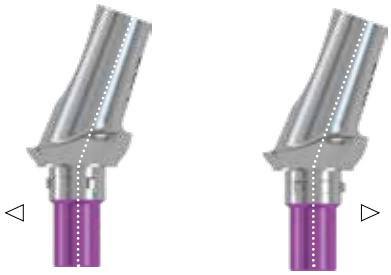

Tipo A
Orientamento delle camme opposto all'angolazione

Tipo B
Orientamento delle camme in direzione dell'angolazione

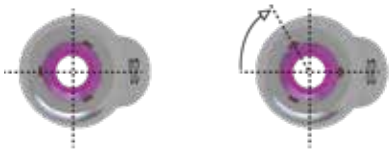

Tipo A

Tipo B
Camme sfasate di 60°

Basi in titanio CAD/CAM CAMLOG® e basi in titanio CAMLOG® CAD/CAM free

Le basi in titanio CAD/CAM CAMLOG® e le basi in titanio CAMLOG® CAD/CAM free fungono da basi adesive per protesi su impianti personalizzate realizzate con adeguati materiali. Le ricostruzioni sono realizzate con l'ausilio di tecniche CAD/CAM. Le basi in titanio CAD/CAM CAMLOG® sono disponibili nelle versioni per corona e per ponte. Le basi in titanio CAMLOG® CAD/CAM free per il canale della vite angolato sono disponibili nella versione per corona in due altezze del camino.

Abutment universali e telescopici CAMLOG®

Gli abutment universali e telescopici CAMLOG® possono essere utilizzati per realizzare in modo personalizzato ricostruzioni a ponte e a corona e ricostruzioni a doppia corona cementabili. Gli abutment sono prodotti in lega di titanio e possono essere lavorati in modo personalizzato.

Pilastri a sfera, pilastri Locator® e pilastri a barra diritti CAMLOG®

Per il sistema implantare CAMLOG® sono disponibili pilastri a sfera, pilastri Locator® e pilastri a barra diritti. Questi pilastri si distinguono dagli abutment con vite per abutment per i diversi design della connessione nella parte apicale. I pilastri a sfera, pilastri Locator® e pilastri a barra diritti sono componenti monopezzo, provvisti nella parte apicale di una filettatura che si incastra nella filettatura interna dell'impianto CAMLOG®. Questi pilastri vengono avvitati nell'impianto CAMLOG® mediante i corrispondenti inseritori.

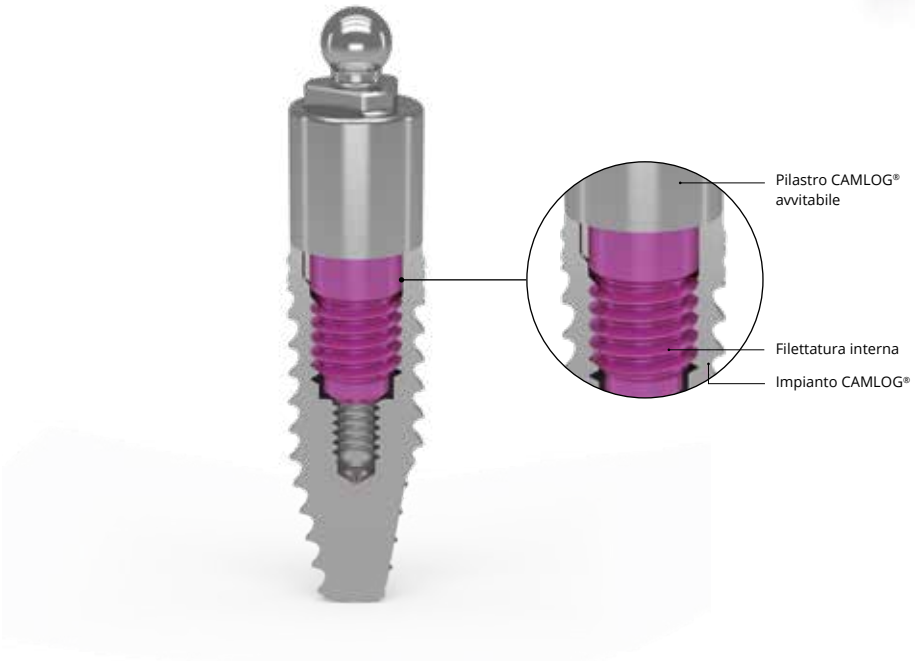

Esempio: pilastro a sfera CAMLOG® (Ø 4.3 mm) in un impianto CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE

Effetto dell'opzione Platform Switching

Il Platform Switching (PS) assicura supporto ai tessuti duri e molli nella regione estetica peri-implantare. La distanza tra l'interfaccia impianto-abutment e la cresta alveolare deve essere aumentata per ridurre l'effetto dell'infiltrazione di cellule infiammatorie sul riassorbimento osseo. L'opzione del Platform Switching è possibile esclusivamente utilizzando gli impianti CAMLOG® con codice articolo K.

Scegliendo l'opzione Platform Switching e quindi utilizzando i componenti PS, si prepara in maniera ottimale il tessuto molle in tutte le fasi di trattamento ad un profilo d'emergenza estetico.

- Cappetta di guarigione CAMLOG® PS (cilindrica, wide body, bottleneck)
- Transfer da impronta CAMLOG® PS, porta-impronte forato e chiuso
- Abutment provvisori CAMLOG® PS
- Basi in titanio CAD/CAM CAMLOG® PS
- Basi in titanio CAMLOG® CAD/CAM free PS
- Abutment CAMLOG® Esthomic® PS
- Abutment universali CAMLOG® PS

Sistema COMFOUR®

Le ricostruzioni avvitate in senso occlusale sono realizzate allo stato dell'arte. Grazie al sistema COMFOUR®, i pazienti edentuli possono contare su ricostruzioni fisse, confortevoli e subito disponibili, di norma su quattro o sei impianti, e quindi su un considerevole valore aggiunto in termini di qualità della vita. Ma anche gli operatori possono contare su un comfort e una libertà di azione di livello notevolmente superiore. Il sistema COMFOUR® permette di attuare contemporaneamente più concetti di trattamento. Oltre a corone e ponti avvitati in senso occlusale per ricostruzioni immediate e tardive, questo sistema versatile consente di realizzare anche ricostruzioni a barra su pilastri a barra diritti e angolati. Il sistema COMFOUR® offre una gamma completa di opzioni per gestire in futuro più facilmente e in minor tempo qualsiasi tipo di sfida nella prassi quotidiana. Oltre che per la sua versatilità, il sistema protesico COMFOUR® convince soprattutto per il suo design sottile.

Tutti i componenti presentano una struttura sottile e un'altezza ribassata, semplificando considerevolmente la ricostruzione implanto-protesica agli odontoiatri e agli odontotecnici. Inoltre, i numerosi highlight tecnici fanno sì che COMFOUR® non sia solo un nome, ma un vero e proprio programma, tanto per gli operatori quanto per i pazienti.

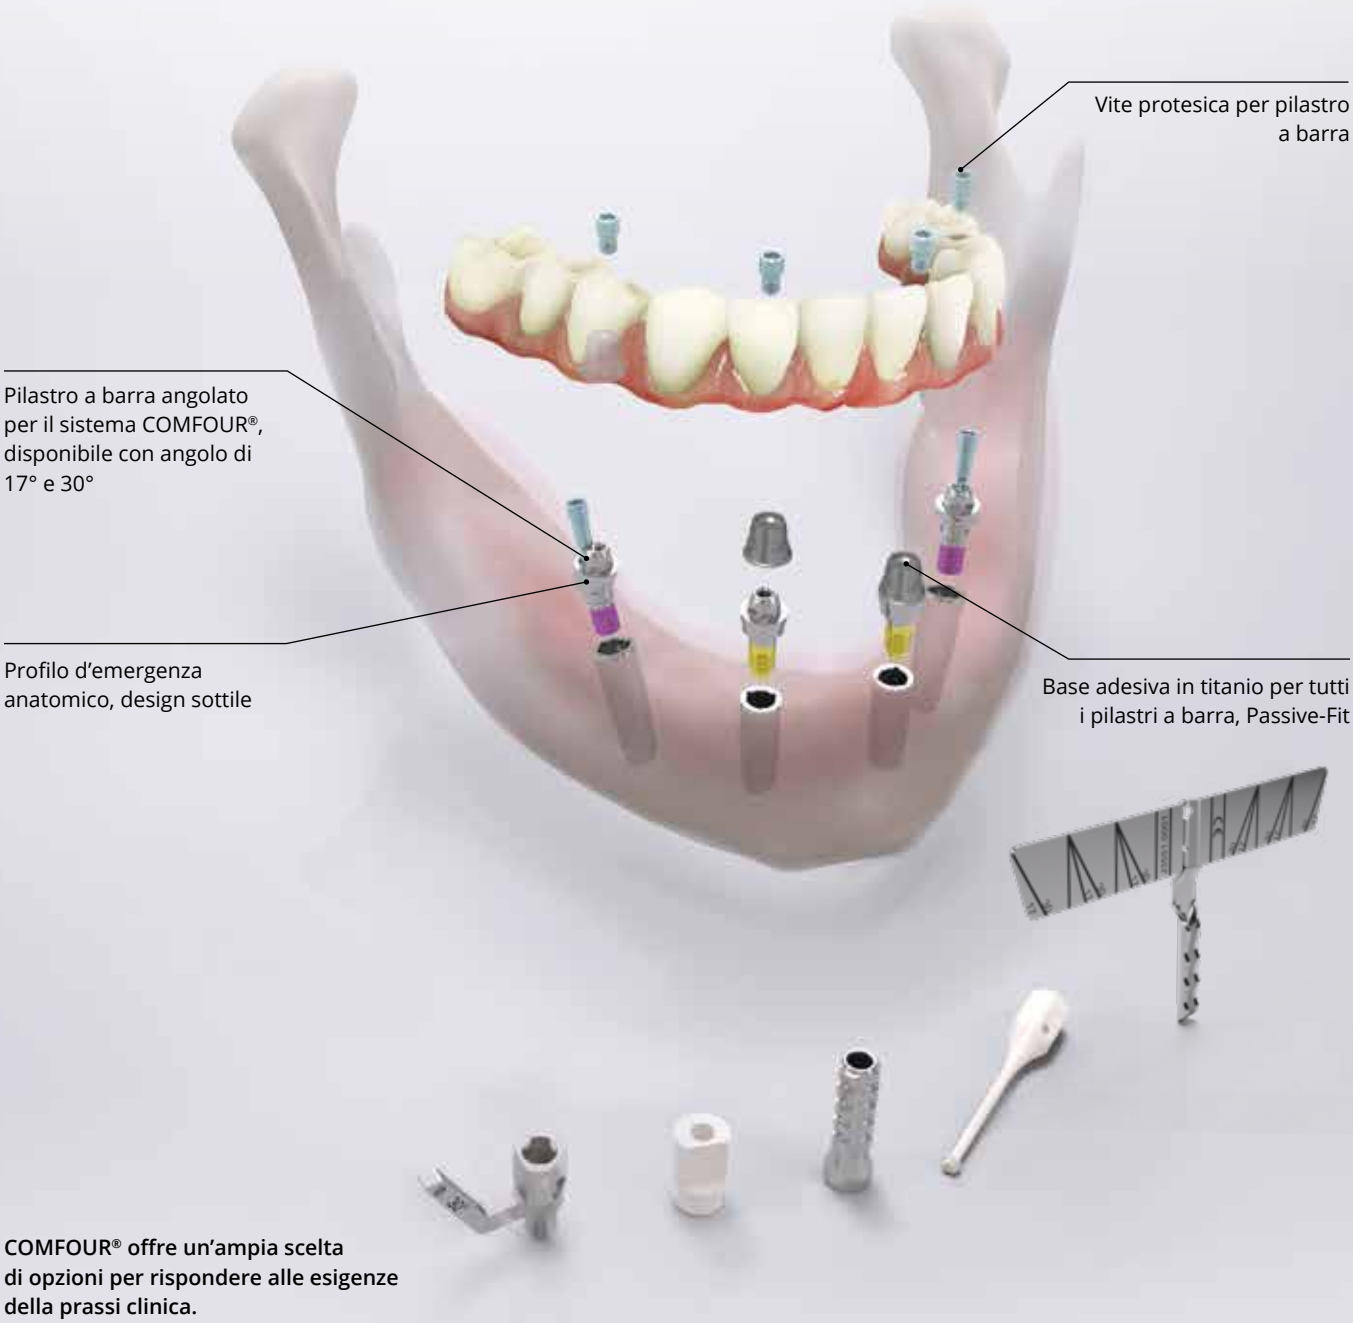

COMFOUR® offre un'ampia scelta di opzioni per rispondere alle esigenze della prassi clinica.

Servizi CAD/CAM

Grazie alla collaborazione con il proprio partner di servizio CAD/CAM DEDICAM®, Camlog offre componenti protesici, cappette di guarigione e transfer da impronta personalizzati realizzati con la tecnica CAD/CAM, servizi di scansione e progettazione, pianificazione di impianti in 3D, guide di fresaggio stampate e modelli mascellari e mandibolari.

L'assistenza personalizzata basata sulla consueta competenza dei nostri collaboratori e i processi ottimizzati nei minimi dettagli garantiscono un'elevata sicurezza dei risultati e al tempo stesso la massima libertà individuale.

Per la realizzazione di restauri su impianti sono disponibili estese librerie per i sistemi CAD aperti di 3Shape, exocad e Dental Wings.

DEDICAM®
DIGITAL CONCEPTS

Scoprite le possibilità che vi aspettano ed entrate nel futuro digitale con DEDICAM®.

Spiegazione dei simboli

CE	Marcatura CE
CE 0123	Marcatura CE con numero dell'organismo notificato
	Attenersi alle istruzioni per l'uso
	Attenzione! Rispettare le avvertenze
MD	Dispositivo medico
REF	Numero d'ordine
LOT	Numero di lotto
SN	Numero di serie
STERILE R	Sterilizzazione mediante irradiazione
	Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva esterna
	Sistema di barriera sterile singola
NON STERILE	Non sterile
	Data di produzione
	Da utilizzarsi preferibilmente entro
2 STERILIZE	Non risterilizzare
2	Non riutilizzare
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Non esporre alla luce solare diretta
	Limite di temperatura
	Fabbricante
MR	MR Safe* (sicuro per la RM)
MR	MR Conditional (a compatibilità RM condizionata)
	Contiene sostanze pericolose
Rx only	Attenzione: Ai sensi della legislazione federale statunitense questi prodotti possono essere venduti direttamente solo a medici esperti o su loro commissione.

Spiegazione delle abbreviazioni

Ø	Diametro
A Ø	Diametro apicale
G Ø	Diametro gengivale
Ø PP	Diametro della piattaforma protesica
L	Lunghezza
AG	Altezza gengivale
PBT	Polibutilentereftalato
PEEK	Poli-etere-etere-chetone
POM	Poliossimetilene
PPSU	Polifenilsulfone
PS	Platform Switching

Codifica cromatica dei prodotti chirurgici e protesici CAMLOG®

Avvertenze di sicurezza e di natura generale

- Le descrizioni riportate nel presente catalogo prodotti non sono sufficienti per un utilizzo immediato del sistema implantare CAMLOG®.
- Si raccomanda di prevedere un addestramento sull'uso del sistema implantare CAMLOG® da parte di un operatore esperto. I prodotti devono essere utilizzati esclusivamente da dentisti, medici, chirurghi e odontotecnici. Se necessario, Camlog offre corsi e seminari di addestramento sull'uso del sistema.
- Errori metodologici in fase di trattamento possono causare la perdita degli impianti e una notevole atrofizzazione della sostanza ossea peri-implantare.
- Le immagini riportate nel presente documento hanno esclusivamente scopo di riferimento e possono differire dal prodotto reale.

* per componenti DEDICAM® non metallici

Confezione degli impianti PROGRESSIVE-LINE

Imballaggio secondario
Scatola pieghevole sigillata, provvista di etichetta del prodotto con codifica di colore

Confezione dell'impianto (imballaggio primario)
Sigillato, con codifica di colore

Esempio di etichetta del prodotto sulla confezione esterna dell'impianto

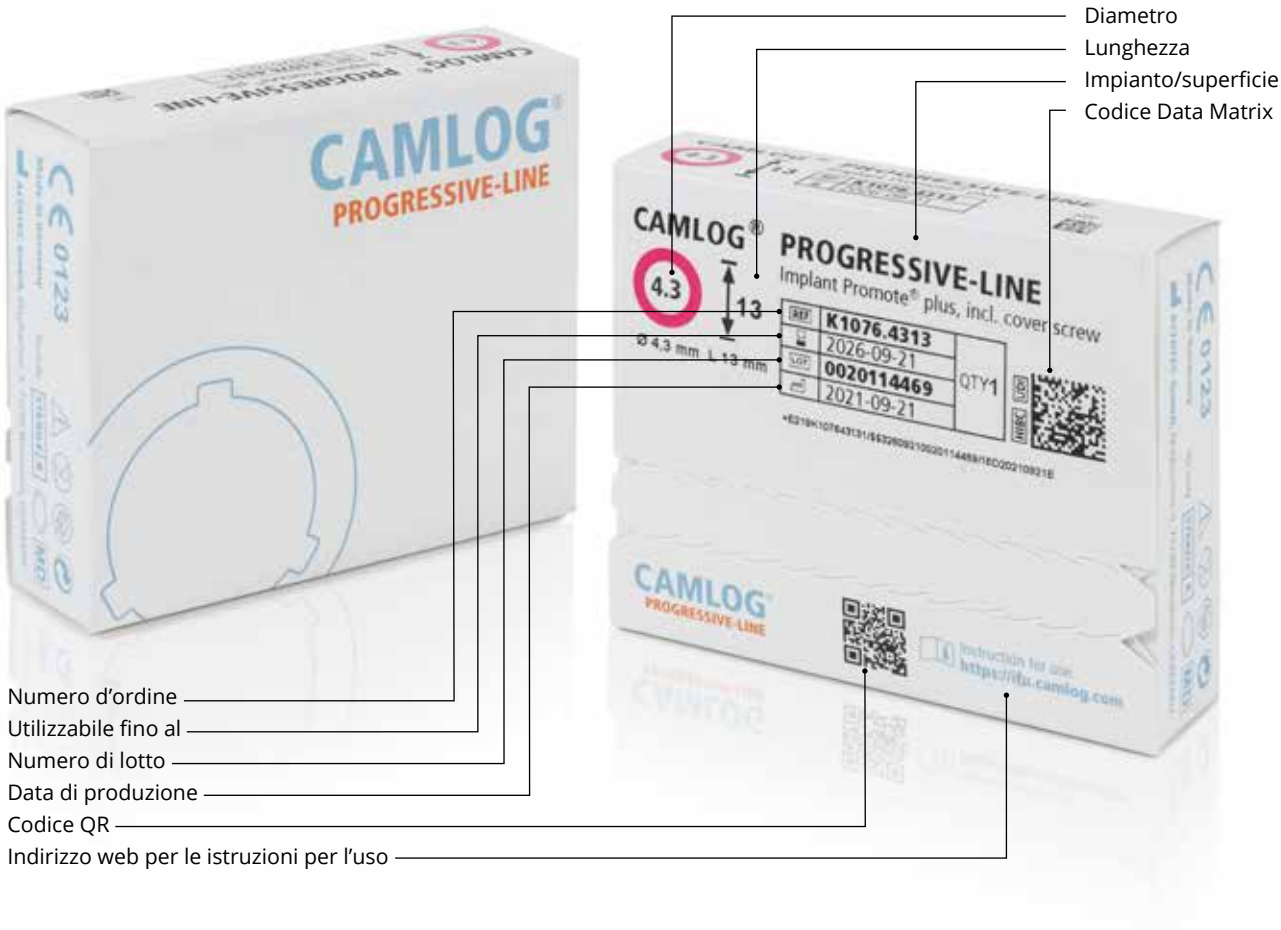

Confezione degli impianti SCREW-LINE

Imballaggio secondario
Scatola pieghevole sigillata, provvista di etichetta del prodotto con codifica di colore

Confezione dell'impianto (imballaggio primario)
Sigillato, con codifica di colore

Esempio di etichetta del prodotto sulla confezione esterna dell'impianto

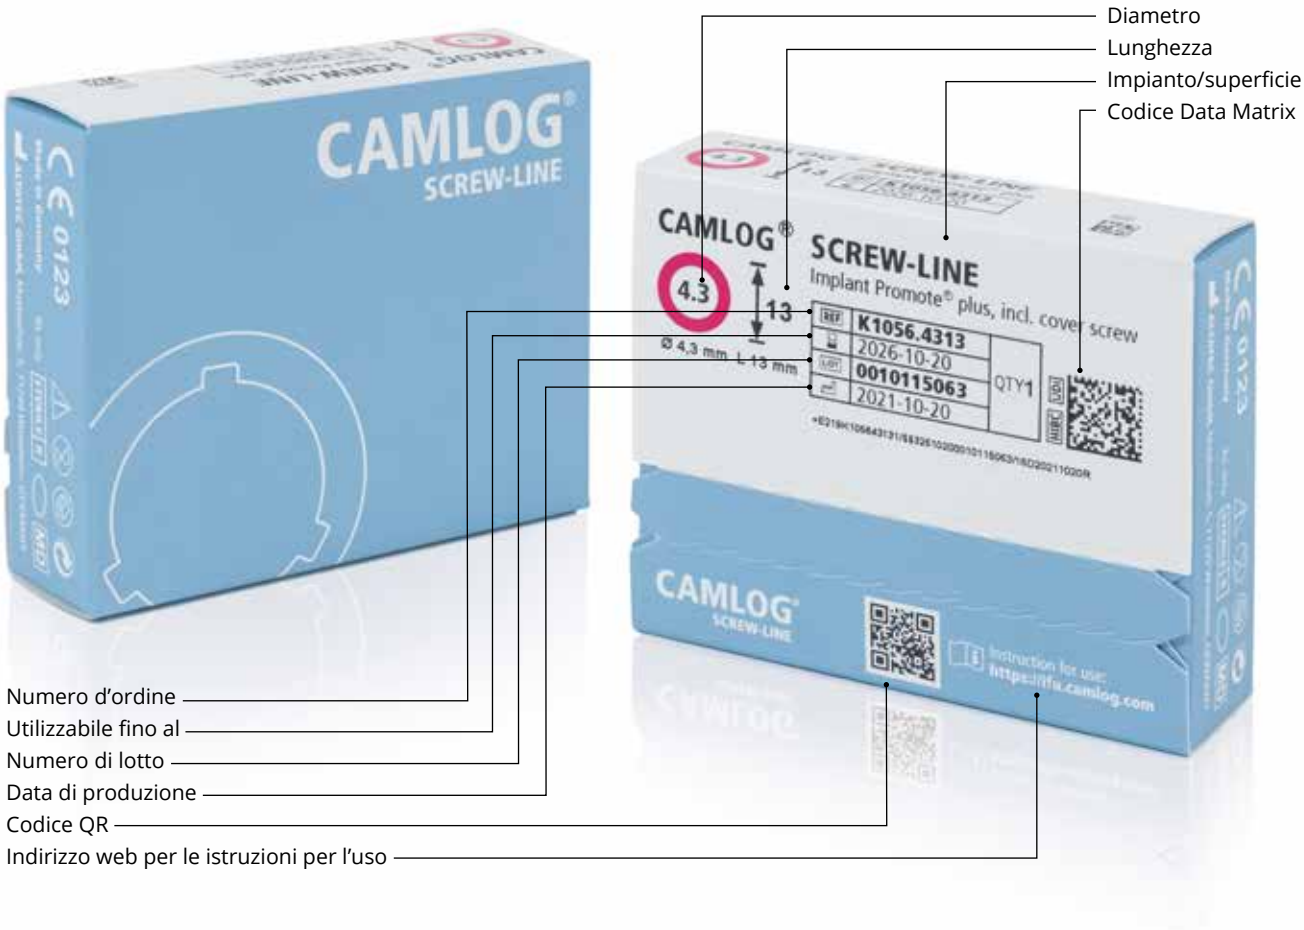

Unità di imballaggio: salvo diversa indicazione, ogni confezione contiene rispettivamente un prodotto.

Direct part marking (marcatura diretta delle parti) – migliore riconoscibilità e tracciabilità

Prossimamente, tutti gli strumenti Camlog recheranno, oltre al numero d'ordine, una stampigliatura con il codice di lotto e/o il codice UDI. Ciò consente a tutto il personale dello studio odontoiatrico di riconoscere e assegnare più facilmente i prodotti. Le immagini inserite nel catalogo non riportano ancora questi dati.

Chirurgia

Pianificazione implantare

	Articolo	Art. n°
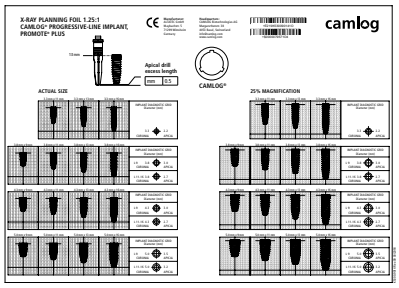	**Pellicola di pianificazione radiografica 1.25:1 Impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE** Ingrandimento 25%	K5300.9014
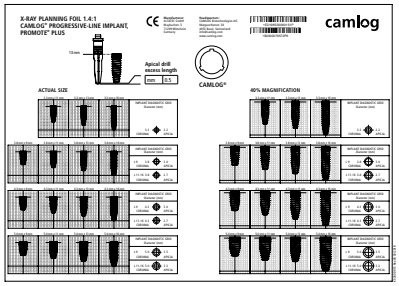	**Pellicola di pianificazione radiografica 1.4:1 Impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE** Ingrandimento 40%	K5300.9015
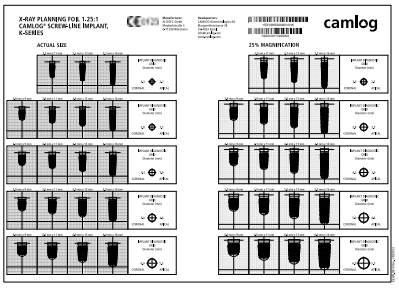	**Pellicola di pianificazione radiografica 1.25:1 Impianti CAMLOG® SCREW-LINE** Ingrandimento 25%	K5300.9010
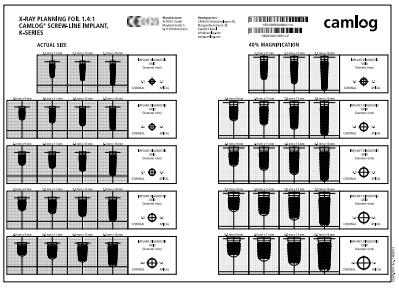	**Pellicola di pianificazione radiografica 1.4:1 Impianti CAMLOG® SCREW-LINE** Ingrandimento 40%	K5300.9011

Pianificazione mediante TC

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø	L
	Dima per TC per fresa Ø 2.0 mm*, dima di fresaggio scanalata Diametro interno 2.1 mm Diametro esterno 2.5 mm **Materiale** Lega di titanio	10	A2002.2000	-	4.0 mm 10.0 mm
	Dima per TC per fresa Ø 2.2 mm, dima di fresaggio scanalata Diametro interno 2.3 mm Diametro esterno 2.7 mm **Materiale** Lega di titanio	10	A2222.2200	-	4.0 mm 10.0 mm
	Fresa per inserire le dime per TC scanalate (per A2002.2000) **Materiale** Acciaio inossidabile	1	A2050.2600	2.6 mm	-
	Fresa per inserire le dime per TC scanalate (per A2222.2200) **Materiale** Acciaio inossidabile	1	A2050.2800	2.8 mm	-

* per fresa pilota J5051.2003 e fresa pilota SCREW-LINE J5051.2000

PROGRESSIVE-LINE

PROGRESSIVE-LINE

Impianti con applicatore innestato

	Articolo	Art. n°	Ø	L	A Ø
	Impianto CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus incl. applicatore innestato e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	K1076.3311	3.3 mm	11 mm	2.2 mm
		K1076.3313		13 mm	
		K1076.3316		16 mm	
		K1076.3809	3.8 mm	9 mm	3.0 mm
		K1076.3811		11 mm	2.7 mm
		K1076.3813		13 mm	
		K1076.3816		16 mm	
		K1076.4309	4.3 mm	9 mm	3.0 mm
		K1076.4311		11 mm	2.7 mm
		K1076.4313		13 mm	
		K1076.4316		16 mm	
		K1076.5009	5.0 mm	9 mm	3.5 mm
		K1076.5011		11 mm	3.2 mm
		K1076.5013		13 mm	
		K1076.5016		16 mm	

Impianti con applicatore avvitato

	Articolo	Art. n°	Ø	L	A Ø
	Impianto CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus incl. applicatore avvitato e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	K1075.3311	3.3 mm	11 mm	2.2 mm
		K1075.3313		13 mm	
		K1075.3316		16 mm	
		K1075.3809	3.8 mm	9 mm	3.0 mm
		K1075.3811		11 mm	2.7 mm
		K1075.3813		13 mm	
		K1075.3816		16 mm	
		K1075.4309	4.3 mm	9 mm	3.0 mm
		K1075.4311		11 mm	2.7 mm
		K1075.4313		13 mm	
		K1075.4316		16 mm	
		K1075.5009	5.0 mm	9 mm	3.5 mm
		K1075.5011		11 mm	3.2 mm
		K1075.5013		13 mm	
		K1075.5016		16 mm	

Gli impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE con Ø 3.8/4.3/5.0 mm consentono l'opzione del Platform-Switching.

Nota
Per l'inserimento dell'impianto protesicamente guidato con il PROGRESSIVE-LINE Guide System si utilizzano gli impianti con applicatore avvitato (Art. n° K1075.xxxx).

PROGRESSIVE-LINE

Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG®

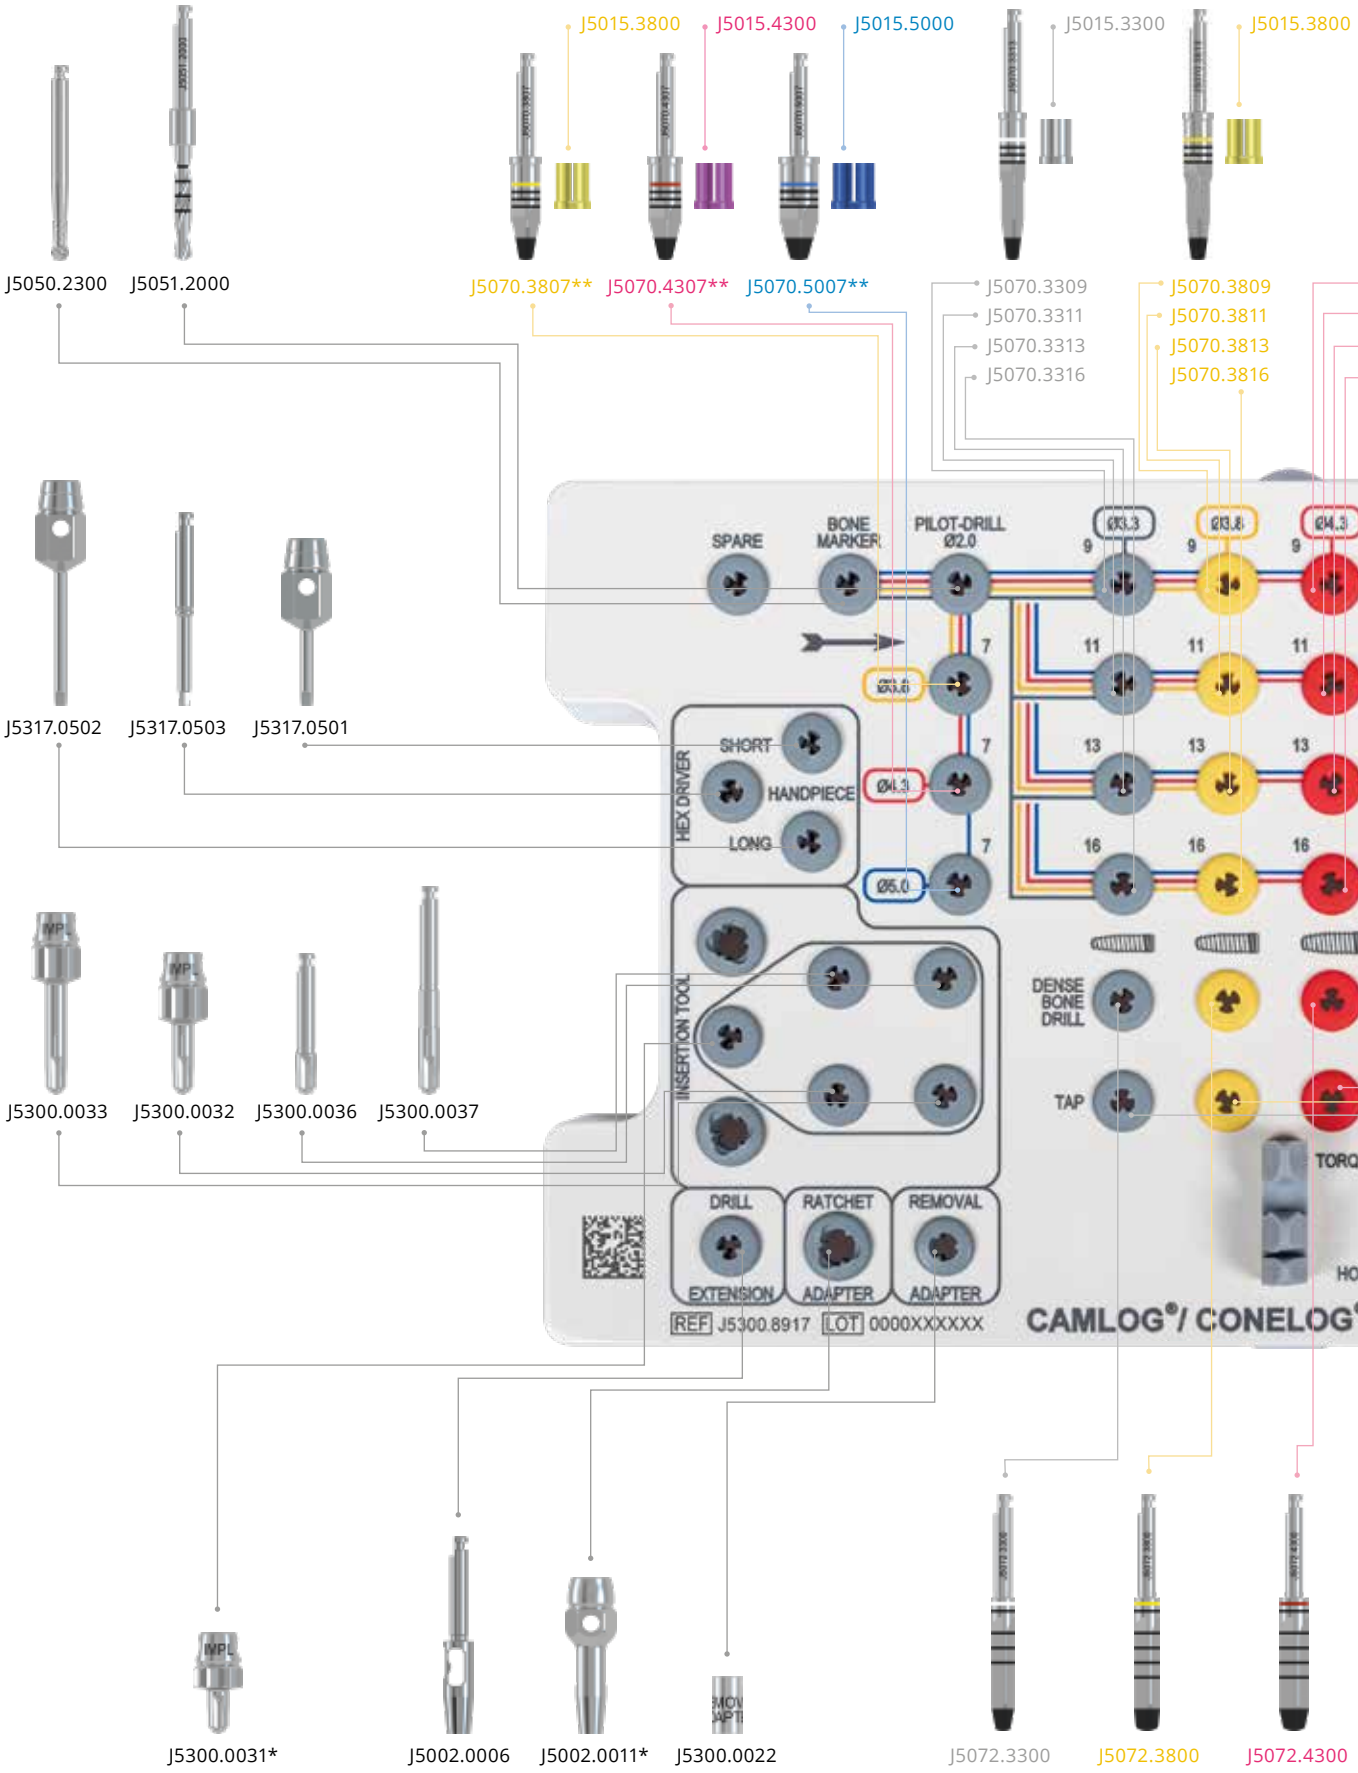

* Questi articoli non sono inclusi nel kit chirurgico e devono essere ordinati separatamente.
** solo per impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE lunghezza 7 mm

Nota

- Le frese sono disposte e/o suddivise nel set in base alle fasi della sequenza del trattamento.
- Le linee colorate evidenziano l'esatta sequenza di utilizzo delle frese.

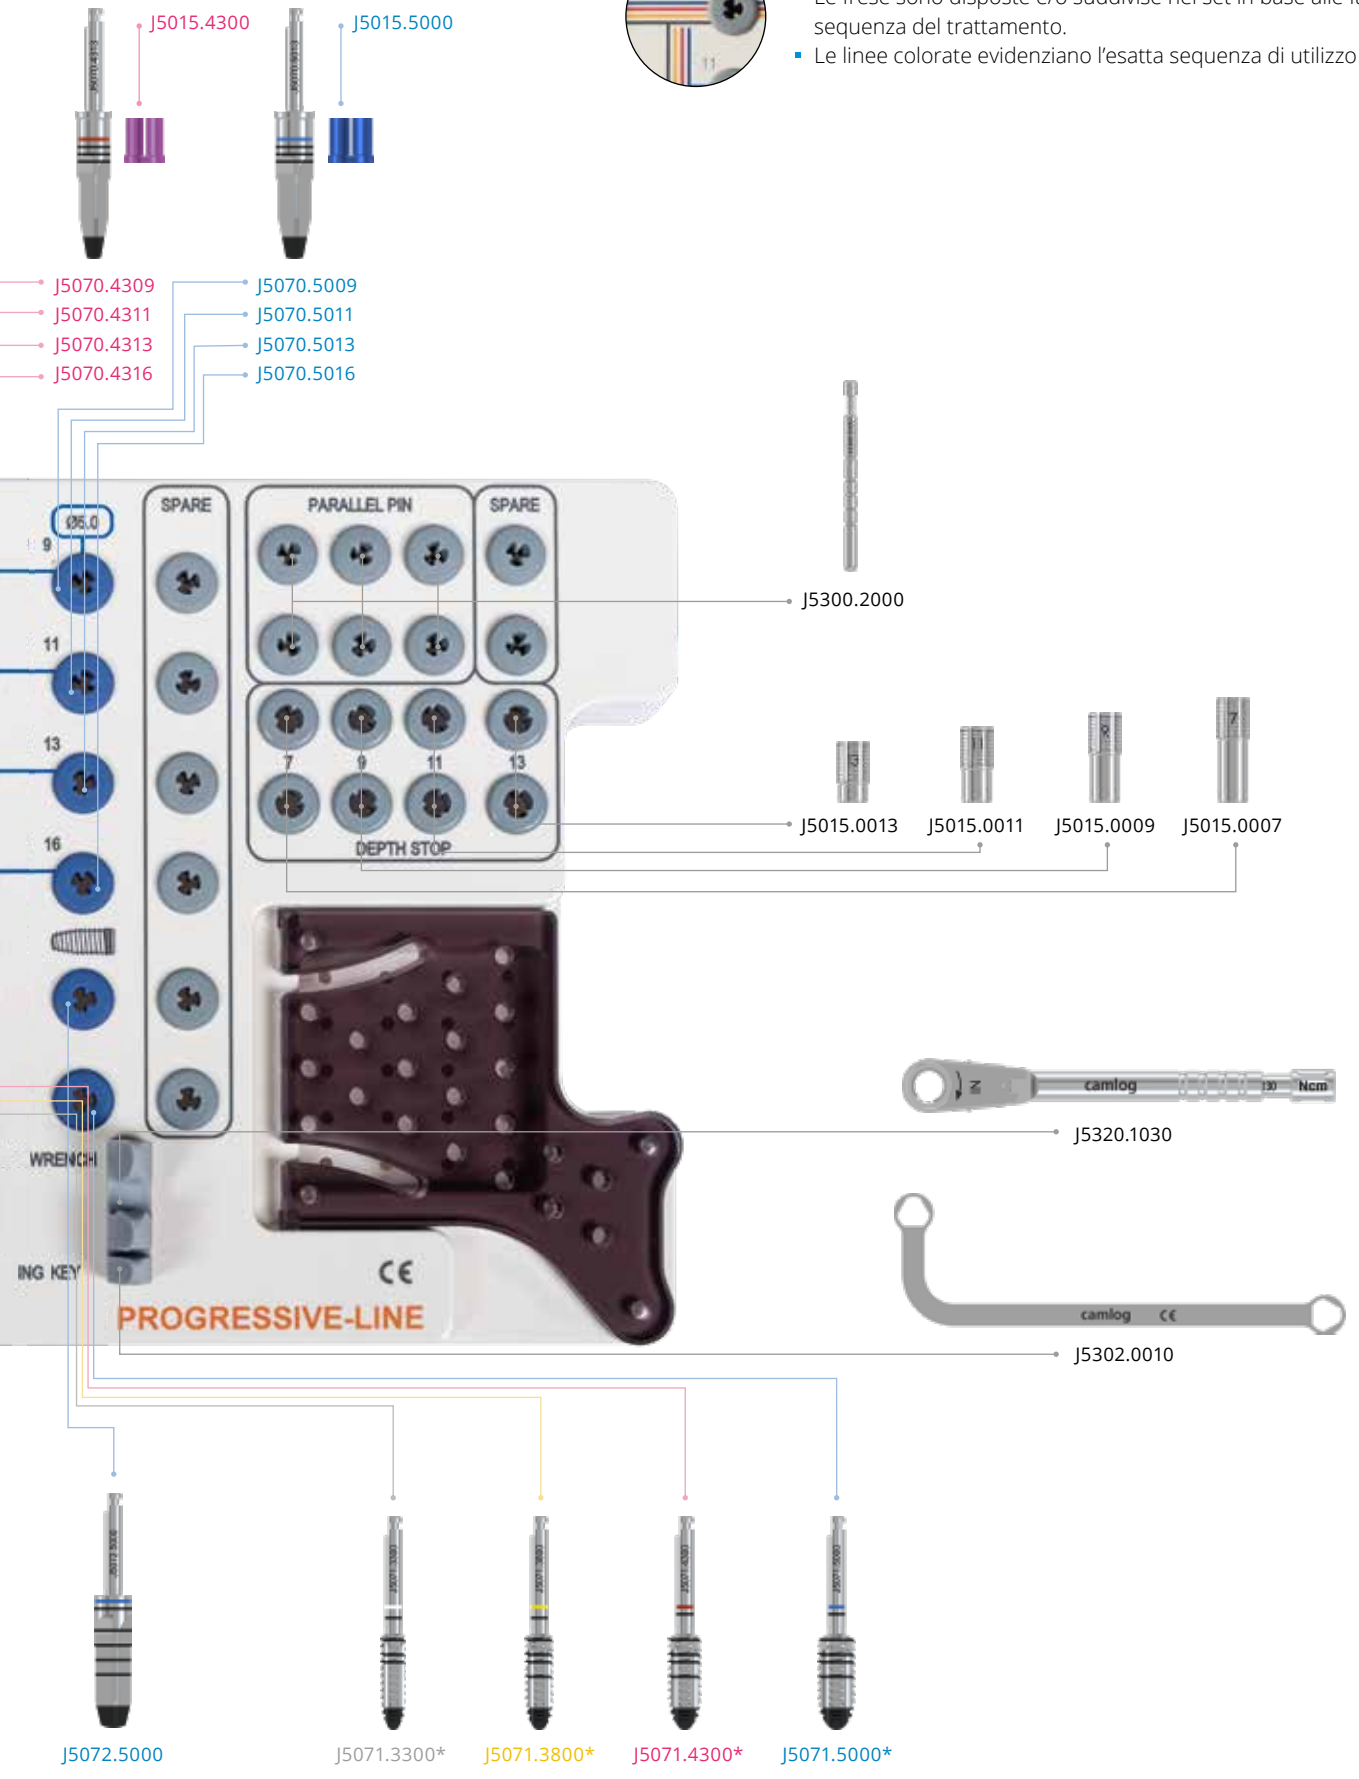

PROGRESSIVE-LINE

Kit chirurgico e wash tray chirurgico

	Articolo	Art. n°
	Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE contiene tutti gli strumenti chirurgici necessari suddivisi per codifica cromatica, comprese la chiave dinamometrica e la chiave ad anello universale (i maschiatori non sono inclusi)	J5300.0065
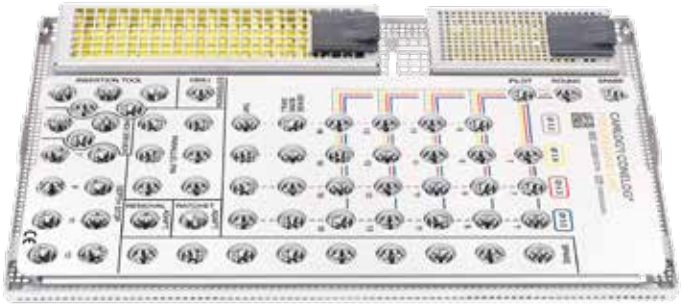	**Wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** incl. mascherina in acciaio, senza contenuto	J5300.8970
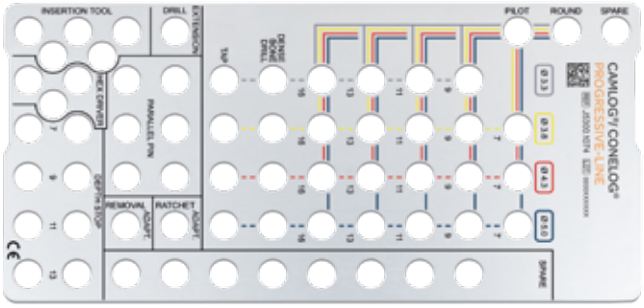	**Mascherina in acciaio per wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** **Materiale** Acciaio inossidabile	J5300.1074

Per la preparazione del sito implantare per gli impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE e gli impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE si utilizzano i medesimi strumenti.

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Fresa a forma PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5070.3309	3.3 mm	9 mm
		J5070.3311		11 mm
		J5070.3313		13 mm
		J5070.3316		16 mm
		J5070.3809	3.8 mm	9 mm
		J5070.3811		11 mm
		J5070.3813		13 mm
		J5070.3816		16 mm
		J5070.4309	4.3 mm	9 mm
		J5070.4311		11 mm
		J5070.4313		13 mm
		J5070.4316		16 mm
		J5070.5009	5.0 mm	9 mm
		J5070.5011		11 mm
		J5070.5013		13 mm
		J5070.5016		16 mm
	Stop di profondità per fresa a forma SCREW-LINE (utilizzabile anche per la fresa a forma PROGRESSIVE-LINE), risterilizzabile **Materiale** Lega di titanio	J5015.3300	3.3 mm	-
		J5015.3800	3.8 mm	
		J5015.4300	4.3 mm	
		J5015.5000	5.0 mm	
	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5072.3300	3.3 mm	-
		J5072.3800	3.8 mm	
		J5072.4300	4.3 mm	
		J5072.5000	5.0 mm	
	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5072.3302	3.3 mm	-
		J5072.3802	3.8 mm	
		J5072.4302	4.3 mm	
		J5072.5002	5.0 mm	
	Maschiatore PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5071.3300	3.3 mm	-
		J5071.3800	3.8 mm	
		J5071.4300	4.3 mm	
		J5071.5000	5.0 mm	
	Perno parallelizzatore con tacche di profondità (per frese pilota Ø 2.0 mm) **Materiale** Lega di titanio	J5300.2000	-	-

PROGRESSIVE-LINE Guide System

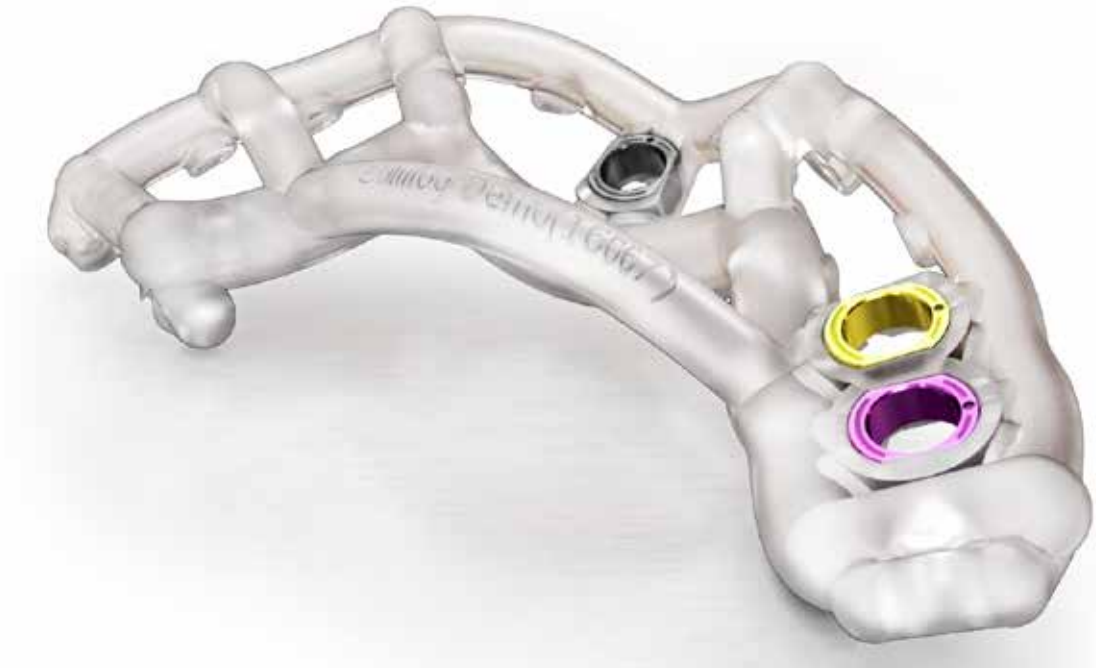

Per la pianificazione di impianti in 3D, la progettazione e la realizzazione di guide di fresaggio è possibile rivolgersi al nostro partner di servizio CAD/CAM DEDICAM®.
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

PROGRESSIVE-LINE Guide System

Tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG®

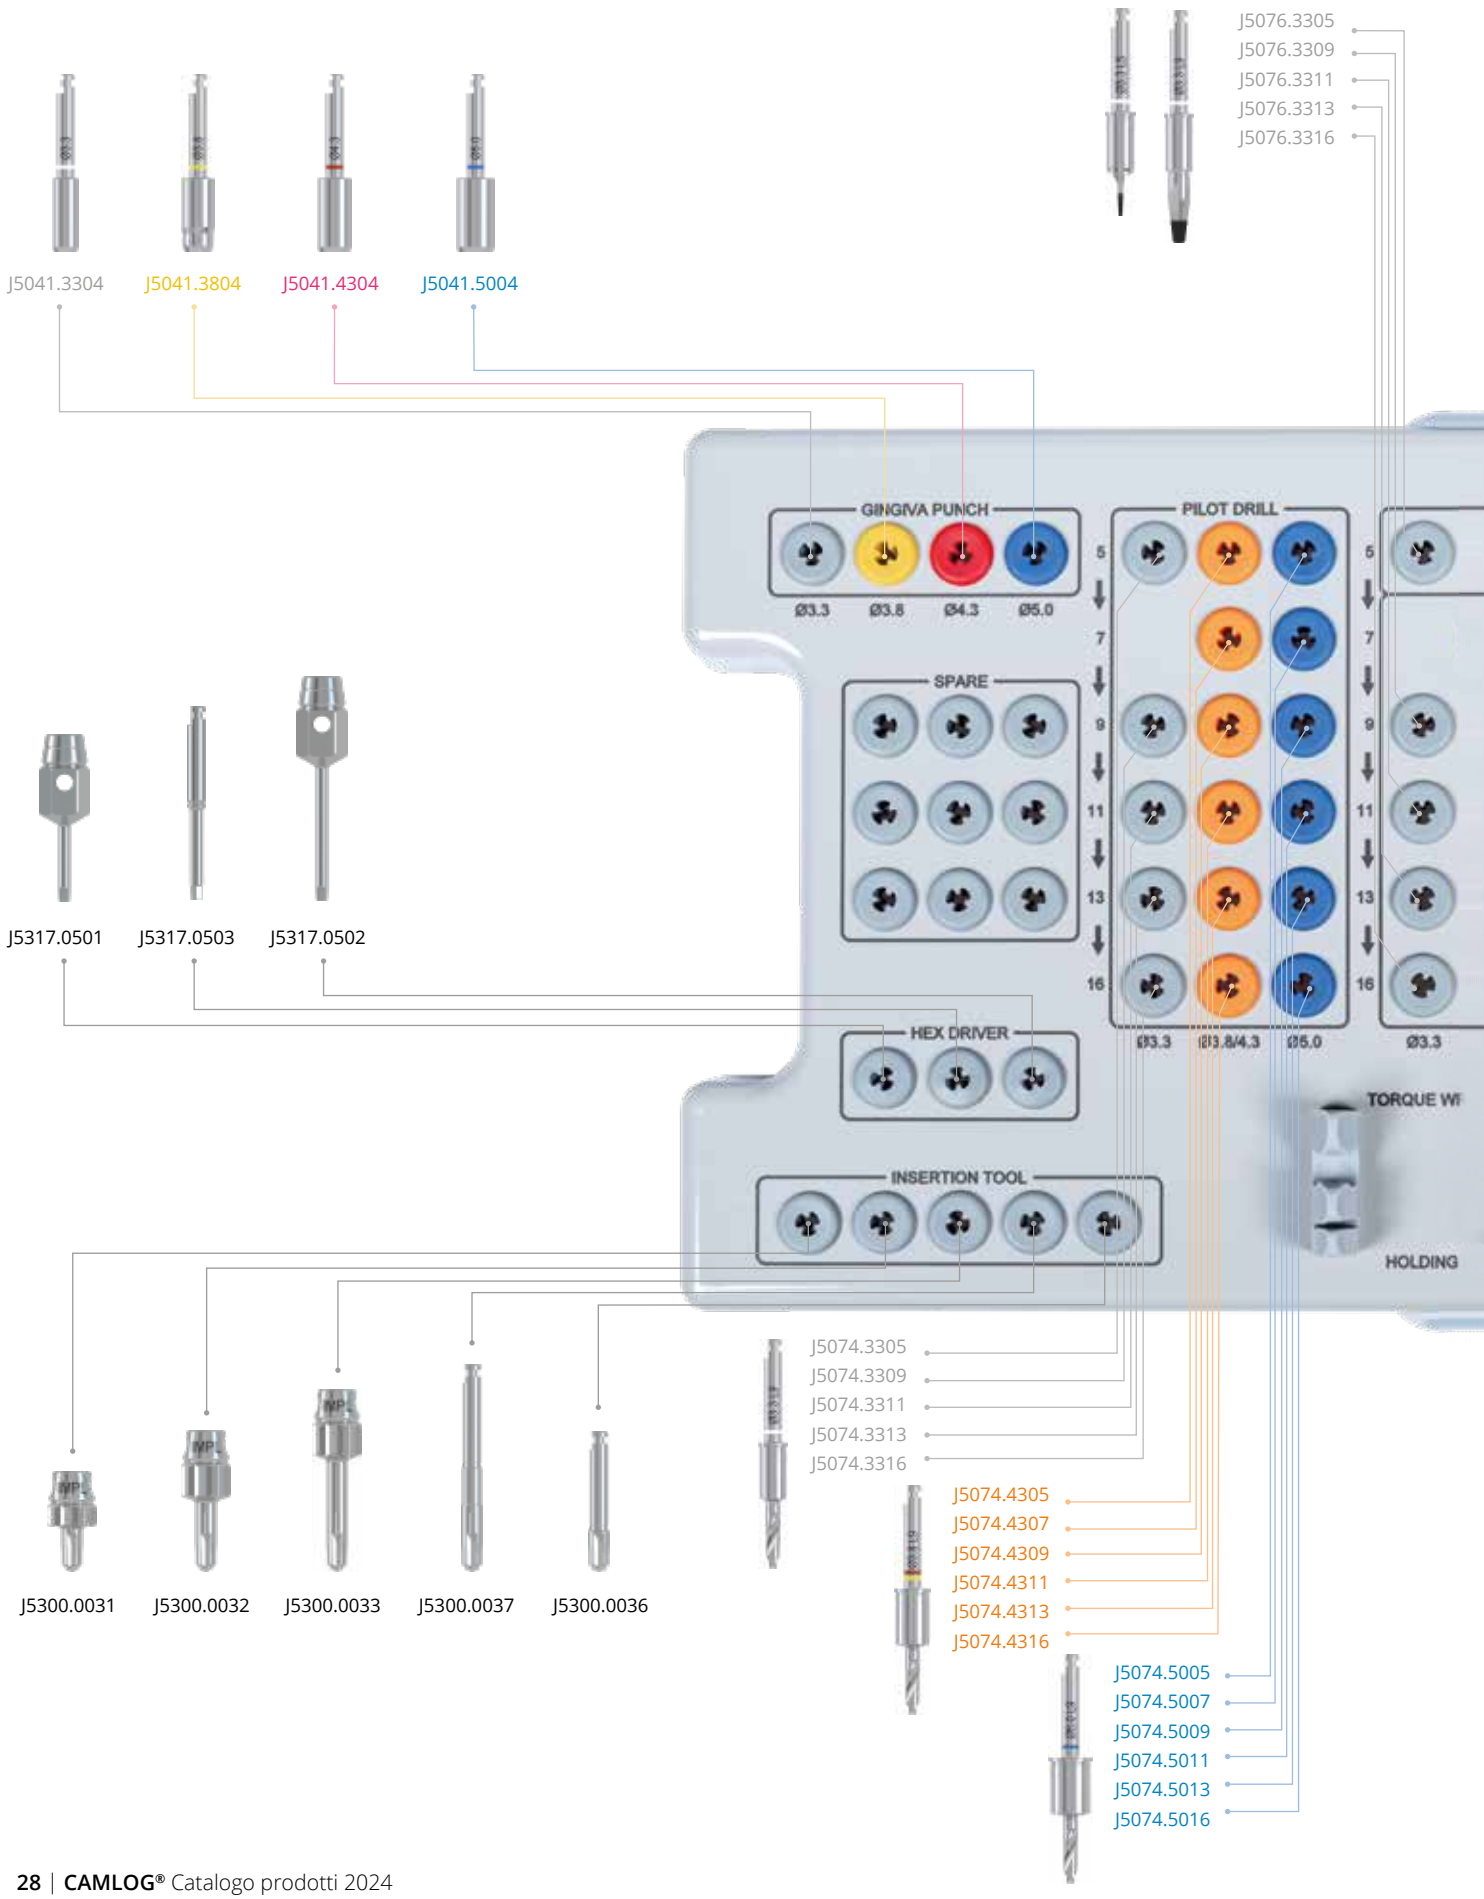

J5076.3805
J5076.3807
J5076.3809
J5076.3811
J5076.3813
J5076.3816

Nota

- Le frese sono disposte e/o suddivise nel set in base alle fasi della sequenza del trattamento.
- Le linee colorate evidenziano l'esatta sequenza di utilizzo delle frese.

J5076.4305
J5076.4307
J5076.4309
J5076.4311
J5076.4313
J5076.4316

J5076.5005
J5076.5007
J5076.5009
J5076.5011
J5076.5013
J5076.5016

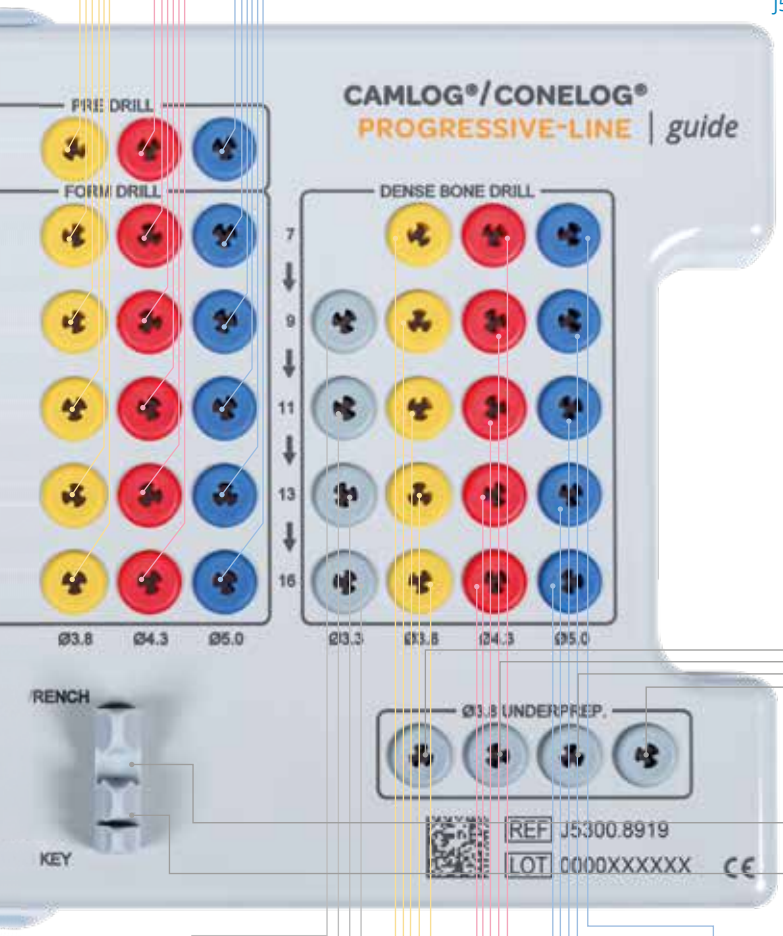

J5077.3316
J5077.3313
J5077.3311
J5077.3309

J5320.1030

J5302.0010

J5078.3309
J5078.3311
J5078.3313
J5078.3316

J5078.3807
J5078.3809
J5078.3811
J5078.3813
J5078.3816

J5078.4307
J5078.4309
J5078.4311
J5078.4313
J5078.4316

J5078.5007
J5078.5009
J5078.5011
J5078.5013
J5078.5016

PROGRESSIVE-LINE Guide System

Tray chirurgico e wash tray chirurgico

	Articolo	Art. n°
	Tray chirurgico Guide System CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE senza contenuto	J5300.8919
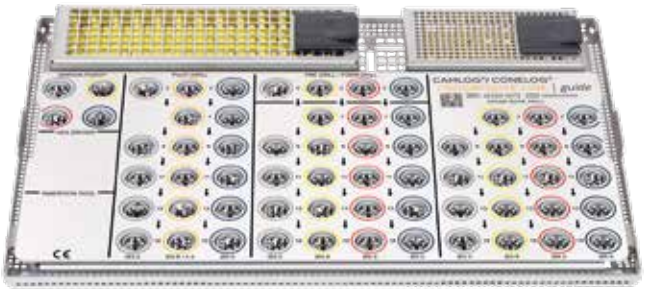	**Guide System Wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** incl. mascherina in acciaio, senza contenuto	J5300.8971
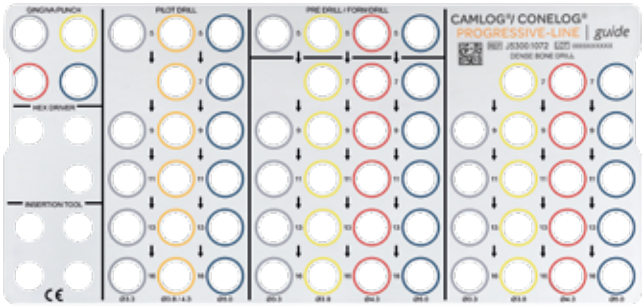	**Guide System Mascherina in acciaio per wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** **Materiale** Acciaio inossidabile	J5300.1072

Nota
Per l'inserimento dell'impianto protesicamente guidato con il PROGRESSIVE-LINE Guide System si utilizzano gli impianti con applicatore avvitato (Art. n° K1075.xxxx).

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Mucotomo Guide System PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5041.3304	3.3 mm	-
		J5041.3804	3.8 mm	
		J5041.4304	4.3 mm	
		J5041.5004	5.0 mm	
	Fresa pilota Guide System PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5074.3305	3.3 mm	5 mm
		J5074.3309		9 mm
		J5074.3311		11 mm
		J5074.3313		13 mm
		J5074.3316		16 mm
		J5074.4305	3.8 mm / 4.3 mm	5 mm
		J5074.4307		7 mm
		J5074.4309		9 mm
		J5074.4311		11 mm
		J5074.4313		13 mm
		J5074.4316		16 mm
		J5074.5005	5.0 mm	5 mm
		J5074.5007		7 mm
		J5074.5009		9 mm
		J5074.5011		11 mm
		J5074.5013		13 mm
		J5074.5016		16 mm
	Fresa iniziale Guide System PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5076.3305	3.3 mm	5 mm
		J5076.3805	3.8 mm	
		J5076.4305	4.3 mm	
		J5076.5005	5.0 mm	
	Fresa a forma Guide System PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5076.3311	3.3 mm	11 mm
		J5076.3313		13 mm
		J5076.3316		16 mm
		J5076.3809	3.8 mm	9 mm
		J5076.3811		11 mm
		J5076.3813		13 mm
		J5076.3816		16 mm
		J5076.4309	4.3 mm	9 mm
		J5076.4311		11 mm
		J5076.4313		13 mm
		J5076.4316		16 mm
		J5076.5009	5.0 mm	9 mm
		J5076.5011		11 mm
		J5076.5013		13 mm
		J5076.5016		16 mm

PROGRESSIVE-LINE Guide System

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Dense bone drill Guide System PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5078.3311	3.3 mm	11 mm
		J5078.3313		13 mm
		J5078.3316		16 mm
		J5078.3809	3.8 mm	9 mm
		J5078.3811		11 mm
		J5078.3813		13 mm
		J5078.3816		16 mm
		J5078.4309	4.3 mm	9 mm
		J5078.4311		11 mm
		J5078.4313		13 mm
		J5078.4316		16 mm
		J5078.5009	5.0 mm	9 mm
		J5078.5011		11 mm
		J5078.5013		13 mm
		J5078.5016		16 mm
	Frese a forma Guide System per sottopreparazione di Ø 3.8 mm PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5077.3309	3.3 mm	9 mm
		J5077.3311		11 mm
		J5077.3313		13 mm
		J5077.3316		16 mm
	Boccole Guide System PROGRESSIVE-LINE 2 unità **Materiale** Lega di titanio	J3754.3301*	3.3 mm	-
		J3754.3801*	3.8 mm	
		J3754.4301*	4.3 mm	
		J3754.5001*	5.0 mm	

* Le boccole non sono compatibili con lo SCREW-LINE Guide System.

PROGRESSIVE-LINE Flex

PROGRESSIVE-LINE Flex

Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG®

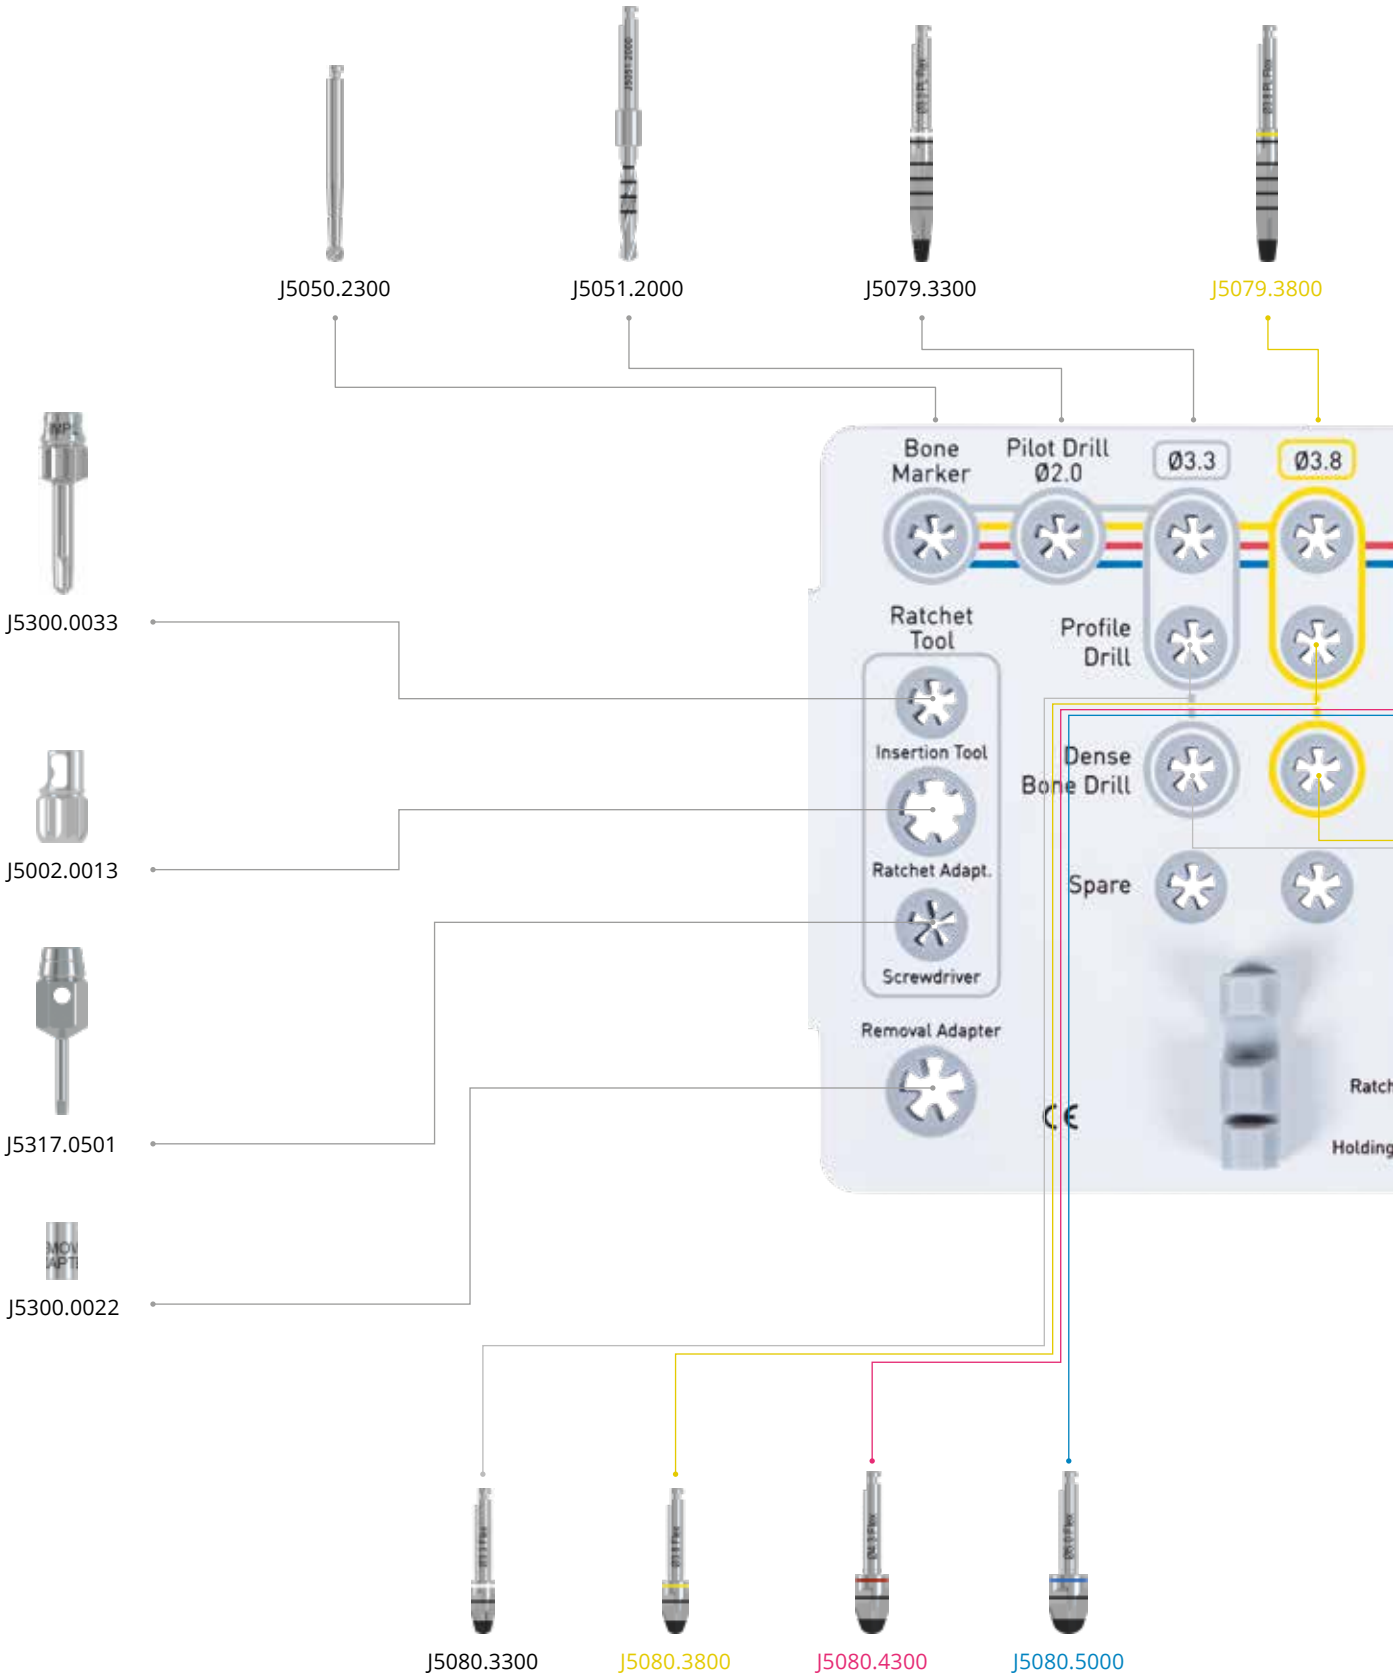

Nota

- Le frese sono disposte e/o suddivise nel set in base alle fasi della sequenza del trattamento.
- Le linee colorate evidenziano l'esatta sequenza di utilizzo delle frese.

J5079.4300

J5079.5000

J5300.2000

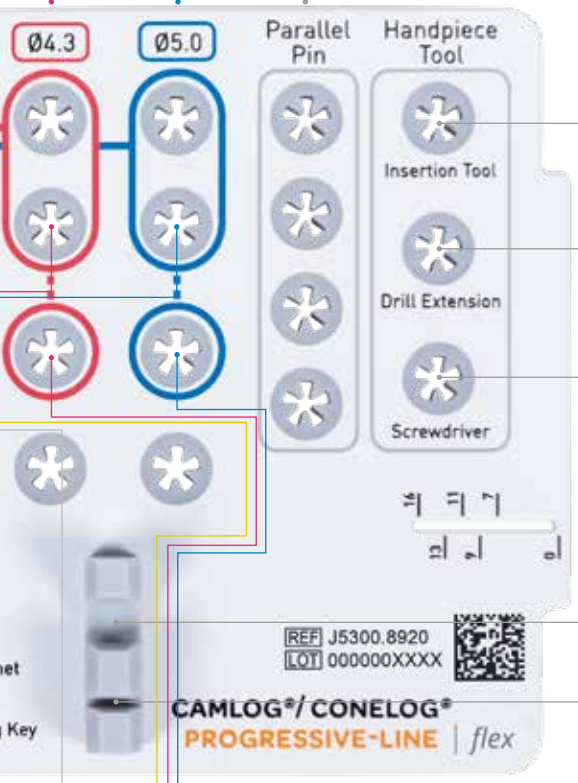

J5300.0036

J5002.0006

J5317.0504

J5320.1030

J5302.0010

J5072.3300

J5072.3800

J5072.4300

J5072.5000

PROGRESSIVE-LINE Flex

Kit chirurgico

	Articolo	Art. n°
	Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex contiene tutti gli strumenti chirurgici necessari suddivisi per codifica cromatica, comprese la chiave dinamometrica e la chiave ad anello universale	J5300.0071

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Fresa PROGRESSIVE-LINE Flex risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5079.3300	3.3 mm	-
		J5079.3800	3.8 mm	
		J5079.4300	4.3 mm	
		J5079.5000	5.0 mm	
	Fresa profilata PROGRESSIVE-LINE Flex risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5080.3300	3.3 mm	-
		J5080.3800	3.8 mm	
		J5080.4300	4.3 mm	
		J5080.5000	5.0 mm	
	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5072.3300	3.3 mm	-
		J5072.3800	3.8 mm	
		J5072.4300	4.3 mm	
		J5072.5000	5.0 mm	
	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5072.3302	3.3 mm	-
		J5072.3802	3.8 mm	
		J5072.4302	4.3 mm	
		J5072.5002	5.0 mm	
	Maschiatore PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5071.3300	3.3 mm	-
		J5071.3800	3.8 mm	
		J5071.4300	4.3 mm	
		J5071.5000	5.0 mm	
	Adattatore per cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	J5002.0013	-	12.5 mm

SCREW-LINE

SCREW-LINE

Impianti con applicatore innestato

	Articolo	Art. n°	Ø	L	A Ø
	Impianto CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® incl. applicatore snap-in e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	K1046.3311	3.3 mm	11 mm	2.7 mm
		K1046.3313		13 mm	
		K1046.3316		16 mm	
		K1046.3809	3.8 mm	9 mm	3.5 mm
		K1046.3811		11 mm	
		K1046.3813		13 mm	
		K1046.3816		16 mm	
		K1046.4309	4.3 mm	9 mm	3.9 mm
		K1046.4311		11 mm	
		K1046.4313		13 mm	
		K1046.4316		16 mm	
		K1046.5009	5.0 mm	9 mm	4.6 mm
		K1046.5011		11 mm	
		K1046.5013		13 mm	
		K1046.5016		16 mm	
		K1046.6009	6.0 mm	9 mm	5.5 mm
		K1046.6011		11 mm	
		K1046.6013		13 mm	
		K1046.6016		16 mm	
	Impianto CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® plus incl. applicatore snap-in e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	K1056.3311	3.3 mm	11 mm	2.7 mm
		K1056.3313		13 mm	
		K1056.3316		16 mm	
		K1056.3809	3.8 mm	9 mm	3.5 mm
		K1056.3811		11 mm	
		K1056.3813		13 mm	
		K1056.3816		16 mm	
		K1056.4309	4.3 mm	9 mm	3.9 mm
		K1056.4311		11 mm	
		K1056.4313		13 mm	
		K1056.4316		16 mm	
		K1056.5009	5.0 mm	9 mm	4.6 mm
		K1056.5011		11 mm	
		K1056.5013		13 mm	
		K1056.5016		16 mm	
		K1056.6009	6.0 mm	9 mm	5.5 mm
		K1056.6011		11 mm	
		K1056.6013		13 mm	
		K1056.6016		16 mm	

Impianti con applicatore avvitato

	Articolo	Art. n°	Ø	L	A Ø
	Impianto CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® incl. applicatore avvitato e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	K1045.3311	3.3 mm	11 mm	2.7 mm
		K1045.3313		13 mm	
		K1045.3316		16 mm	
		K1045.3809	3.8 mm	9 mm	3.5 mm
		K1045.3811		11 mm	
		K1045.3813		13 mm	
		K1045.3816		16 mm	
		K1045.4309	4.3 mm	9 mm	3.9 mm
		K1045.4311		11 mm	
		K1045.4313		13 mm	
		K1045.4316		16 mm	
		K1045.5009	5.0 mm	9 mm	4.6 mm
		K1045.5011		11 mm	
		K1045.5013		13 mm	
	Impianto CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® plus incl. applicatore avvitato e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	K1055.3311	3.3 mm	11 mm	2.7 mm
		K1055.3313		13 mm	
		K1055.3316		16 mm	
		K1055.3809	3.8 mm	9 mm	3.5 mm
		K1055.3811		11 mm	
		K1055.3813		13 mm	
		K1055.3816		16 mm	
		K1055.4309	4.3 mm	9 mm	3.9 mm
		K1055.4311		11 mm	
		K1055.4313		13 mm	
		K1055.4316		16 mm	
		K1055.5009	5.0 mm	9 mm	4.6 mm
		K1055.5011		11 mm	
		K1055.5013		13 mm	

Nota
Per l'inserimento dell'impianto protesicamente guidato con lo SCREW-LINE Guide System si utilizzano gli impianti con applicatore avvitato (Art. n° K1045.xxxx/K1055.xxxx).
Lo SCREW-LINE Guide System è utilizzabile solo per i diametri dell'impianto di 3.3/3.8/4.3.

SCREW-LINE

Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG®

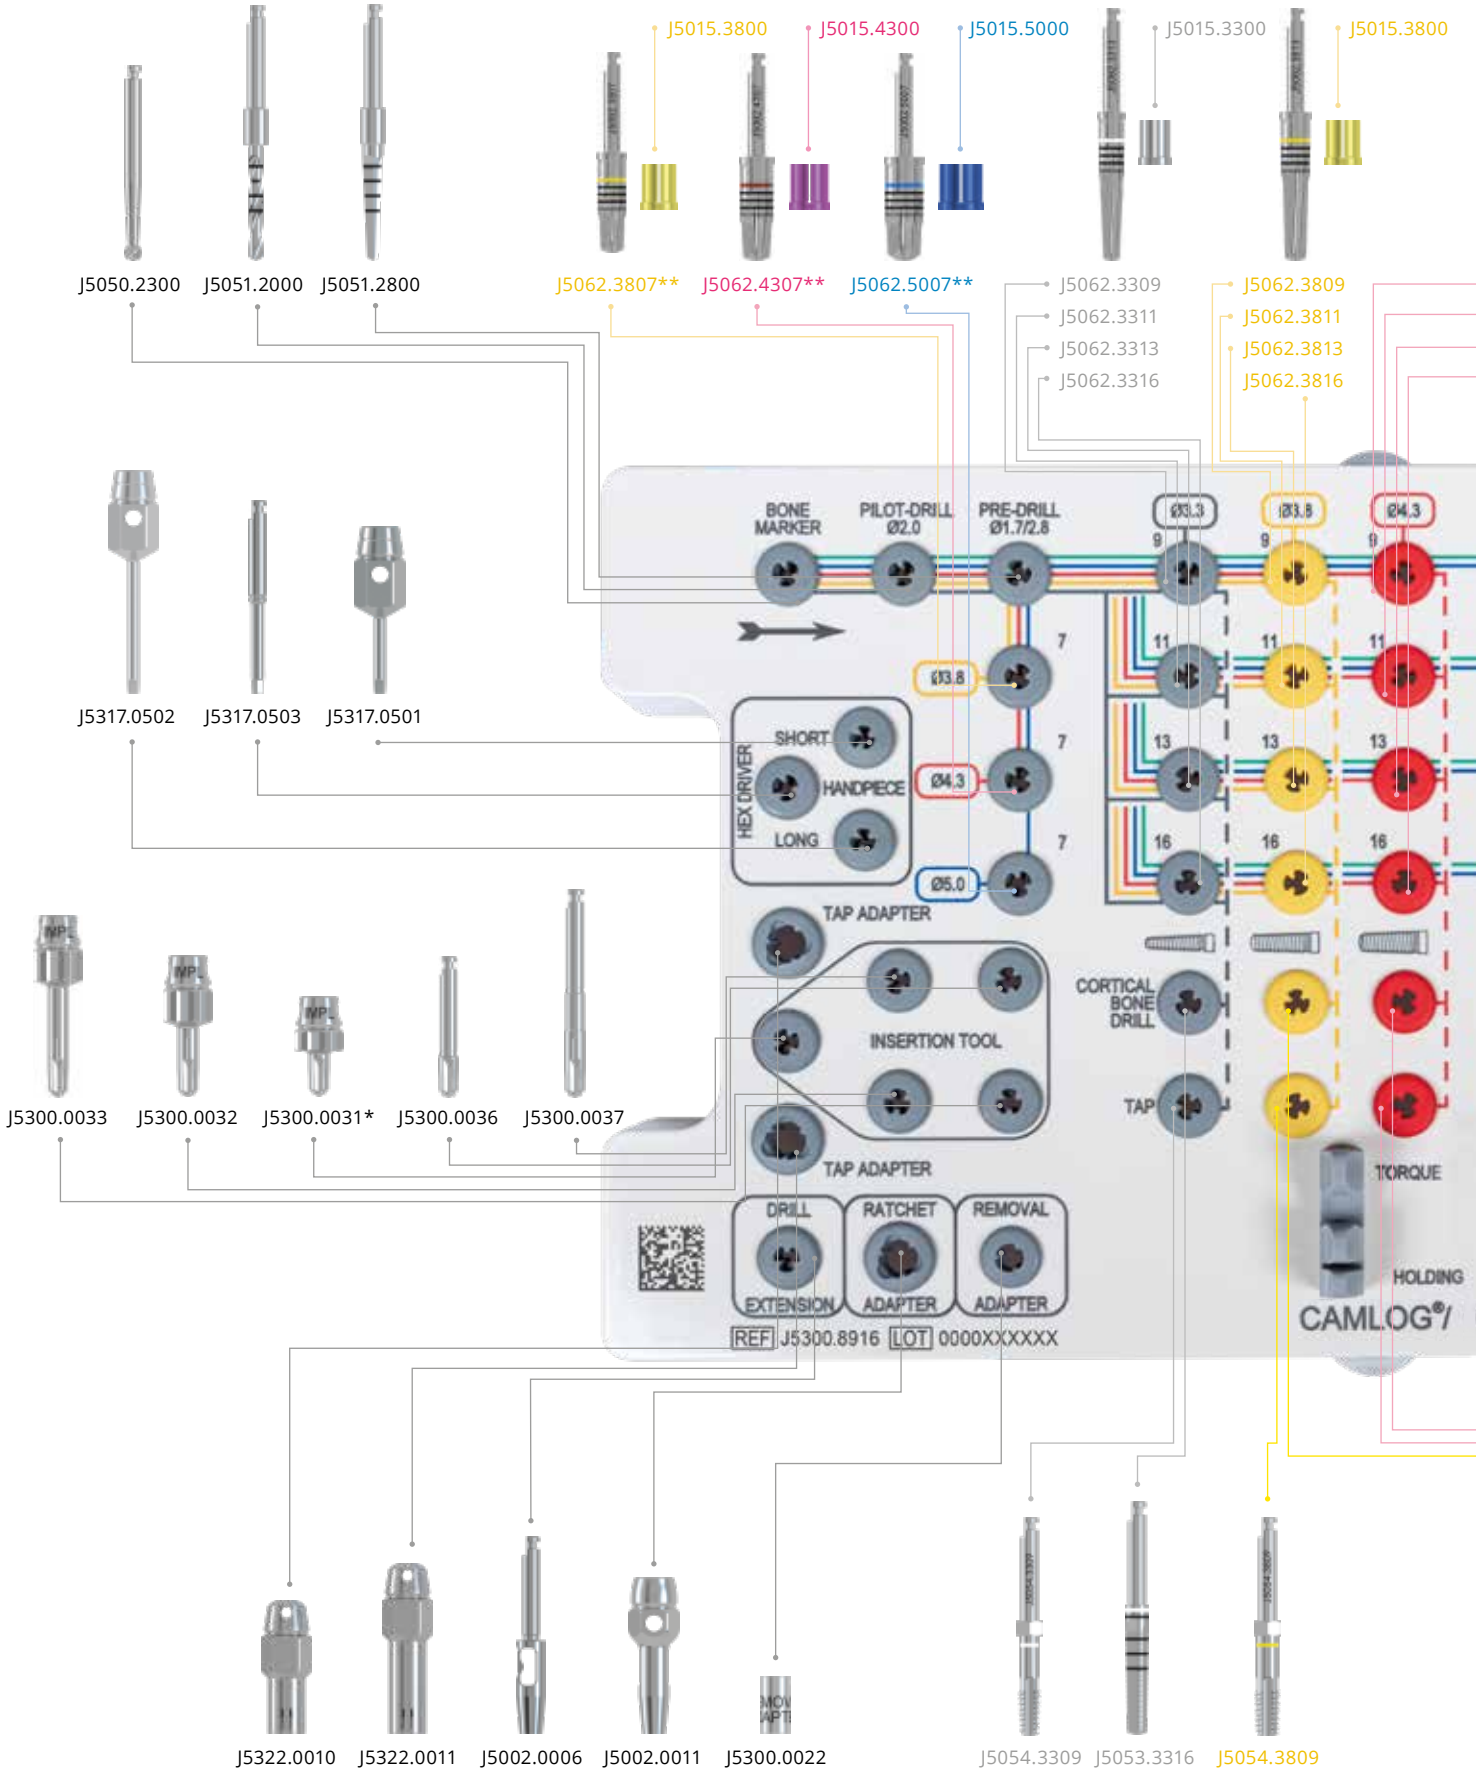

* Questo articolo non è incluso nel kit chirurgico e deve essere ordinato separatamente.
** solo per gli impianti CONELOG® SCREW-LINE con lunghezza di 7 mm

Nota

- Le frese sono disposte e/o suddivise nel set in base alle fasi della sequenza del trattamento.
- Le linee colorate evidenziano l'esatta sequenza di utilizzo delle frese.

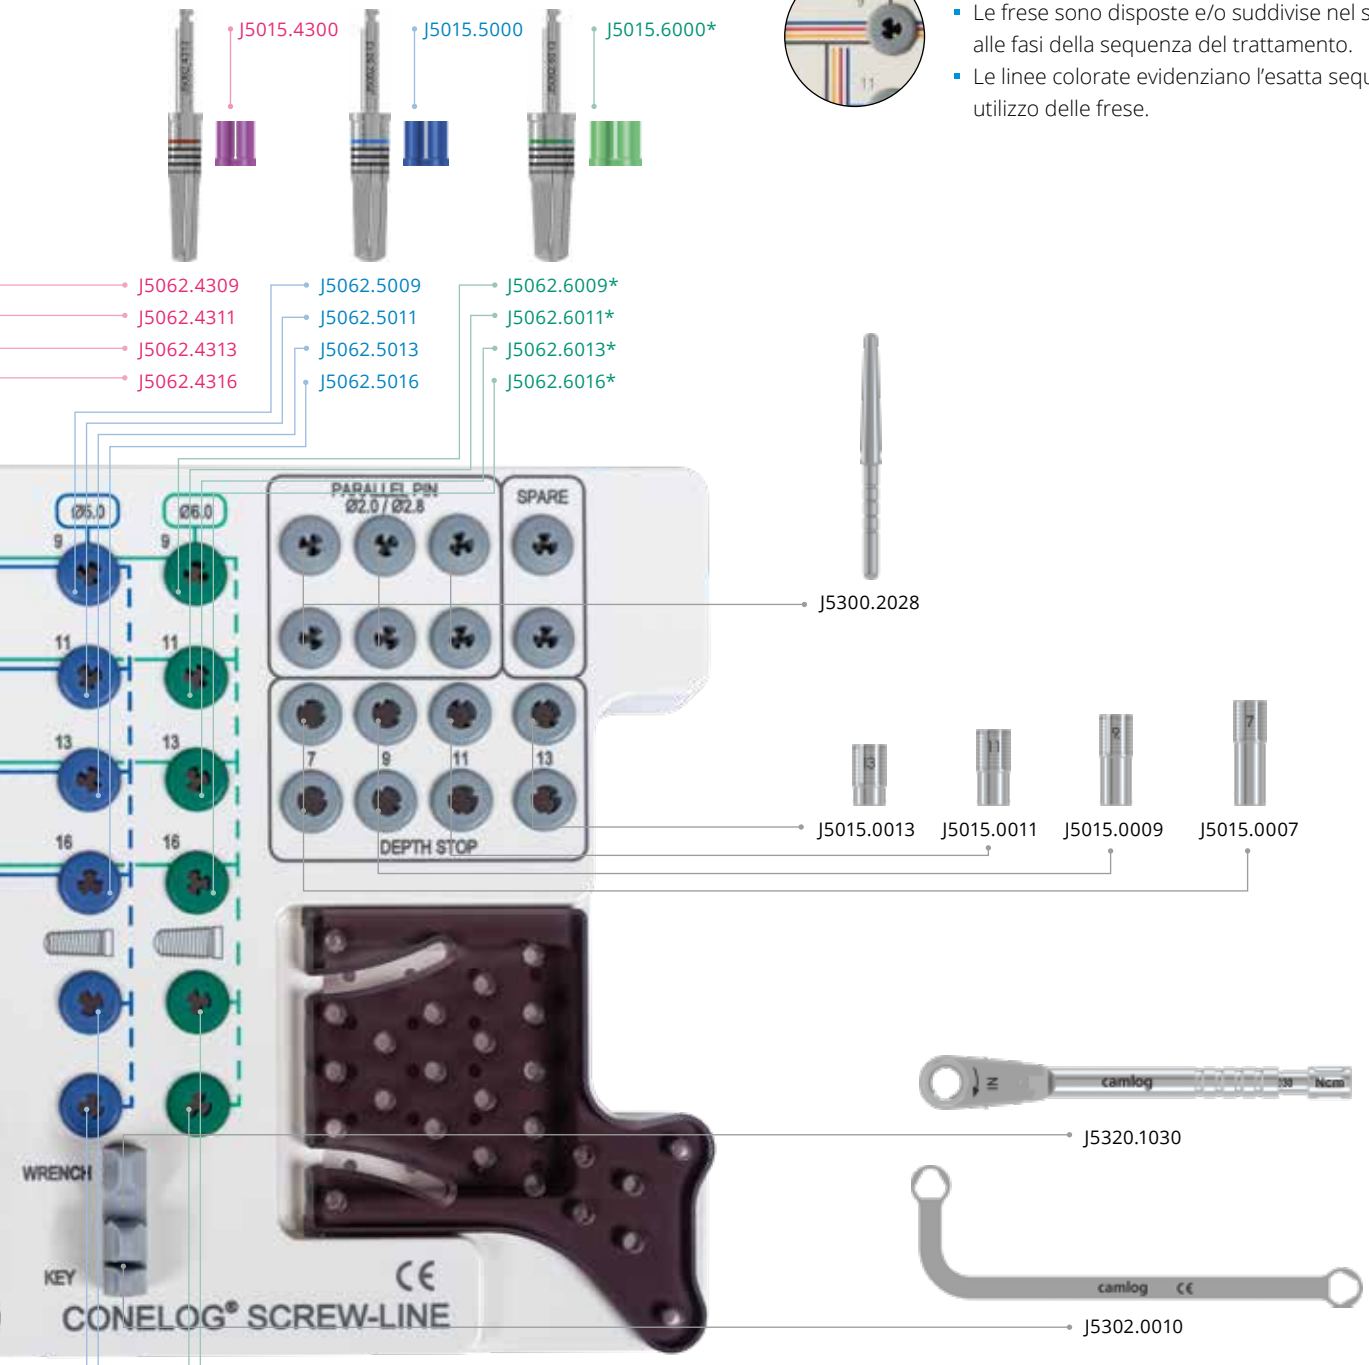

SCREW-LINE

Kit chirurgico e wash tray chirurgico

	Articolo	Art. n°
	Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE contiene tutti gli strumenti chirurgici necessari suddivisi per codifica cromatica, comprese la chiave dinamometrica e la chiave ad anello universale (le frese e i maschiatori per Ø 6.0 non sono inclusi)	J5300.0063
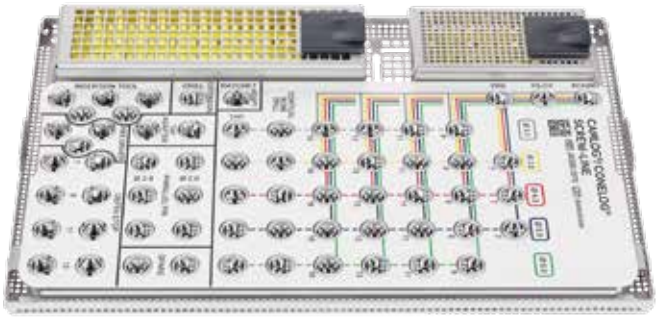	**Wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** incl. mascherina in acciaio, senza contenuto	J5300.8968
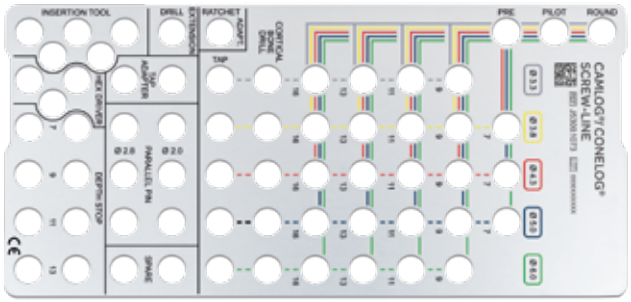	**Mascherina in acciaio per wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** **Materiale** Acciaio inossidabile	J5300.1073

Per la preparazione del sito implantare per gli impianti CAMLOG® SCREW-LINE e gli impianti CONELOG® SCREW-LINE si utilizzano i medesimi strumenti.

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Fresa a forma SCREW-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5062.3309	3.3 mm	9 mm
		J5062.3311		11 mm
		J5062.3313		13 mm
		J5062.3316		16 mm
		J5062.3809	3.8 mm	9 mm
		J5062.3811		11 mm
		J5062.3813		13 mm
		J5062.3816		16 mm
		J5062.4309	4.3 mm	9 mm
		J5062.4311		11 mm
		J5062.4313		13 mm
		J5062.4316		16 mm
		J5062.5009	5.0 mm	9 mm
		J5062.5011		11 mm
		J5062.5013		13 mm
		J5062.5016		16 mm
		J5062.6009	6.0 mm	9 mm
		J5062.6011		11 mm
		J5062.6013		13 mm
		J5062.6016		16 mm
	Stop di profondità per fresa a forma SCREW-LINE (utilizzabile anche per la fresa a forma PROGRESSIVE-LINE), risterilizzabile **Materiale** Lega di titanio	J5015.3300	3.3 mm	-
		J5015.3800	3.8 mm	
		J5015.4300	4.3 mm	
		J5015.5000	5.0 mm	
		J5015.6000	6.0 mm	
	Fresa a forma SCREW-LINE per osso corticale risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5053.3316	3.3 mm	-
		J5053.3816	3.8 mm	
		J5053.4316	4.3 mm	
		J5053.5016	5.0 mm	
		J5053.6016	6.0 mm	
	Maschiatore SCREW-LINE con attacco esagonale, risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5054.3309	3.3 mm	-
		J5054.3809	3.8 mm	
		J5054.4309	4.3 mm	
		J5054.5009	5.0 mm	
		J5054.6009	6.0 mm	

SCREW-LINE Guide System

Per la pianificazione di impianti in 3D, la progettazione e la realizzazione di guide di fresaggio è possibile rivolgersi al nostro partner di servizio CAD/CAM DEDICAM®.
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

SCREW-LINE Guide System

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	**Set di frese pilota Guide System** raffreddamento interno, sterili (per frese pilota Ø 2.0 mm) **Materiale** Acciaio inossidabile	J5063.3311	3.3 mm	11 mm (incl. 5 e 9 mm)**
		J5063.3313		13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)**
		J5064.3316*		16 mm
		J5063.4309	3.8 mm	9 mm (incl. 5 mm)**
			4.3 mm	
		J5063.4311	3.8 mm	11 mm (incl. 5 e 9 mm)**
			4.3 mm	
		J5063.4313	3.8 mm	13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)**
			4.3 mm	
		J5064.4316*	3.8 mm	16 mm
			4.3 mm	
	Set chirurgico Guide System SCREW-LINE raffreddamento interno, sterili **Materiale** Acciaio inossidabile	J5065.3311	3.3 mm	11 mm (incl. 5 e 9 mm)****
		J5065.3313		13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)****
		J5066.3316***		16 mm
		J5065.3809	3.8 mm	9 mm (incl. 5 mm)****
		J5065.3811		11 mm (incl. 5 e 9 mm)****
		J5065.3813		13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)****
		J5066.3816***		16 mm
		J5065.4309	4.3 mm	9 mm (incl. 5 mm)****
		J5065.4311		11 mm (incl. 5 e 9 mm)****
		J5065.4313		13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)****
		J5066.4316***		16 mm

* Fresa pilota Guide System necessaria per la lunghezza dell'impianto di 16 mm, dopo aver utilizzato obbligatoriamente il set di frese pilota nella lunghezza di 13 mm.

** Tutti i set di frese pilota Guide System includono una fresa pilota lunga 5 mm e tutte le restanti frese pilota necessarie fino alla lunghezza dell'impianto selezionata.

*** Fresa a forma Guide System necessaria per la lunghezza dell'impianto di 16 mm, dopo aver utilizzato obbligatoriamente il set chirurgico Guide System nella lunghezza di 13 mm.

**** Tutti i set chirurgici Guide System includono una fresa iniziale lunga 5 mm e tutte le restanti frese a forma necessarie fino alla lunghezza dell'impianto selezionata.

Tutte le frese e tutti i mucotomi Guide System SCREW-LINE sono esclusivamente prodotti monouso.

Nota
Per l'inserimento dell'impianto protesicamente guidato con lo SCREW-LINE Guide System si utilizzano gli impianti con applicatore avvitato (Art. n° K1045.xxxx/K1055.xxxx).
Lo SCREW-LINE Guide System è utilizzabile solo per i diametri dell'impianto di 3.3/3.8/4.3.

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Fresa a forma Guide System SCREW-LINE per osso corticale raffreddamento interno, sterili **Materiale** Acciaio inossidabile	J5068.3311	3.3 mm	11 mm
		J5068.3313		13 mm
		J5068.3316		16 mm
		J5068.3809	3.8 mm	9 mm
		J5068.3811		11 mm
		J5068.3813		13 mm
		J5068.3816		16 mm
		J5068.4309	4.3 mm	9 mm
		J5068.4311		11 mm
		J5068.4313		13 mm
		J5068.4316		16 mm
	Mucotomo Guide System sterile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5041.3303	3.3 mm	-
		J5041.3803	3.8 mm	
		J5041.4303	4.3 mm	
	Boccole Guide System Altezza 3.0 mm 2 unità **Materiale** Lega di titanio	J3734.3303*	3.3 mm	-
		J3734.3803*	3.8 mm	
		J3734.4303*	4.3 mm	
	Prolunga della fresa gambo ISO, per strumenti a raffreddamento interno **Materiale** Acciaio inossidabile	J5002.0005	-	26.6 mm

* Le boccole non sono compatibili con il PROGRESSIVE-LINE Guide System.

Tutte le frese e tutti i mucotomi Guide System SCREW-LINE sono esclusivamente prodotti monouso.

Strumenti chirurgici generali

Strumenti chirurgici generali

	Articolo		Art. n°	Ø	L
	Fresa a rosetta risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5050.2300	2.3 mm	-
	Punta appuntita risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5051.1500	1.5 mm	-
	Fresa pilota senza flangia, risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5051.2003	2.0 mm	-
	Fresa pilota SCREW-LINE (utilizzabile anche per PROGRESSIVE-LINE), risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5051.2000	2.0 mm	-
	Fresa iniziale SCREW-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5051.2800	1.7–2.8 mm	-
	Stop di profondità SCREW-LINE per fresa pilota (J5051.2000) e fresa iniziale (J5051.2800) con flangia ridotta, risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5015.0009	-	9 mm
			J5015.0011		11 mm
			J5015.0013		13 mm
	Profilatore osseo **Materiale** Acciaio inossidabile	Ø 5.0 mm	J5003.3350*	3.3 mm	-
		Ø 6.0 mm	J5003.4360*	3.8 mm	
				4.3 mm	
		Ø 7.0 mm	J5003.5070*	5.0 mm	
	Perno guida **per profilatore osseo CAMLOG®** **Materiale** Lega di titanio		J5002.3300	3.3 mm	-
			J5002.3800	3.8 mm	
			J5002.4300	4.3 mm	
			J5002.5000	5.0 mm	

* Utilizzare sempre in associazione con il corrispondente perno guida!

Strumenti chirurgici generali

	Articolo		Misura	Art. n°	Ø	Misura
	Livellatore **Materiale** Acciaio inossidabile	Ø 4.6 mm	-	J5006.3346	3.3 mm	-
		Ø 5.2 mm		J5006.3852	3.8 mm	
		Ø 5.6 mm		J5006.4356	4.3 mm	
		Ø 6.3 mm		J5006.5063	5.0 mm	
	Fresa di apertura per vite tappo **Materiale** Acciaio inossidabile		-	J5004.3300	3.3 mm	-
				J5004.3800	3.8 mm	
				J5004.4300	4.3 mm	
				J5004.5000	5.0 mm	
	Perno parallelizzatore SCREW-LINE con tacche di profondità **Materiale** Lega di titanio		-	J5300.2028	-	Ø 1.7–2.8 mm/ 2.0 mm
	Prolunga della fresa gambo ISO (non per frese con raffreddamento interno) **Materiale** Acciaio inossidabile		-	J5002.0006	-	26.5 mm
	Adattatore per maschiatore per maschiatori SCREW-LINE **Materiale** Acciaio inossidabile		corto	J5322.0010	-	18.0 mm
			lungo	J5322.0011	-	23.0 mm
	Adattatore di rimozione per impianti con applicatore innestato (snap-in) **Materiale** Acciaio inossidabile		-	J5300.0022*	3.3 mm	6.2 mm
					3.8 mm	
					4.3 mm	
					5.0 mm	

* utilizzabile solo con gli impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE con art. n° K1076.xxxx, nonché con gli impianti CAMLOG® SCREW-LINE con art. n° K1046.xxxx e K1056.xxxx

	Articolo	Misura	Art. n°	Misura
	Inseritore per impianti a vite, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	extra corto	J5300.0031	13.7 mm
		corto	J5300.0032	19.2 mm
		lungo	J5300.0033	24.8 mm
	Inseritore per impianti a vite, con gambo ISO per contrangolo (senza esagono sul gambo) **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5300.0036	19.1 mm
		lungo	J5300.0037	28.2 mm
	Inseritore per impianti a vite, con gambo ISO per contrangolo, con esagono sul gambo **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5300.0034	19.1 mm
		lungo	J5300.0035	28.2 mm
	Chiave dinamometrica **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5320.1030	-
	Chiave dinamometrica 10–70 Ncm **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5320.1070	-
	Strumento PickUp Supporto per traslare gli impianti **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5300.0030	-
	Adattatore Gambo ISO per contrangolo/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5002.0011	21.0 mm
	Chiave ad anello universale **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5302.0010	-

Strumenti chirurgici generali

	Articolo	Misura	Art. n°	Ø	Misura
	Adattatore CAMLOG® per impianti CAMLOG® **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	K5302.3311	3.3 mm	29.8 mm
			K5302.3811	3.8 mm	
			K5302.4311	4.3 mm	
			K5302.6011	5.0 mm	
				6.0 mm	
		lungo	K5302.3310	3.3 mm	34.8 mm
			K5302.3810	3.8 mm	
			K5302.4310	4.3 mm	
	Dima per l'inserimento dell'adattatore nell'impianto a vite **Materiale** Lega di titanio	-	J5302.3300	3.3 mm	-
			J5302.3800	3.8 mm	
			J5302.4300	4.3 mm	
			J5302.5000	5.0 mm	
			J5302.6000	6.0 mm	
	**Cacciavite** hex, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	extra corto	J5317.0510	-	14.5 mm
		corto	J5317.0501		22.5 mm
		lungo	J5317.0502		30.3 mm
	Cacciavite hex, gambo ISO **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5317.0504	-	18.0 mm
		lungo	J5317.0503		26.0 mm
	Cacciavite manuale, hex senza attacco per testa a cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5317.0511	-	23.0 mm

	Articolo	Misura	Art. n°	L
	Ago di pulizia per strumenti a raffreddamento interno **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5002.0012	-
	Cannula di pulizia per strumenti a raffreddamento interno **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5002.0020	-

SCREW-LINE
Set per osteotomia

SCREW-LINE Set per osteotomia

diritto convesso

	Articolo	Art. n°	Ø
	Set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE diritto convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5418.0020	-
	**Pre-osteotomo SCREW-LINE** diritto convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5417.2800*	1.7– 2.8 mm
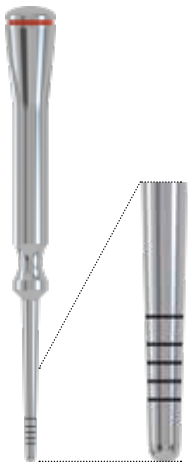	**Osteotomo SCREW-LINE** diritto convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5418.3300*	3.3 mm
		J5418.3800*	3.8 mm
		J5418.4300*	4.3 mm
		J5418.5000*	5.0 mm
		J5418.6000*	6.0 mm

* Questi prodotti sono inclusi nel set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE diritto convesso.

SCREW-LINE Set per osteotomia

angolato convesso

	Articolo	Art. n°	Ø
	Set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE angolato convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5418.0030	-
	**Pre-osteotomo SCREW-LINE** diritto convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5417.2800*	1.7– 2.8 mm
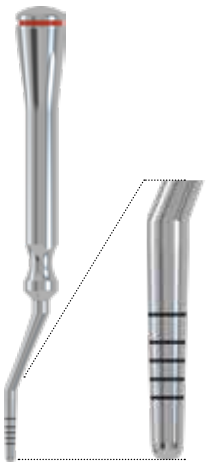	**Osteotomo SCREW-LINE** angolato convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5418.3310*	3.3 mm
		J5418.3810*	3.8 mm
		J5418.4310*	4.3 mm
		J5418.5010*	5.0 mm
		J5418.6010*	6.0 mm

* Questi prodotti sono inclusi nel set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE angolato convesso.

diritto concavo

	Articolo	Art. n°	Ø
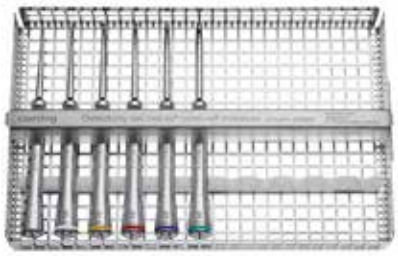	**Set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** diritto concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5420.0020	-
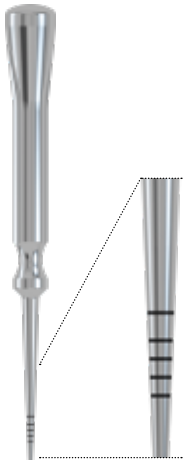	**Pre-osteotomo SCREW-LINE** diritto concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5419.2800*	1.7– 2.8 mm
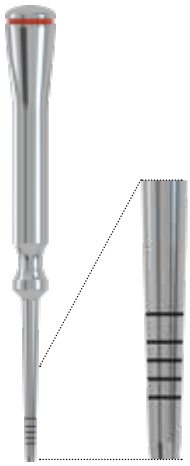	**Osteotomo SCREW-LINE** diritto concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5420.3300*	3.3 mm
		J5420.3800*	3.8 mm
		J5420.4300*	4.3 mm
		J5420.5000*	5.0 mm
		J5420.6000*	6.0 mm

* Questi prodotti sono inclusi nel set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE diritto concavo.

SCREW-LINE Set per osteotomia

angolato concavo

	Articolo	Art. n°	Ø
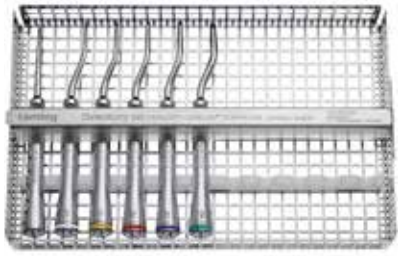	**Set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** angolato concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5420.0030	-
	**Pre-osteotomo SCREW-LINE** diritto concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5419.2800*	1.7– 2.8 mm
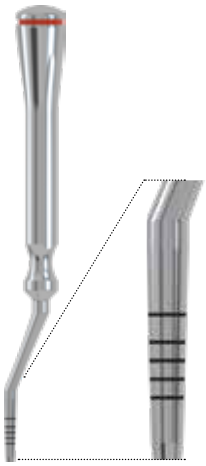	**Osteotomo SCREW-LINE** angolato concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5420.3310*	3.3 mm
		J5420.3810*	3.8 mm
		J5420.4310*	4.3 mm
		J5420.5010*	5.0 mm
		J5420.6010*	6.0 mm

* Questi prodotti sono inclusi nel set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE angolato concavo.

Viti tappo e cappette di guarigione

Viti tappo

	Articolo	Art. n°	Ø
	Vite tappo per impianto CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	J2019.3300	3.3 mm
		J2019.3800	3.8 mm
		J2019.4300	4.3 mm
		J2019.5000	5.0 mm
		J2019.6000	6.0 mm

Le viti tappo per impianto sono esclusivamente monouso e non devono essere risterilizzate.

Cappette di guarigione

Standard: cilindrica, wide body e wide body, narrow emergence

	Articolo	Art. n°	Ø	AG	G Ø
	**Cappetta di guarigione CAMLOG®, cilindrica** sterile **Materiale** Lega di titanio	J2015.3320	3.3 mm	2.0 mm	3.5 mm
		J2015.3340		4.0 mm	3.5 mm
		J2015.3360		6.0 mm	3.5 mm
		J2015.3820	3.8 mm	2.0 mm	4.0 mm
		J2015.3840		4.0 mm	4.0 mm
		J2015.3860*		6.0 mm	4.0 mm
		J2015.4320	4.3 mm	2.0 mm	4.5 mm
		J2015.4340		4.0 mm	4.5 mm
		J2015.4360*		6.0 mm	4.5 mm
		J2015.5020	5.0 mm	2.0 mm	5.2 mm
		J2015.5040		4.0 mm	5.2 mm
		J2015.5060*		6.0 mm	5.2 mm
		J2015.6020	6.0 mm	2.0 mm	6.2 mm
		J2015.6040		4.0 mm	6.2 mm
		J2015.6060*		6.0 mm	6.2 mm
	**Cappetta di guarigione CAMLOG®, wide body** sterile **Materiale** Lega di titanio	J2014.3320	3.3 mm	2.0 mm	4.4 mm
		J2014.3340		4.0 mm	4.5 mm
		J2014.3820	3.8 mm	2.0 mm	4.9 mm
		J2014.3840		4.0 mm	5.0 mm
		J2014.3860		6.0 mm	5.0 mm
		J2014.4320	4.3 mm	2.0 mm	5.4 mm
		J2014.4340		4.0 mm	5.5 mm
		J2014.4360		6.0 mm	5.5 mm
		J2014.5020	5.0 mm	2.0 mm	6.1 mm
		J2014.5040		4.0 mm	6.2 mm
		J2014.5060		6.0 mm	6.2 mm
		J2014.6020	6.0 mm	2.0 mm	7.1 mm
		J2014.6040		4.0 mm	7.2 mm
		J2014.6060		6.0 mm	7.2 mm
 Nuovo	**Cappetta di guarigione CAMLOG®, wide body, narrow emergence** sterile **Materiale** Lega di titanio	J2024.3340	3.3 mm	4.0 mm	4.5 mm
		J2024.3360		6.0 mm	4.5 mm
		J2024.3840	3.8 mm	4.0 mm	5.0 mm
		J2024.3860		6.0 mm	5.0 mm
		J2024.4340	4.3 mm	4.0 mm	5.5 mm
		J2024.4360		6.0 mm	5.5 mm
		J2024.5040	5.0 mm	4.0 mm	6.2 mm
		J2024.5060		6.0 mm	6.2 mm
		J2024.6040	6.0 mm	4.0 mm	7.2 mm
		J2024.6060		6.0 mm	7.2 mm

	Articolo	Art. n°	Ø	AG	G Ø
	**Cappetta di guarigione CAMLOG®, bottleneck** sterile **Materiale** Lega di titanio	J2011.3340	3.3 mm	4.0 mm	3.5 mm
		J2011.3840	3.8 mm	4.0 mm	4.0 mm
		J2011.3860		6.0 mm	4.0 mm
		J2011.4340	4.3 mm	4.0 mm	4.5 mm
		J2011.4360		6.0 mm	4.5 mm
		J2011.5040	5.0 mm	4.0 mm	5.2 mm
		J2011.5060		6.0 mm	5.2 mm
		J2011.6040	6.0 mm	4.0 mm	6.2 mm
		J2011.6060		6.0 mm	6.2 mm

Cappetta di guarigione
Platform Switching

	Articolo	Art. n°	Ø	AG	G Ø
PS 	**Cappetta di guarigione CAMLOG® PS, cilindrica** sterile, per Platform Switching con impianti CAMLOG® con codice articolo K **Materiale** Lega di titanio	K2005.3820	3.8 mm	2.0 mm	3.3 mm
		K2005.3840		4.0 mm	3.3 mm
		K2005.3860*		6.0 mm	3.3 mm
		K2005.4320	4.3 mm	2.0 mm	3.8 mm
		K2005.4340		4.0 mm	3.8 mm
		K2005.4360*		6.0 mm	3.8 mm
		K2005.5020	5.0 mm	2.0 mm	4.4 mm
		K2005.5040		4.0 mm	4.4 mm
		K2005.5060*		6.0 mm	4.4 mm
		K2005.6020	6.0 mm	2.0 mm	5.1 mm
		K2005.6040		4.0 mm	5.1 mm
		K2005.6060*		6.0 mm	5.1 mm
PS 	**Cappetta di guarigione CAMLOG® PS, wide body** sterile, per Platform Switching con impianti CAMLOG® con codice articolo K **Materiale** Lega di titanio	K2004.3840	3.8 mm	4.0 mm	5.0 mm
		K2004.3860		6.0 mm	5.0 mm
		K2004.4340	4.3 mm	4.0 mm	5.5 mm
		K2004.4360		6.0 mm	5.5 mm
		K2004.5040	5.0 mm	4.0 mm	6.2 mm
		K2004.5060		6.0 mm	6.2 mm
		K2004.6040	6.0 mm	4.0 mm	7.2 mm
		K2004.6060		6.0 mm	7.2 mm

* adatta per la registrazione del morso

Le cappette di guarigione sono esclusivamente monouso e non devono essere risterilizzate.

Tramite il nostro partner di servizio CAD/CAM DEDICAM® è possibile ricevere cappette di guarigione personalizzate.
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

Tecnica protesica

4.3

Scanbody

	Articolo	Art. n°	Ø
	Scanbody CAMLOG®** incl. vite per abutment CAMLOG®, sterile **Materiale** PEEK	K2610.3310	3.3 mm
		K2610.3810*	3.8 mm
		K2610.4310*	4.3 mm
		K2610.6010*	5.0 mm
			6.0 mm
	Scanbody CAMLOG® multiuso** incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2630.3300	3.3 mm
		K2630.3800*	3.8 mm
		K2630.4300*	4.3 mm
		K2630.6000*	5.0 mm
			6.0 mm
	ScanPost CAMLOG® per Sirona® incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2620.3306	3.3 mm
		K2620.3806*	3.8 mm
		K2620.4306*	4.3 mm
		K2620.5006*	5.0 mm
		K2620.6006*	6.0 mm

* utilizzabile anche per Platform Switching

** Verificare che lo scanbody CAMLOG® sia disponibile nel software CAD utilizzato.
Le librerie CAD per componenti protesici CAMLOG® selezionati possono essere scaricate gratuitamente qui:
www.biohorizonscamlog.com/cad-libraries
Svizzera: www.camlog.ch/cad-bibliotheken

Scanbody Sirona® misura S adatti per lo ScanPost CAMLOG® e la base in titanio CAD/CAM CAMLOG® per corona, con Ø 3.3/3.8/4.3 mm:
Numero d'ordine 6431311

Scanbody Sirona® misura L adatti per lo ScanPost CAMLOG® e la base in titanio CAD/CAM CAMLOG® per corona, con Ø 5.0/6.0 mm:
Numero d'ordine 6431329

Gli scanbody Sirona® possono essere richiesti a Dentsply Sirona o a rivenditori specializzati di prodotti dentali.

Presa d'impronta

	Articolo	Art. n°	Ø
Nuovo	**Transfer da impronta CAMLOG®, cilindrico, porta-impronte forato** incl. vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio	K2125.3300	3.3 mm
		K2125.3800	3.8 mm
		K2125.4300	4.3 mm
		K2125.5000	5.0 mm
		K2125.6000	6.0 mm
Nuovo 	**Transfer da impronta CAMLOG®, cilindrico, porta-impronte chiuso** incl. ausilio di riposizionamento, cappetta per la registrazione del morso e vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio/PBT	K2115.3300	3.3 mm
		K2115.3800	3.8 mm
		K2115.4300	4.3 mm
		K2115.5000	5.0 mm
		K2115.6000	6.0 mm
Nuovo	**Transfer da impronta CAMLOG®, wide body, porta-impronte forato** incl. vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio	K2124.3300	3.3 mm
		K2124.3800	3.8 mm
		K2124.4300	4.3 mm
		K2124.5000	5.0 mm
		K2124.6000	6.0 mm
Nuovo 	**Transfer da impronta CAMLOG®, wide body, porta-impronte chiuso** incl. ausilio di riposizionamento, cappetta per la registrazione del morso e vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio/PBT	K2114.3300	3.3 mm
		K2114.3800	3.8 mm
		K2114.4300	4.3 mm
		K2114.5000	5.0 mm
		K2114.6000	6.0 mm
Nuovo 	**Transfer da impronta CAMLOG®, wide body, narrow emergence, porta-impronte forato** incl. vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio	K2124.3301	3.3 mm
		K2124.3801	3.8 mm
		K2124.4301	4.3 mm
		K2124.5001	5.0 mm
		K2124.6001	6.0 mm
Nuovo 	**Transfer da impronta CAMLOG®, wide body, narrow emergence, porta-impronte chiuso** incl. ausilio di riposizionamento, cappetta per la registrazione del morso e vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio/PBT	K2114.3301	3.3 mm
		K2114.3801	3.8 mm
		K2114.4301	4.3 mm
		K2114.5001	5.0 mm
		K2114.6001	6.0 mm

Presa d’impronta

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
Nuovo	**Transfer da impronta CAMLOG® PS, porta-impronte forato** incl. vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio	1	K2122.3800	3.8 mm
			K2122.4300	4.3 mm
			K2122.5000	5.0 mm
			K2122.6000	6.0 mm
Nuovo 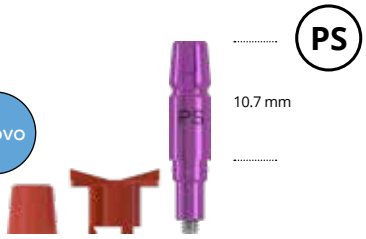	**Transfer da impronta CAMLOG® PS, porta-impronte chiuso** incl. ausilio di riposizionamento, cappetta per la registrazione del morso e vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio/PBT	1	K2111.3800	3.8 mm
			K2111.4300	4.3 mm
			K2111.5000	5.0 mm
			K2111.6000	6.0 mm
Nuovo	**Ausilio di riposizionamento** per transfer da impronta, porta-impronte chiuso, sterile **Materiale** PBT	6	J2111.3310	3.3 mm
			J2111.3810	3.8 mm
			J2111.4310	4.3 mm
			J2111.5010	5.0 mm
			J2111.6010	6.0 mm

Tramite il nostro partner di servizio CAD/CAM DEDICAM® è possibile ricevere transfer da impronta personalizzati, formalmente congruenti con cappette di guarigione personalizzate.
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

Registrazione del morso

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
Nuovo	**Transfer per la registrazione del morso CAMLOG®** incl. vite di ritenzione e cappetta per la registrazione del morso, sterile **Materiale** Lega di titanio/PBT	1	J2141.3300	3.3 mm
			J2141.3800	3.8 mm
			J2141.4300	4.3 mm
			J2141.5000	5.0 mm
Nuovo	**Cappetta per la registrazione del morso** sterile **Materiale** PBT	6	J2112.3310	3.3 mm
			J2112.3810	3.8 mm
			J2112.4310	4.3 mm
			J2112.5010	5.0 mm
			J2112.6010	6.0 mm

Realizzazione del modello

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	Analogo da laboratorio CAMLOG® per modelli colati **Materiale** Lega di titanio	1	K3010.3300	3.3 mm
			K3010.3800	3.8 mm
			K3010.4300	4.3 mm
			K3010.5000	5.0 mm
			K3010.6000	6.0 mm
		3	K3010.3303	3.3 mm
			K3010.3803	3.8 mm
			K3010.4303	4.3 mm
			K3010.5003	5.0 mm
	Analogo d'impianto CAMLOG® per modelli stampati e colati **Materiale** Lega di titanio	1	K3025.3300	3.3 mm
			K3025.3800	3.8 mm
			K3025.4300	4.3 mm
			K3025.5000	5.0 mm
			K3025.6000	6.0 mm
		3	K3025.3303	3.3 mm
			K3025.3803	3.8 mm
			K3025.4303	4.3 mm
			K3025.5003	5.0 mm
	Strumento manuale per analogo d'impianto **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J3025.0010	3.3 mm
				3.8 mm
				4.3 mm
			J3025.0015	5.0 mm
				6.0 mm
	DIM-Analog® per il sistema implantare CAMLOG® per modelli stampati, incl. vite a testa zigrinata **Materiale** Lega di titanio/Acciaio inossidabile	-	CAM 5.DIM.330	3.3 mm
			CAM 5.DIM.380	3.8 mm
			CAM 5.DIM.430	4.3 mm
			CAM 5.DIM.506	5.0 mm
				6.0 mm

Fabbricante DIM-Analog®: NT-Trading GmbH & Co. KG | G.-Braun-Straße 18 | 76187 Karlsruhe | Germania
DIM-Analog® è un marchio registrato dell'azienda NT-Trading GmbH & Co. KG.

Abutment provvisori

	Articolo	Art. n°	Ø
	Abutment provvisorio CAMLOG®, PEEK personalizzabile, incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** PEEK	K2241.3800	3.8 mm
		K2241.4300	4.3 mm
		K2241.5000	5.0 mm
		K2241.6000	6.0 mm
PS	**Abutment provvisorio CAMLOG® PS, PEEK, per Platform Switching** personalizzabile, incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** PEEK	K2208.3800	3.8 mm
		K2208.4300	4.3 mm
		K2208.5000	5.0 mm
		K2208.6000	6.0 mm
	Abutment provvisorio CAMLOG®, corona incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2239.3300*	3.3 mm
		K2239.3800	3.8 mm
		K2239.4300	4.3 mm
		K2239.5000	5.0 mm
		K2239.6000	6.0 mm
	Abutment provvisorio CAMLOG®, ponte incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	J2339.3300	3.3 mm
		J2339.3800	3.8 mm
		J2339.4300	4.3 mm
		J2339.5000	5.0 mm
		J2339.6000	6.0 mm

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori

Le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

Basi in titanio CAD/CAM

	Articolo	Art. n°	Ø	AG
	Base in titanio CAD/CAM CAMLOG®, corona incl. vite per abutment CAMLOG® e ausilio per incollaggio CAMLOG® (POM) **Materiale** Lega di titanio/POM	K2244.3348*	3.3 mm	0.4 mm
		K2244.3848	3.8 mm	0.3 mm
		K2244.4348	4.3 mm	
		K2244.5048	5.0 mm	
		K2244.6048	6.0 mm	
	Base in titanio CAD/CAM CAMLOG®, ponte incl. vite per abutment CAMLOG® e ausilio per incollaggio CAMLOG® (POM) **Materiale** Lega di titanio/POM	J2344.3348	3.3 mm	0.4 mm
		J2344.3848	3.8 mm	
		J2344.4348	4.3 mm	
		J2344.5048	5.0 mm	
		J2344.6048	6.0 mm	
PS	**Base in titanio CAD/CAM CAMLOG® PS per Platform Switching, corona** incl. vite per abutment CAMLOG® e ausilio per incollaggio CAMLOG® (POM) **Materiale** Lega di titanio/POM	K2210.3808	3.8 mm	0.8 mm
		K2210.4308	4.3 mm	
		K2210.5008	5.0 mm	
	Ausilio per modellazione CAMLOG® per base in titanio CAD/CAM CAMLOG®, corona calcinabile **Materiale** POM	J2244.3302	3.3 mm	-
		J2244.3802	3.8 mm	
		J2244.4302	4.3 mm	
		J2244.5002	5.0 mm	
		J2244.6002	6.0 mm	
	Ausilio per incollaggio CAMLOG® 2 unità **Materiale** POM	J4009.1600	3.3 mm	-
			3.8 mm	
			4.3 mm	
		J4009.2000	5.0 mm	
			6.0 mm	

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori

Le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

Sono disponibili le geometrie delle basi in titanio CAD/CAM CAMLOG® per i principali sistemi dentali CAD sotto forma di libreria CAD.
Le librerie possono essere scaricate gratuitamente qui:
www.biohorizonscamlog.com/cad-libraries
Svizzera: www.camlog.ch/cad-bibliotheken

Componenti protesici CAD/CAM DEDICAM® di Camlog
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/ Camlog locale.

Basi in titanio CAD/CAM free

	Articolo	Misura	Art. n°	Ø	AG
	Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free, per corona incl. vite per abutment e vite da laboratorio **Materiale** Lega di titanio	corto	K2247.3348*	3.3 mm	0.4 mm
			K2247.3848	3.8 mm	0.3 mm
			K2247.4348	4.3 mm	
			K2247.5048	5.0 mm	
PS	**Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free PS, per corona, per Platform Switching** incl. vite per abutment e vite da laboratorio **Materiale** Lega di titanio	corto	K2247.3808	3.8 mm	0.8 mm
			K2247.4308	4.3 mm	
			K2247.5008	5.0 mm	
	Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free, per corona incl. vite per abutment e vite da laboratorio **Materiale** Lega di titanio	lungo	K2265.3848	3.8 mm	0.3 mm
			K2265.4348	4.3 mm	
			K2265.5048	5.0 mm	
PS	**Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free PS, per corona, per Platform Switching** incl. vite per abutment e vite da laboratorio **Materiale** Lega di titanio	lungo	K2265.3808	3.8 mm	0.8 mm
			K2265.4308	4.3 mm	
			K2265.5008	5.0 mm	

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori

Per serrare la vite per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) si utilizzano i cacciaviti Ballpoint (in caso di canale della vite angolato) e i cacciaviti, hex (in caso di canale della vite diritto) (vedere pagina 88).

Sono disponibili le geometrie delle basi in titanio CAMLOG® CAD/CAM free per i principali sistemi dentali CAD sotto forma di libreria CAD.
Le librerie possono essere scaricate gratuitamente qui:
www.biohorizonscamlog.com/cad-libraries
Svizzera: www.camlog.ch/cad-bibliotheken

CAM Blank

Tipo AG

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
Nuovo	**CAMLOG® CAM Blank in titanio, tipo AG** per il sistema CAD/CAM Ceramill® di Amann Girrbach, Ø 12 mm; spedizione comprensiva di 2 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	2	K2471.3327*	3.3 mm
			K2471.3827	3.8 mm
			K2471.4327	4.3 mm
			K2471.5027	5.0 mm
			K2471.6027	6.0 mm

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori (Ø 3.3 mm non per ricostruzioni a doppia corona)

I monconi in titanio CAM, tipo AG, sono stati sviluppati congiuntamente da CAMLOG Biotechnologies GmbH e da Amann Girrbach AG. Sono provvisti della geometria di connessione brevettata di Amann Girrbach® per l'alloggiamento del moncone e sono compatibili con il sistema CAD/CAM Ceramill®.
Le corrispondenti librerie CAD possono essere scaricate sia dal biohorizonscamlog.com/cad-libraries che dal portale AG.live di Amann Girrbach® oppure sono disponibili tramite il Software-Manager di Amann Girrbach stessa.

Tipo ME

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	CAMLOG® CAM Blank in titanio, tipo ME Ø 12 mm, lunghezza 20 mm; spedizione comprensiva di 2 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	2	K2441.3320*	3.3 mm
			K2441.3820	3.8 mm
			K2441.4320	4.3 mm
			K2441.5020	5.0 mm
			K2441.6020	6.0 mm
	CAMLOG® CAM Blank in titanio, tipo ME Ø 12 mm, lunghezza 20 mm; spedizione comprensiva di 10 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	10	K2442.3320*	3.3 mm
			K2442.3820	3.8 mm
			K2442.4320	4.3 mm
			K2442.5020	5.0 mm
			K2442.6020	6.0 mm
	CAMLOG® CAM Blank in CoCr, tipo ME Ø 12 mm, lunghezza 20 mm; spedizione comprensiva di 2 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di cobalto-cromo	2	K2461.3320*	3.3 mm
			K2461.3820	3.8 mm
			K2461.4320	4.3 mm
			K2461.6020	5.0 mm
				6.0 mm

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori (Ø 3.3 mm non per ricostruzioni a doppia corona)

Per la lavorazione tecnica di fresaggio si fissa il moncone CAM tipo ME a una sezione cilindrica opposta alla connessione impianto-abutment. Come dispositivi di serraggio specifici della macchina possono essere impiegati gli appositi supporti per abutment PreFace® di Medentika®. Questi supporti sono disponibili per macchine selezionate dei rispettivi fabbricanti. I monconi necessitano di librerie CAM specifiche del prodotto.
Per domande sulla compatibilità rivolgersi al Servizio Tecnico di DEDICAM® all'indirizzo di posta elettronica dedicam.cad@camlog.com.

Medentika® e PreFace® sono marchi registrati di Medentika GmbH, D-Hügelsheim.

CAM Blank

Tipo IAC

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	CAMLOG® CAM Blank in titanio, tipo IAC Ø 12 mm, lunghezza 12.5 mm; spedizione comprensiva di 2 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	2	K2431.3313*	3.3 mm
			K2431.3813	3.8 mm
			K2431.4313	4.3 mm
			K2431.5013	5.0 mm
			K2431.6013	6.0 mm
	CAMLOG® CAM Blank in titanio, tipo IAC Ø 12 mm, lunghezza 12.5 mm; spedizione comprensiva di 10 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	10	K2432.3313*	3.3 mm
			K2432.3813	3.8 mm
			K2432.4313	4.3 mm
			K2432.5013	5.0 mm
			K2432.6013	6.0 mm
	Alloggiamento CAMLOG® per CAM Blank in titanio, tipo IAC Ø 6 mm, lunghezza 17 mm, include 2 viti di fissaggio CAMLOG® per CAM Blank titanio tipo IAC **Materiale** Acciaio inossidabile	1	K3720.3300	3.3 mm
			K3720.3800	3.8 mm
			K3720.4300	4.3 mm
			K3720.6000	5.0 mm
				6.0 mm

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori (Ø 3.3 mm non per ricostruzioni a doppia corona)

Per la lavorazione tecnica di fresaggio si fissa il moncone in titanio CAM tipo IAC alla connessione impianto-abutment tramite l'alloggiamento CAMLOG® per monconi CAM. Il supporto e/o l'adattatore specifico della macchina per l'alloggiamento, nonché le tecniche di fresaggio devono essere predisposti dall'utilizzatore.

Sono disponibili le geometrie dei monconi CAM CAMLOG® per i principali sistemi dentali CAD sotto forma di libreria CAD.
Le librerie possono essere scaricate gratuitamente qui:
www.biohorizonscamlog.com/cad-libraries
Svizzera: www.camlog.ch/cad-bibliotheken

Le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

Abutment Esthomic®

	Articolo	Art. n°	Ø	AG
	Abutment CAMLOG® Esthomic®, diritti incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2226.3810	3.8 mm	1.0–1.8 mm
		K2226.3830		3.0–4.5 mm
		K2226.4310	4.3 mm	1.0–1.8 mm
		K2226.4330		3.0–4.5 mm
		K2226.5010	5.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2226.5030		3.0–4.5 mm
		K2226.6010	6.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2226.6030		3.0–4.5 mm
	Abutment CAMLOG® Esthomic®, Inset incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2235.3315*	3.3 mm	1.5–2.8 mm
		K2235.3815	3.8 mm	
		K2235.4315	4.3 mm	
		K2235.5015	5.0 mm	
		K2235.6015	6.0 mm	
PS 	**Abutment CAMLOG® Esthomic® PS, diritti** incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2202.3815	3.8 mm	1.5–2.5 mm
		K2202.4315	4.3 mm	
		K2202.5015	5.0 mm	
		K2202.6015	6.0 mm	

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori

Le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

Abutment Esthomic®

	Articolo	Art. n°	Ø	AG
	**Abutment CAMLOG® Esthomic®, angolati a 15°, tipo A** incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2227.3810	3.8 mm	1.0–1.8 mm
		K2227.3830		3.0–4.5 mm
		K2227.4310	4.3 mm	1.0–1.8 mm
		K2227.4330		3.0–4.5 mm
		K2227.5010	5.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2227.5030		3.0–4.5 mm
		K2227.6010	6.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2227.6030		3.0–4.5 mm
	Abutment CAMLOG® Esthomic®, angolati a 15°, tipo B incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2228.3810	3.8 mm	1.0–1.8 mm
		K2228.3830		3.0–4.5 mm
		K2228.4310	4.3 mm	1.0–1.8 mm
		K2228.4330		3.0–4.5 mm
		K2228.5010	5.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2228.5030		3.0–4.5 mm
		K2228.6010	6.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2228.6030		3.0–4.5 mm
	Abutment CAMLOG® Esthomic®, angolati a 20°, tipo A incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2231.3810	3.8 mm	1.0–1.8 mm
		K2231.3830		3.0–4.5 mm
		K2231.4310	4.3 mm	1.0–1.8 mm
		K2231.4330		3.0–4.5 mm
		K2231.5010	5.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2231.5030		3.0–4.5 mm
		K2231.6010	6.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2231.6030		3.0–4.5 mm
	Abutment CAMLOG® Esthomic®, angolati a 20°, tipo B incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2232.3810	3.8 mm	1.0–1.8 mm
		K2232.3830		3.0–4.5 mm
		K2232.4310	4.3 mm	1.0–1.8 mm
		K2232.4330		3.0–4.5 mm
		K2232.5010	5.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2232.5030		3.0–4.5 mm
		K2232.6010	6.0 mm	1.0–1.8 mm
		K2232.6030		3.0–4.5 mm
PS 	**Abutment CAMLOG® Esthomic® PS, angolati a 15°, tipo A** incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2203.3815	3.8 mm	1.5–2.5 mm
		K2203.4315	4.3 mm	
		K2203.5015	5.0 mm	
		K2203.6015	6.0 mm	
PS 	**Abutment CAMLOG® Esthomic® PS, angolati a 15°, tipo B** incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2204.3815	3.8 mm	1.5–2.5 mm
		K2204.4315	4.3 mm	
		K2204.5015	5.0 mm	
		K2204.6015	6.0 mm	

Le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

Abutment universali

	Articolo	Art. n°	Ø	Misura
	Abutment universale CAMLOG® incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2211.3300*	3.3 mm	-
		K2211.3800	3.8 mm	
		K2211.4300	4.3 mm	
		K2211.5000	5.0 mm	
		K2211.6000	6.0 mm	
PS	**Abutment universale CAMLOG® PS** incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2201.3800	3.8 mm	-
		K2201.4300	4.3 mm	
		K2201.5000	5.0 mm	
		K2201.6000	6.0 mm	

Abutment in oro-resina

	Articolo	Art. n°	Ø	Peso del metallo nobile
	**Abutment in oro-resina CAMLOG®** da sovrafusione, incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega aurea per la tecnica di sovrafusione/POM	K2246.3300*	3.3 mm	circa 0.42 g
		K2246.3800	3.8 mm	circa 0.46 g
		K2246.4300	4.3 mm	circa 0.65 g
		K2246.5000	5.0 mm	circa 0.81 g
		K2246.6000	6.0 mm	circa 0.89 g

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori (Ø 3.3 mm non per ricostruzioni a doppia corona)

Le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

COMFOUR®

	Articolo	Art. n°	Tipo	Ø	AG	Ø PP
	Pilastri a barra CAMLOG®, diritti sterili **Materiale** Lega di titanio	J2254.3305	-	3.3 mm	0.5 mm	4.3 mm
		J2254.3320			2.0 mm	
		J2254.3805		3.8 mm	0.5 mm	
		J2254.3820			2.0 mm	
		J2254.3840			4.0 mm	
		J2254.4305		4.3 mm	0.5 mm	
		J2254.4320			2.0 mm	
		J2254.4340			4.0 mm	
		J2254.5005		5.0 mm	0.5 mm	6.0 mm
		J2254.5020			2.0 mm	
		J2254.5040			4.0 mm	
	Pilastri a barra CAMLOG®, angolati a 17° incl. vite per abutment CAMLOG® anodizzata azzurro, con testa ridotta, hex, sterile **Materiale** Lega di titanio	K2256.3325	A	3.3 mm	2.5 mm	4.3 mm
		K2256.3340			4.0 mm	
		K2257.3325	B		2.5 mm	
		K2257.3340			4.0 mm	
		K2256.3825	A	3.8 mm	2.5 mm	
		K2256.3840			4.0 mm	
		K2257.3825	B		2.5 mm	
		K2257.3840			4.0 mm	
		K2256.4325	A	4.3 mm	2.5 mm	
		K2256.4340			4.0 mm	
		K2257.4325	B		2.5 mm	
		K2257.4340			4.0 mm	
		K2256.5025	A	5.0 mm	2.5 mm	6.0 mm
		K2256.5040			4.0 mm	
		K2257.5025	B		2.5 mm	
		K2257.5040			4.0 mm	
	Pilastri a barra CAMLOG®, angolati a 30° incl. vite per abutment CAMLOG® anodizzata azzurro, con testa ridotta, hex, sterile **Materiale** Lega di titanio	K2258.3325	A	3.3 mm	2.5 mm	4.3 mm
		K2258.3340			4.0 mm	
		K2259.3325	B		2.5 mm	
		K2259.3340			4.0 mm	
		K2258.3825	A	3.8 mm	2.5 mm	
		K2258.3840			4.0 mm	
		K2259.3825	B		2.5 mm	
		K2259.3840			4.0 mm	
		K2258.4325	A	4.3 mm	2.5 mm	
		K2258.4340			4.0 mm	
		K2259.4325	B		2.5 mm	
		K2259.4340			4.0 mm	
		K2258.5035	A	5.0 mm	3.5 mm	6.0 mm
		K2258.5050			5.0 mm	
		K2259.5035	B		3.5 mm	
		K2259.5050			5.0 mm	

Tipo A e B, vedere pagina 8

Per serrare la vite per abutment CAMLOG® con testa ridotta, hex, si utilizzano i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

	Articolo	Misura	Art. n°	Ø	Dimensioni
	Inseritore per pilastri a barra diritti **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5300.0020	3.3 mm	18.6 mm
				3.8 mm	
				4.3 mm	
			J5300.0025	5.0 mm	
		lungo	J5300.0021	3.3 mm	28.0 mm
				3.8 mm	
				4.3 mm	
	Dima per orientamento COMFOUR® per foro pilota Ø 2.0 mm **Materiale** Nitinol	-	J3551.0001	-	-
	Ausilio di orientamento per pilastri a barra angolati, per applicatori **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J2269.0005	-	17°
			J2269.0006		30°
	**Indicatore di altezza gengivale, diritto** **Materiale** Lega di titanio	-	J3550.3300	3.3 mm	-
			J3550.3800	3.8 mm	
			J3550.4300	4.3 mm	
			J3550.5000	5.0 mm	
	Cappetta di guarigione per pilastro a barra parzialmente anodizzata azzurro, sterile **Materiale** Lega di titanio	-	J2029.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
			J2029.6000	5.0 mm / 6.0 mm	
	Cappetta per presa d'impronta per pilastro a barra, porta-impronte chiuso (ponte) parzialmente anodizzata azzurro, sterile **Materiale** Lega di titanio	corta	J2129.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	6.5 mm
			J2129.6000	5.0 mm / 6.0 mm	7.0 mm
		lunga	J2129.4310	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	11.0 mm
			J2129.6010	5.0 mm / 6.0 mm	
	Inseritore per transfer da impronta e cappette di guarigione per pilastri a barra **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5300.0027	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	19.1 mm
			J5300.0028	5.0 mm / 6.0 mm	
	Analogo da laboratorio per barra per pilastri a barra, per modelli colati **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J3020.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
			J3020.6000	5.0 mm / 6.0 mm	

COMFOUR®

	Articolo	Art. n°	Ø			Dimensioni
	Analogo d'impianto per barra per pilastri a barra, per modelli stampati e colati	J3025.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale Acciaio inossidabile	J3025.6000	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta di scansione per pilastri a barra incl. vite protesica anodizzata azzurro, sterile	J2610.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale PEEK	J2610.6000	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta di scansione per pilastri a barra CAMLOG®/CONELOG® incl. vite protesica anodizzata azzurro, multiuso	J2630.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale Lega di titanio	J2630.6000	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta in titanio per pilastro a barra, per corona incl. vite protesica anodizzata azzurro, sterile	J2259.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale Lega di titanio	J2259.6001	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta in titanio per pilastro a barra, per ponte incl. vite protesica anodizzata azzurro, sterile	J2259.4302	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale Lega di titanio	J2259.6002	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta in titanio senza ritenzione per pilastro a barra, per ponte incl. vite protesica anodizzata azzurro	J2259.4322	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale Lega di titanio	J2259.6022	5.0 mm	6.0 mm		
	Base per corona per pilastro a barra calcinabile	J2256.4306	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale POM	J2256.6006	5.0 mm	6.0 mm		
	Base per pilastro a barra calcinabile	J2257.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale POM	J2257.6001	5.0 mm	6.0 mm		
	Base per pilastro a barra da sovrafusione	J2263.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	circa 0.48 g
	Materiale Lega aurea per la tecnica di sovrafusione/POM	J2263.6000	5.0 mm	6.0 mm		circa 0.70 g
	Base per pilastro a barra brasabile	J2258.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
	Materiale Lega aurea brasabile	J2258.6000	5.0 mm	6.0 mm		

	Articolo	Art. n°	Ø			Filettatura
	Base per pilastro a barra, titanio saldabile al laser **Materiale** Titanio grado 4	J2262.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2262.6000	5.0 mm	6.0 mm		
	Base adesiva in titanio per pilastro a barra Passive-Fit **Materiale** Lega di titanio	J2260.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2260.6001	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta per base adesiva in titanio calcinabile, Passive-Fit, incl. vite protesica per pilastro a barra, hex (solo per la realizzazione della struttura colata in combinazione con cappette per base adesiva in titanio Passive-Fit) **Materiale** POM	J2261.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2261.6001	5.0 mm	6.0 mm		
	Protettivo per lucidare cappette e basi per pilastro a barra **Materiale** Lega di titanio	J3021.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		J3021.6000	5.0 mm	6.0 mm		M2.0
	Vite per abutment CAMLOG® con testa ridotta, hex, anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	J4004.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		J4004.2001	5.0 mm			M2.0
	Vite da laboratorio CAMLOG® con testa ridotta, hex, parzialmente anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	J4004.1600	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		J4004.2000	5.0 mm			M2.0
	Vite protesica per pilastro a barra hex, anodizzata azzurro (per il fissaggio definitivo della ricostruzione) **Materiale** Lega di titanio	J4012.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		J4012.2001	5.0 mm	6.0 mm		M2.0
	Vite protesica da laboratorio per pilastro a barra, hex, anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	J4013.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		J4013.2001	5.0 mm	6.0 mm		M2.0

Le viti da laboratorio non devono essere utilizzate sul paziente!

Le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) e le viti protesiche per pilastri a barra (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

COMFOUR®

	Articolo	Art. n°	Lunghezza	Filettatura
	**Vite, hex** per pilastro a barra, anodizzata azzurro, sterile **Materiale** Lega di titanio	J4012.1610	10 mm	M1.6
		J4012.2010		M2.0
		J4012.1615	15 mm	M1.6
		J4012.2015		M2.0
		J4012.1620	20 mm	M1.6
		J4012.2020		M2.0
	Vite in PEEK, per pilastro a barra hex, lunghezza 27 mm, sterile **Materiale** PEEK	J4009.1627	-	M1.6
		J4009.2027		M2.0

Pilastro a sfera

	Articolo	Art. n°	Ø	AG	L
	Pilastro a sfera CAMLOG®, patrice incl. anello di stabilizzazione **Materiale** Lega di titanio/Resina	J2249.3315	3.3 mm	1.5 mm	-
		J2249.3330		3.0 mm	
		J2249.3815	3.8 mm	1.5 mm	
		J2249.3830		3.0 mm	
		J2249.3845		4.5 mm	
		J2249.4315	4.3 mm	1.5 mm	
		J2249.4330		3.0 mm	
		J2249.4345		4.5 mm	
		J2249.5015	5.0 mm	1.5 mm	
		J2249.5030		3.0 mm	
		J2249.5045		4.5 mm	
	Inseritore per pilastro a sfera, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	J5300.0011	-	-	18.3 mm
	Matrice CM Dalbo®-Plus per pilastro a sfera, incl. inserto di ritenzione lamellare e ausilio di duplicazione **Materiale** Titanio grado 4 / Lega aurea	05003503	3.3 mm	-	-
			3.8 mm		
			4.3 mm		
			5.0 mm		
	Inserto di ritenzione lamellare per matrice CM Dalbo®-Plus **Materiale** Lega aurea	05003504	3.3 mm	-	-
			3.8 mm		
			4.3 mm		
			5.0 mm		
	Analogo del pilastro a sfera incl. anello di stabilizzazione **Materiale** Lega di titanio/Resina	J3015.3300	3.3 mm	-	-
		J3015.3800	3.8 mm		
		J3015.4300	4.3 mm		
		J3015.5000	5.0 mm		

Dalbo®-Plus è un marchio registrato della società Cendres + Métaux SA, Biel, Svizzera.

Locator®

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø	AG	L
	Pilastro CAMLOG® Locator® **Materiale** Lega di titanio/TiN	1	J2253.3310	3.3 mm	1.0 mm	-
			J2253.3320		2.0 mm	
			J2253.3330		3.0 mm	
			J2253.3340		4.0 mm	
			J2253.3810	3.8 mm	1.0 mm	
			J2253.3820		2.0 mm	
			J2253.3830		3.0 mm	
			J2253.3840		4.0 mm	
			J2253.3850		5.0 mm	
			J2253.4310	4.3 mm	1.0 mm	
			J2253.4320		2.0 mm	
			J2253.4330		3.0 mm	
			J2253.4340		4.0 mm	
			J2253.4350		5.0 mm	
			J2253.5010	5.0 mm	1.0 mm	
			J2253.5020		2.0 mm	
			J2253.5030		3.0 mm	
			J2253.5040		4.0 mm	
			J2253.5050		5.0 mm	
	Inseritore per pilastri Locator® manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0001	-	-	24.3 mm
	Strumento Locator® in 3 parti **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0002	-	-	83.0 mm
	Cappetta per presa d'impronta Locator® **Materiale** Alluminio/Polietilene	4	J2253.0200	-	-	-
	Analogo Locator® **Materiale** Alluminio	4	J2253.0340	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	-	-
			J2253.0350	5.0 mm		
	Anello di bloccaggio Locator® **Materiale** Teflon	20	J2253.0401	-	-	-
	Inserto di lavorazione Locator® **Materiale** Polietilene	4	J2253.0402	-	-	-

	Articolo	Quantità	Colore	Ritenzione	Divergenza	Art. n°
	**Set da laboratorio Locator®** **Contenuto del set:** 1 alloggiamento di ritenzione con inserto di lavorazione, 1 anello di bloccaggio bianco, 1 inserto di ritenzione trasparente, 1 inserto di ritenzione rosa, 1 inserto di ritenzione blu **Materiale** Lega di titanio/Polietilene/ Teflon/Nylon	2	-	-	-	J2253.0102
	Set da laboratorio Locator® per angolazione estesa **Contenuto del set:** 1 alloggiamento di ritenzione con inserto di lavorazione, 1 anello di bloccaggio bianco, 1 inserto di ritenzione verde, 1 inserto di ritenzione arancio, 1 inserto di ritenzione rosso **Materiale** Lega di titanio/Polietilene/ Teflon/Nylon	2	-	-	-	J2253.0112*
	Inserto di ritenzione Locator® **Materiale** Nylon	4	tra-sparente	forte	0°–10°	J2253.1005
			rosa	medio		J2253.1003
			blu	leggero		J2253.1002
	Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa **Materiale** Nylon	4	verde	forte	10°–20°	J2253.2004*
			arancio	medio		J2253.2003*
			rosso	leggero		J2253.2002*
			grigio	nessuna	0°–20°	J2253.2000*

* non ammesso per Ø impianto di 3.3 mm

Fabbricante Locator®: Zest Anchors | 2875 Loker Avenue East, Carlsbad | California 92010 | USA
Locator® e Locator R-Tx® sono marchi registrati di Zest Anchors.

Locator R-Tx®

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø	AG
	Pilastro CAMLOG® Locator R-Tx® incl. alloggiamento di ritenzione con inserto di lavorazione nero, anello di bloccaggio bianco e quattro diversi inserti di ritenzione **Materiale** Lega di titanio/Nylon	1	30800-01	3.3 mm	1.0 mm
			30800-02		2.0 mm
			30800-03		3.0 mm
			30800-04		4.0 mm
			30801-01	3.8 mm	1.0 mm
			30801-02		2.0 mm
			30801-03		3.0 mm
			30801-04		4.0 mm
			30801-05		5.0 mm
			30802-01	4.3 mm	1.0 mm
			30802-02		2.0 mm
			30802-03		3.0 mm
			30802-04		4.0 mm
			30802-05		5.0 mm
			30803-01	5.0 mm	1.0 mm
			30803-02		2.0 mm
			30803-03		3.0 mm
			30803-04		4.0 mm
			30803-05		5.0 mm
	Strumento per inserto di ritenzione Locator R-Tx® con maniglia in plastica **Materiale** Acciaio inossidabile	1	30021-01	-	-
	Cappetta per presa d'impronta Locator R-Tx® **Materiale** Polietilene	4	30017-01	-	-
	Analogo Locator R-Tx® **Materiale** Alluminio	4	30014-01	3.3 mm	-
		4	30015-01	3.8 mm 4.3 mm	-
		4	30016-01	5.0 mm	-

I pilastri CAMLOG® Locator R-Tx® vengono serrati con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

	Articolo	Quantità	Colore	Ritenzione	Art. n°
	Alloggiamento di ritenzione Locator R-Tx® con inserto di lavorazione **Materiale** Lega di titanio/Polietilene	4	nero	-	30013-01
	Anello di bloccaggio Locator® **Materiale** Teflon	20	bianco	-	J2253.0401
	Inserto di lavorazione Locator R-Tx® **Materiale** Polietilene	4	nero	-	30012-01
	Distanziale da laboratorio/ausilio di duplicazione Locator R-Tx® **Materiale** Polietilene	4	-	-	30018-01
	Inserto di ritenzione Locator R-Tx® **Materiale** Nylon	4	grigio	nessuna	30001-01
		4	blu	leggero	30002-01
		4	rosa	medio	30003-01
		4	bianco	forte	30004-01

Ricostruzione a doppia corona

	Articolo	Art. n°	Ø
	Abutment universale CAMLOG®, incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2211.3800	3.8 mm
		K2211.4300	4.3 mm
		K2211.5000	5.0 mm
		K2211.6000	6.0 mm
PS	**Abutment universale CAMLOG® PS** incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2201.3800	3.8 mm
		K2201.4300	4.3 mm
		K2201.5000	5.0 mm
		K2201.6000	6.0 mm
	Abutment telescopico CAMLOG® per la tecnica a doppia corona incl. vite per abutment CAMLOG® **Materiale** Lega di titanio	K2212.3800	3.8 mm
		K2212.4300	4.3 mm
		K2212.5000	5.0 mm
		K2212.6000	6.0 mm

Le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 88).

Viti per abutment e da laboratorio

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø	Filettatura
	Vite per abutment CAMLOG®, hex **Materiale** Lega di titanio	1	J4005.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
			J4005.2001	5.0 mm 6.0 mm	M2.0
	Vite da laboratorio CAMLOG®, hex anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	1	J4006.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
			J4006.2001	5.0 mm 6.0 mm	M2.0
		3	J4006.1603	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
			J4006.2003	5.0 mm 6.0 mm	M2.0
	Vite per abutment CAMLOG® con testa ridotta, hex, anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	1	J4004.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
			J4004.2001	5.0 mm	M2.0
	Vite da laboratorio CAMLOG® con testa ridotta, hex, parzialmente anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	1	J4004.1600	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
			J4004.2000	5.0 mm	M2.0
	Vite protesica per pilastro a barra hex, anodizzata azzurro (per il fissaggio definitivo della ricostruzione) **Materiale** Lega di titanio	1	J4012.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
			J4012.2001	5.0 mm 6.0 mm	M2.0
	Vite protesica da laboratorio per pilastro a barra, hex, anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	1	J4013.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
			J4013.2001	5.0 mm 6.0 mm	M2.0

Per serrare le viti per abutment CAMLOG® (M1.6/M2.0) si utilizzano i cacciaviti Ballpoint (in caso di canale della vite angolato) e i cacciaviti, hex (in caso di canale della vite diritto) (vedere pagina 88).

Le viti da laboratorio non devono essere utilizzate sul paziente!

Strumenti protesici

	Articolo	Misura	Art. n°	L
	Chiave dinamometrica fino a max. 30 Ncm **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5320.1030	-
	**Cacciavite** hex, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	extra corto	J5317.0510	14.5 mm
		corto	J5317.0501	22.5 mm
		lungo	J5317.0502	30.3 mm
	**Cacciavite** hex, gambo ISO **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5317.0504	18.0 mm
		lungo	J5317.0503	26.0 mm
	**Cacciavite Ballpoint** hex, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5319.0501*	24 mm
		lungo	J5319.0502*	32 mm
	Cacciavite Ballpoint hex, gambo ISO **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5319.0504*	27 mm
		lungo	J5319.0503*	35 mm
	Cacciavite manuale hex, senza attacco per testa a cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5317.0511	23.0 mm

* Da utilizzare solo con canale della vite angolato

	Articolo	Misura	Art. n°	Ø	L
	**Inseritore per pilastri a barra diritti** **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5300.0020	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	18.6 mm
			J5300.0025	5.0 mm	
		lungo	J5300.0021	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	28.0 mm
	**Inseritore per transfer da impronta e cappette di guarigione per pilastri a barra** **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5300.0027	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	19.1 mm
			J5300.0028	5.0 mm	
	Inseritore per pilastro a sfera, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5300.0011	-	18.3 mm
	Cacciavite Attivatore per matrice di pilastro a sfera CM Dalbo®-Plus **Materiale** Acciaio inossidabile	-	07000389	-	-

Strumenti protesici

	Articolo	Quantità	Art. n°	L
	Inseritore per Locator®, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0001	24.3 mm
	Strumento Locator® in 3 parti **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0002	83.0 mm
	Guaina per sostegno per pilastri Locator® per componenti dorati dello strumento Locator® **Materiale** Polisolfone	4	08394	-
	Calibro per misura angolare Locator® **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0003	-
	Perno per misura angolare Locator® **Materiale** Polietilene	4	J2253.0004	-
	Strumento per inserto di ritenzione Locator R-Tx® con maniglia in plastica **Materiale** Acciaio inossidabile	1	30021-01	-
	Tray per componenti protesici universale (senza contenuto) risterilizzabile **Materiale** Radel®, silicone	1	J5330.8700	162 × 73 × 29 mm

Strumenti odontotecnici

	Articolo	Art. n°	Ø
	Strumento manuale per analogo d'impianto **Materiale** Acciaio inossidabile	J3025.0010	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
		J3025.0015	5.0 mm
			6.0 mm
	Supporto universale incl. 2 viti da laboratorio CAMLOG®, hex, e 1 alloggiamento per abutment CAMLOG® **Materiale** Acciaio inossidabile/Lega di titanio	J3709.0010	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
			5.0 mm
			6.0 mm
	Supporto universale **Materiale** Acciaio inossidabile	J3709.0015	-
	Alloggiamento per abutment CAMLOG® per supporto universale **Materiale** Lega di titanio	J3709.3300	3.3 mm
		J3709.3800	3.8 mm
		J3709.4300	4.3 mm
		J3709.5000	5.0 mm
		J3709.6000	6.0 mm
	Fresa per gesso per supporto universale incl. perno di guida codificato per colore **Materiale** Acciaio inossidabile/Lega di titanio	J3706.3300	3.3 mm
		J3706.3800	3.8 mm
		J3706.4300	4.3 mm
		J3706.5000	5.0 mm
		J3706.6000	6.0 mm
	Strumento di finitura, base per pilastro a barra superficie piana/cono, per cappette calcinabili **Materiale** Acciaio inossidabile/Ottone	J3711.0010	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
		J3711.0015	5.0 mm
			6.0 mm
	Strumento di finitura, base per pilastro a barra sede vite, per cappette calcinabili **Materiale** Acciaio inossidabile/Ottone	J3711.0020	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
		J3711.0025	5.0 mm
			6.0 mm

Selezione dell’abutment

	Articolo	Art. n°
	Set di abutment per selezione dell’abutment CAMLOG® (Contenuto: 2 unità cad., secondo la tabella sottostante)	K8011.1000

Contenuto: set di abutment per selezione dell’abutment CAMLOG®					
Articolo	Materiale	Ø			AG
Abutment per selezione di: CAMLOG® Esthomic®, diritto*	POM	3.8 mm	4.3 mm	5.0 mm	1.0–1.8
					3.0–4.5
Abutment per selezione di: CAMLOG® Esthomic®, angolato a 15°, tipo A*					1.0–1.8
Abutment per selezione di: CAMLOG® Esthomic®, angolato a 15°, tipo B*					
Abutment per selezione di: CAMLOG® Esthomic®, angolato a 20°, tipo A*					
Abutment per selezione di: CAMLOG® Esthomic®, angolato a 20°, tipo B*					

* Questi prodotti non sono disponibili singolarmente.

Non utilizzare gli abutment per selezione sul paziente!

Articoli aggiuntivi

Impianti per esercitazione

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Impianto per esercitazione CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE incl. applicatore innestato e vite tappo, anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	K1901.3813	3.8 mm	13 mm
		K1901.4313	4.3 mm	
	Impianto per esercitazione CAMLOG® SCREW-LINE incl. applicatore e vite tappo, anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	K1049.3813	3.8 mm	13 mm
		K1049.4313	4.3 mm	

Non utilizzare gli impianti per esercitazione sul paziente!

Applicatore

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	Applicatore CAMLOG®, avvitato per analogo d'impianto/analogo da laboratorio CAMLOG®, incl. vite di ritenzione **Materiale** Lega di titanio	2	K2026.3303	3.3 mm
			K2026.3803	3.8 mm
			K2026.4303	4.3 mm
			K2026.5003	5.0 mm

Modelli dimostrativi

	Articolo	Art. n°
	Modello dimostrativo CAMLOG®, vetro acrilico mascellare superiore, 4 impianti CAMLOG® SCREW-LINE, 4 × Ø 4.3 mm **Materiale** Vetro acrilico/Titanio	K8070.1020
	Modello dimostrativo CAMLOG®, vetro acrilico mascellare inferiore, 4 impianti CAMLOG® SCREW-LINE, 4 × Ø 4.3 mm **Materiale** Vetro acrilico/Titanio	K8050.1040
	Mascellare inferiore edentulo incl. placca di montaggio **Materiale** Resina	J8070.2050

Macromodelli

	Articolo	Art. n°
	Macromodello CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE Scala: 3:1 **Contenuto:** 1 impianto CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE 1 abutment CAMLOG® Esthomic®, diritto 1 vite per abutment CAMLOG®, hex 1 cacciavite, hex CAMLOG® 1 premolare, adatto per abutment CAMLOG® Esthomic®, diritto 1 supporto in vetro acrilico **Materiale** Resina/Acciaio inossidabile	K8010.1400
	Macromodello CAMLOG® SCREW-LINE Scala: 3:1 **Contenuto:** 1 impianto CAMLOG® SCREW-LINE 1 abutment CAMLOG® Esthomic®, diritto 1 vite per abutment CAMLOG®, hex 1 cacciavite, hex 1 premolare, adatto per abutment CAMLOG® Esthomic®, diritto 1 supporto in vetro acrilico **Materiale** Resina/Acciaio inossidabile	K8010.1010

Letteratura

	Articolo	Documento n° / Art. n°
	Dente mancante o danneggiato? Ritrova il sorriso grazie alle moderne soluzioni odontoiatriche.	M-0446-FLY-IT-INT-BHCL-00-082021
	Denti mancanti? Scopri le nostre soluzioni confortevoli, affidabili ed estetiche.	M-0447-FLY-IT-INT-BHCL-00-082021
	Ritrova il sorriso. Soluzioni moderne per uno stile di vita sano.	M-0448-FLY-IT-INT-BHCL-00-082021
	Passaporto implantare Documentazione e scheda dell'impianto per il paziente	ML0180ITit REV A JUN 2021
	Poster Formato: 50 × 70 cm	M-0449-PST-IT-INT-BHCL-00-082021

Prospetto delle indicazioni

Ricostruzione di denti singoli		Ricostruzione
Cementata	**Avvitata**	**Cementata**
Abutment provvisori, PEEK, incl. PS	Abutment provvisori, PEEK, incl. PS	Abutment provvisori, PEEK, incl. PS
	Abutment provvisori, lega di titanio, corona	
Abutment Esthomic®, incl. PS		Abutment Esthomic®, incl. PS
	Pilastri a barra	
Base in titanio CAD/CAM, corona, incl. PS	Base in titanio CAD/CAM, corona, incl. PS	Base in titanio CAD/CAM, ponte
Basi in titanio CAD/CAM free, incl. PS	Basi in titanio CAD/CAM free, incl. PS	
Abutment universale incl. PS CAM Blank		Abutment universale incl. PS CAM Blank
Abutment in oro-resina	Abutment in oro-resina	Abutment in oro-resina

a ponte	Ricostruzioni ibride	
Avvitata	**Mobile (protesi totale)**	
Abutment provvisori, lega di titanio, ponte		
Pilastri a barra	Pilastri a barra	
Base in titanio CAD/CAM, ponte		
	Sistema di ancoraggio Locator®	
	Pilastro a sfera	
	Ricostruzione a doppia corona	Abutment universale incl. PS CAM Blank
		Abutment telescopico
		Abutment in oro-resina
		Base in titanio CAD/CAM, corona, incl. PS

Panoramica degli impianti

PROGRESSIVE-LINE

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	L
	Art. n°				
Impianto CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus con applicatore innestato	-	K1076.3809	K1076.4309	K1076.5009	9 mm
	K1076.3311	K1076.3811	K1076.4311	K1076.5011	11 mm
	K1076.3313	K1076.3813	K1076.4313	K1076.5013	13 mm
	K1076.3316	K1076.3816	K1076.4316	K1076.5016	16 mm
Impianto CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus con applicatore avvitato	-	K1075.3809	K1075.4309	K1075.5009	9 mm
	K1075.3311	K1075.3811	K1075.4311	K1075.5011	11 mm
	K1075.3313	K1075.3813	K1075.4313	K1075.5013	13 mm
	K1075.3316	K1075.3816	K1075.4316	K1075.5016	16 mm

SCREW-LINE

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	L
	Art. n°					
Impianto CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® con applicatore innestato	-	K1046.3809	K1046.4309	K1046.5009	K1046.6009	9 mm
	K1046.3311	K1046.3811	K1046.4311	K1046.5011	K1046.6011	11 mm
	K1046.3313	K1046.3813	K1046.4313	K1046.5013	K1046.6013	13 mm
	K1046.3316	K1046.3816	K1046.4316	K1046.5016	K1046.6016	16 mm
Impianto CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® con applicatore avvitato	-	K1045.3809	K1045.4309	K1045.5009		9 mm
	K1045.3311	K1045.3811	K1045.4311	K1045.5011	-	11 mm
	K1045.3313	K1045.3813	K1045.4313	K1045.5013		13 mm
	K1045.3316	K1045.3816	K1045.4316	-		16 mm
Impianto CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® plus con applicatore innestato	-	K1056.3809	K1056.4309	K1056.5009	K1056.6009	9 mm
	K1056.3311	K1056.3811	K1056.4311	K1056.5011	K1056.6011	11 mm
	K1056.3313	K1056.3813	K1056.4313	K1056.5013	K1056.6013	13 mm
	K1056.3316	K1056.3816	K1056.4316	K1056.5016	K1056.6016	16 mm
Impianto CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® plus con applicatore avvitato	-	K1055.3809	K1055.4309	K1055.5009		9 mm
	K1055.3311	K1055.3811	K1055.4311	K1055.5011	-	11 mm
	K1055.3313	K1055.3813	K1055.4313	K1055.5013		13 mm
	K1055.3316	K1055.3816	K1055.4316	-		16 mm

Prospetto dei componenti protesici

Presa d'impronta digitale

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
Articolo	Art. n°					AG
Scanbody CAMLOG®	K2610.3310	K2610.3810	K2610.4310	K2610.6010	K2610.6010	-
Scanbody CAMLOG® multiuso	K2630.3300	K2630.3800	K2630.4300	K2630.6000	K2630.6000	-
ScanPost CAMLOG® per Sirona®	K2620.3306	K2620.3806	K2620.4306	K2620.5006	K2620.6006	-

Presa d'impronta convenzionale

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
Articolo	Art. n°					AG
Transfer da impronta CAMLOG®, cilindrico, porta-impronte forato	K2125.3300	K2125.3800	K2125.4300	K2125.5000	K2125.6000	-
Transfer da impronta CAMLOG®, cilindrico, porta-impronte chiuso	K2115.3300	K2115.3800	K2115.4300	K2115.5000	K2115.6000	-
Transfer da impronta CAMLOG®, wide body, porta-impronte forato	K2124.3300	K2124.3800	K2124.4300	K2124.5000	K2124.6000	-
Transfer da impronta CAMLOG®, wide body, porta-impronte chiuso	K2114.3300	K2114.3800	K2114.4300	K2114.5000	K2114.6000	-
Transfer da impronta CAMLOG®, wide body, narrow emergence, porta-impronte forato	J2124.3301	J2124.3801	J2124.4301	J2124.5001	J2124.6001	-
Transfer da impronta CAMLOG®, wide body, narrow emergence, porta-impronte chiuso	J2114.3301	J2114.3801	J2114.4301	J2114.5001	J2114.6001	-

Prospetto dei componenti protesici

Presa d'impronta convenzionale

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	AG
	Art. n°					
PS **Transfer da impronta CAMLOG® PS, porta-impronte forato**	-	K2122.3800	K2122.4300	K2122.5000	K2122.6000	-
PS **Transfer da impronta CAMLOG® PS, porta-impronte chiuso**	-	K2111.3800	K2111.4300	K2111.5000	K2111.6000	-

Registrazione del morso

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	AG
	Art. n°					
Transfer per la registrazione del morso CAMLOG® incl. vite di ritenzione e cappetta per la registrazione del morso	J2141.3300	J2141.3800	J2141.4300	J2141.5000	-	-

Realizzazione del modello

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	AG
	Art. n°					
Analogo da laboratorio CAMLOG® per modelli colati	K3010.3300	K3010.3800	K3010.4300	K3010.5000	K3010.6000	-
	K3010.3303	K3010.3803	K3010.4303	K3010.5003	-	
Analogo d'impianto CAMLOG® per modelli stampati e colati	K3025.3300	K3025.3800	K3025.4300	K3025.5000	K3025.6000	-
DIM-Analog® per il sistema implantare CAMLOG® per modelli stampati	CAM 5.DIM.330	CAM 5.DIM.380	CAM 5.DIM.430	CAM 5.DIM.506	CAM 5.DIM.506	-

Abutment per corone e ricostruzioni a ponte

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	AG
	Art. n°					
Abutment provvisorio CAMLOG®, PEEK	-	K2241.3800	K2241.4300	K2241.5000	K2241.6000	-
PS Abutment provvisorio CAMLOG® PS, PEEK, per Platform Switching	-	K2208.3800	K2208.4300	K2208.5000	K2208.6000	-
Abutment provvisorio CAMLOG®, corona	K2239.3300	K2239.3800	K2239.4300	K2239.5000	K2239.6000	-
Abutment provvisorio CAMLOG®, ponte	J2339.3300	J2339.3800	J2339.4300	J2339.5000	J2339.6000	-
Abutment CAMLOG® Esthomic®, diritti	-	K2226.3810	K2226.4310	K2226.5010	K2226.6010	1.0–1.8 mm
		K2226.3830	K2226.4330	K2226.5030	K2226.6030	3.0–4.5 mm
Abutment CAMLOG® Esthomic®, angolati a 15°, tipo A	-	K2227.3810	K2227.4310	K2227.5010	K2227.6010	1.0–1.8 mm
		K2227.3830	K2227.4330	K2227.5030	K2227.6030	3.0–4.5 mm
Abutment CAMLOG® Esthomic®, angolati a 15°, tipo B	-	K2228.3810	K2228.4310	K2228.5010	K2228.6010	1.0–1.8 mm
		K2228.3830	K2228.4330	K2228.5030	K2228.6030	3.0–4.5 mm
Abutment CAMLOG® Esthomic®, angolati a 20°, tipo A	-	K2231.3810	K2231.4310	K2231.5010	K2231.6010	1.0–1.8 mm
		K2231.3830	K2231.4330	K2231.5030	K2231.6030	3.0–4.5 mm
Abutment CAMLOG® Esthomic®, angolati a 20°, tipo B	-	K2232.3810	K2232.4310	K2232.5010	K2232.6010	1.0–1.8 mm
		K2232.3830	K2232.4330	K2232.5030	K2232.6030	3.0–4.5 mm
PS Abutment CAMLOG® Esthomic® PS, diritto, per Platform Switching	-	K2202.3815	K2202.4315	K2202.5015	K2202.6015	1.5–2.5 mm
PS Abutment CAMLOG® Esthomic® PS, angolato a 15°, tipo A, per Platform Switching	-	K2203.3815	K2203.4315	K2203.5015	K2203.6015	1.5–2.5 mm
PS Abutment CAMLOG® Esthomic® PS, angolato a 15°, tipo B, per Platform Switching	-	K2204.3815	K2204.4315	K2204.5015	K2204.6015	1.5–2.5 mm
Abutment CAMLOG® Esthomic®, Inset	K2235.3315	K2235.3815	K2235.4315	K2235.5015	K2235.6015	1.5–2.5 mm

Prospetto dei componenti protesici

Abutment per corone e ricostruzioni a ponte

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
Articolo	**Art. n°**					**AG**
Abutment universale CAMLOG®	K2211.3300	K2211.3800	K2211.4300	K2211.5000	K2211.6000	-
PS **Abutment universale CAMLOG® PS, per Platform Switching** con impianti CAMLOG® con codice articolo K	-	K2201.3800	K2201.4300	K2201.5000	K2201.6000	-
Abutment in oro-resina CAMLOG®	K2246.3300	K2246.3800	K2246.4300	K2246.5000	K2246.6000	-
Base in titanio CAD/CAM CAMLOG®, corona	K2244.3348	K2244.3848	K2244.4348	K2244.5048	K2244.6048	-
PS **Base in titanio CAD/CAM CAMLOG® PS, corona**	-	K2210.3808	K2210.4308	K2210.5008	-	0.8 mm
Base in titanio CAD/CAM CAMLOG®, ponte	J2344.3348	J2344.3848	J2344.4348	J2344.5048	J2344.6048	-
Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free, per corona	K2247.3348	K2247.3848	K2247.4348	K2247.5048	-	0.3–0.4 mm
PS **Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free PS, per corona, per Platform Switching**	-	K2247.3808	K2247.4308	K2247.5008	-	0.8 mm
Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free, per corona	-	K2265.3848	K2265.4348	K2265.5048	-	0.3 mm
PS **Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free PS, per corona, per Platform Switching**	-	K2265.3808	K2265.4308	K2265.5008	-	0.8 mm

Pilastri COMFOUR®

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	AG
Pilastri a barra CAMLOG®, diritti	J2254.3305	J2254.3805	J2254.4305	J2254.5005		0.5 mm
	J2254.3320	J2254.3820	J2254.4320	J2254.5020	-	2.0 mm
	-	J2254.3840	J2254.4340	J2254.5040		4.0 mm
Pilastri a barra CAMLOG®, angolati a 17°, tipo A	K2256.3325	K2256.3825	K2256.4325	K2256.5025	-	2.5 mm
	K2256.3340	K2256.3840	K2256.4340	K2256.5040		4.0 mm
Pilastri a barra CAMLOG®, angolati a 17°, tipo B	K2257.3325	K2257.3825	K2257.4325	K2257.5025	-	2.5 mm
	K2257.3340	K2257.3840	K2257.4340	K2257.5040		4.0 mm
Pilastri a barra CAMLOG®, angolati a 30°, tipo A	K2258.3325	K2258.3825	K2258.4325	K2258.5035	-	2.5 mm/ 3.5 mm*
	K2258.3340	K2258.3840	K2258.4340	K2258.5050		4.0 mm/ 5.0 mm*
Pilastri a barra CAMLOG®, angolati a 30°, tipo B	K2259.3325	K2259.3825	K2259.4325	K2259.5035	-	2.5 mm/ 3.5 mm*
	K2259.3340	K2259.3840	K2259.4340	K2259.5050		4.0 mm/ 5.0 mm*
Cappetta di guarigione per pilastro a barra	J2029.4300	J2029.4300	J2029.4300	J2029.6000	J2029.6000	-
Cappetta per presa d'impronta, corta, per pilastro a barra, porta-impronte chiuso	J2129.4300	J2129.4300	J2129.4300	J2129.6000	J2129.6000	-
Cappetta per presa d'impronta, lunga, per pilastro a barra, porta-impronte chiuso (ponte/barra)	J2129.4310	J2129.4310	J2129.4310	J2129.6010	J2129.6010	-
Cappetta di scansione per pilastri a barra	J2610.4300	J2610.4300	J2610.4300	J2610.6000	J2610.6000	-
Cappetta di scansione per pilastri a barra CAMLOG®/CONELOG®	J2630.4300	J2630.4300	J2630.4300	J2630.6000	J2630.6000	-
Cappetta in titanio per pilastro a barra, per corona	J2259.4301	J2259.4301	J2259.4301	J2259.6001	J2259.6001	-
Cappetta in titanio per pilastro a barra, per ponte	J2259.4302	J2259.4302	J2259.4302	J2259.6002	H2259.6002	-
Cappetta in titanio senza ritenzione per pilastro a barra, per ponte	J2259.4322	J2259.4322	J2259.4322	J2259.6022	J2259.6022	-

* AG 3.5 e 5.0 mm solo per Ø 5.0 mm

Prospetto dei componenti protesici

Pilastri COMFOUR®

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
Articolo	Art. n°					AG
Base per corona per pilastro a barra, calcinabile	J2256.4306	J2256.4306	J2256.4306	J2256.6006	J2256.6006	-
Base per pilastro a barra, calcinabile	J2257.4301	J2257.4301	J2257.4301	J2257.6001	J2257.6001	-
Base per pilastro a barra, da sovrafusione	J2263.4300	J2263.4300	J2263.4300	J2263.6000	J2263.6000	-
Base per pilastro a barra, brasabile	J2258.4300	J2258.4300	J2258.4300	J2258.6000	J2258.6000	-
Base per pilastro a barra, titanio, saldabile al laser	J2262.4300	J2262.4300	J2262.4300	J2262.6000	J2262.6000	-
Base adesiva in titanio per pilastro a barra, Passive-Fit	J2260.4301	J2260.4301	J2260.4301	J2260.6001	J2260.6001	-
Cappetta per base adesiva in titanio, calcinabile, Passive-Fit	J2261.4301	J2261.4301	J2261.4301	J2261.6001	J2261.6001	-

Ricostruzioni ibride

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	AG
	Art. n°					
Pilastro a sfera CAMLOG®, patrice	J2249.3315	J2249.3815	J2249.4315	J2249.5015	-	1.5 mm
	J2249.3330	J2249.3830	J2249.4330	J2249.5030	-	3.0 mm
	-	J2249.3845	J2249.4345	J2249.5045	-	4.5 mm
Matrice CM Dalbo®-Plus	05003503	05003503	05003503	05003503	-	-
Analogo del pilastro a sfera	J3015.3300	J3015.3800	J3015.4300	J3015.5000	-	-
Pilastro CAMLOG® Locator®	J2253.3310	J2253.3810	J2253.4310	J2253.5010	-	1.0 mm
	J2253.3320	J2253.3820	J2253.4320	J2253.5020	-	2.0 mm
	J2253.3330	J2253.3830	J2253.4330	J2253.5030	-	3.0 mm
	J2253.3340	J2253.3840	J2253.4340	J2253.5040	-	4.0 mm
	-	J2253.3850	J2253.4350	J2253.5050	-	5.0 mm
Cappetta per presa d'impronta Locator®	J2253.0200	J2253.0200	J2253.0200	J2253.0200	-	-
Analogo Locator®	J2253.0340	J2253.0340	J2253.0340	J2253.0350	-	-
Set da laboratorio Locator®	J2253.0102	J2253.0102	J2253.0102	J2253.0102	-	-
Set da laboratorio Locator® per angolazione estesa	-	J2253.0112	J2253.0112	J2253.0112	-	-
Inserto di ritenzione Locator® trasparente, forte	J2253.1005	J2253.1005	J2253.1005	J2253.1005	-	-
Inserto di ritenzione Locator® rosa, medio	J2253.1003	J2253.1003	J2253.1003	J2253.1003	-	-
Inserto di ritenzione Locator® blu, leggero	J2253.1002	J2253.1002	J2253.1002	J2253.1002	-	-
Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa verde, forte	-	J2253.2004	J2253.2004	J2253.2004	-	-
Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa arancio, medio	-	J2253.2003	J2253.2003	J2253.2003	-	-
Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa rosso, leggero	-	J2253.2002	J2253.2002	J2253.2002	-	-
Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa grigio, nessuna ritenzione	-	J2253.2000	J2253.2000	J2253.2000	-	-
Pilastro CAMLOG® Locator R-Tx®	30800-01	30801-01	30802-01	30803-01	-	1.0 mm
	30800-02	30801-02	30802-02	30803-02	-	2.0 mm
	30800-03	30801-03	30802-03	30803-03	-	3.0 mm
	30800-04	30801-04	30802-04	30803-04	-	4.0 mm
	-	30801-05	30802-05	30803-05	-	5.0 mm
Cappetta per presa d'impronta Locator R-Tx®	30017-01	30017-01	30017-01	30017-01	-	-
Analogo Locator R-Tx®	30014-01	30015-01	30015-01	30016-01	-	-

Prospetto dei componenti protesici

Ricostruzioni ibride

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
Articolo	Art. n°					AG
Alloggiamento di ritenzione Locator R-Tx®	30013-01	30013-01	30013-01	30013-01	-	-
Inserto di lavorazione Locator R-Tx®	30012-01	30012-01	30012-01	30012-01	-	-
Distanziale da laboratorio/ausilio di duplicazione Locator R-Tx®	30018-01	30018-01	30018-01	30018-01	-	-
Inserto di ritenzione Locator R-Tx® grigio, nessuna ritenzione	30001-01	30001-01	30001-01	30001-01	-	-
Inserto di ritenzione Locator R-Tx® blu, leggero	30002-01	30002-01	30002-01	30002-01	-	-
Inserto di ritenzione Locator R-Tx® rosa, medio	30003-01	30003-01	30003-01	30003-01	-	-
Inserto di ritenzione Locator R-Tx® bianco, forte	30004-01	30004-01	30004-01	30004-01	-	-
Abutment universale CAMLOG®	-	K2211.3800	K2211.4300	K2211.5000	K2211.6000	-
PS Abutment universale CAMLOG® PS, per Platform Switching	-	K2201.3800	K2201.4300	K2201.5000	K2201.6000	-
Abutment telescopico CAMLOG®	-	K2212.3800	K2212.4300	K2212.5000	K2212.6000	-

CAM Blank

Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	AG
	Art. n°					
CAMLOG® CAM Blank in titanio, tipo IAC	K2431.3313	K2431.3813	K2431.4313	K2431.5013	K2431.6013	-
	K2432.3313	K2432.3813	K2432.4313	K2432.5013	K2432.6013	
CAMLOG® CAM Blank in titanio, tipo ME	K2441.3320	K2441.3820	K2441.4320	K2441.5020	K2441.6020	-
	K2442.3320	K2442.3820	K2442.4320	K2442.5020	K2442.6020	
CAMLOG® CAM Blank in CoCr, tipo ME	K2461.3320	K2461.3820	K2461.4320	K2461.6020	K2461.6020	-
CAMLOG® CAM Blank in titanio, tipo AG	K2471.3327	K2471.3827	K2471.4327	K2471.5027	K2471.6027	-

Componenti protesici CAD/CAM DEDICAM® di Camlog
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

Prospetto delle viti Viti per abutment e protesiche - uso intraorale

Connessione impianto-abutment

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
	M1.6			M2.0		
Articolo	**Viti per abutment CAMLOG®**					**Torque di serraggio**
Abutment provvisori PEEK **Scanbody** **ScanPost per Sirona®**						manual-mente**
Abutment provvisori in titanio, corona e ponte						
Abutment Esthomic®						20 Ncm*
Abutment universale **Abutment telescopico** **Abutment in oro-resina**		10.5 mm J4005.1601		10.5 mm  J4005.2001		
Base in titanio CAD/CAM, corona e ponte **Base in titanio CAD/CAM PS, corona**						
Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free, corona e ponte						
CAM Blank CAMLOG® Tipo AG, ME e IAC						
	Viti per abutment CAMLOG® con testa ridotta, anodizzate azzurro					
COMFOUR® Pilastri a barra, angolati a 17° e 30°		9.5 mm J4004.1601		9.5 mm J4004.2001		20 Ncm*

* con chiave dinamometrica J5320.1030

** facoltativo per abutment provvisori in titanio: torque di serraggio 20 Ncm ad avvenuta fase di guarigione

Il serraggio di tutte le viti deve essere ripreso almeno dopo 5 minuti con il corrispondente torque!

Connessione abutment-protesi

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
	M1.6			M2.0		
Articolo	**Viti protesiche per pilastri a barra, anodizzate azzurro**					**Torque di serraggio**
Cappette e basi per pilastri a barra	3.6 mm J4012.1601			3.8 mm J4012.2001		15 Ncm*
COMFOUR® Pilastri a barra diritti, angolati a 17° e 30°						

* con chiave dinamometrica J5320.1030

Prospetto delle viti ausiliarie Uso intraorale ed extraorale

Connessione abutment-protesi

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
	M1.6			M2.0		
Articolo	**Viti protesiche per pilastri a barra, anodizzate azzurro**					**Torque di serraggio**
Cappette di scansione per pilastri a barra	3.6 mm J4012.1601			3.8 mm J4012.2001		manual-mente
	Viti per pilastri a barra, per presa d'impronta con porta-impronte forato e per brasatura, anodizzate azzurro					
COMFOUR® Pilastri a barra, diritti, angolati a 17° e 30°	12 mm J4012.1610			12.2 mm J4012.2010		manual-mente
	17 mm J4012.1615			17.2 mm J4012.2015		
	22 mm J4012.1620			22.2 mm J4012.2020		
	Viti in resina per pilastro a barra, come ausilio per fissaggio e incollaggio, beige					
	29 mm J4009.1627			29.2 mm  J4009.2027		manual-mente

Il serraggio di tutte le viti deve essere ripreso almeno dopo 5 minuti con il corrispondente torque!

Prospetto delle viti Viti da laboratorio – uso extraorale

Connessione analogo da laboratorio-abutment

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
	M1.6			M2.0		
Articolo	**Viti da laboratorio* CAMLOG®, anodizzate marrone**					**Torque di serraggio**
Abutment provvisori PEEK **Scanbody** **ScanPost per Sirona®**	10.5 mm J4006.1601			10.5 mm J4006.2001		manual-mente
Abutment provvisori in titanio, corona e ponte						
Abutment Esthomic®						
Abutment universale **Abutment telescopico** **Abutment in oro-resina**						
Base in titanio CAD/CAM, corona e ponte **Base in titanio CAD/CAM PS, corona**						
Base in titanio CAMLOG® CAD/CAM free, corona e ponte						
CAM Blank CAMLOG® Tipo AG, ME e IAC						
	Ausili per incollaggio CAMLOG®					
Base in titanio CAD/CAM, corona, incl. PS, e ponte	27.5 mm J4009.1600			27.5 mm J4009.2000		manual-mente
	Viti da laboratorio* CAMLOG® con testa ridotta, parzialmente anodizzate azzurro					
COMFOUR® Pilastri a barra, angolati a 17° e 30°	9.5 mm J4004.1600			9.5 mm J4004.2000		manual-mente

* Le viti da laboratorio non devono essere utilizzate sul paziente!

Connessione abutment-protesi

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	Ø 6.0 mm	
	M1.6			M2.0		
Articolo	**Viti protesiche da laboratorio* per pilastri a barra, anodizzate marrone**					**Torque di serraggio**
Cappette di scansione per pilastri a barra						
COMFOUR® Pilastri a barra, diritti, angolati a 17° e 30°		3.6 mm J4013.1601		3.8 mm J4013.2001		manual-mente
Analogo da laboratorio a barra per pilastri a barra						
	Viti protesiche per pilastri a barra*, per realizzare la modellazione sulla cappetta calcinabile per base adesiva in titanio, Passive-Fit, sull'analogo da laboratorio a barra					
Base adesiva in titanio per pilastro a barra e cappetta per base adesiva in titanio calcinabile, Passive-Fit		5.5 mm J4005.1602		5.5 mm J4005.2002		manual-mente

* Le viti da laboratorio non devono essere utilizzate sul paziente!

Prospetto dei torque di serraggio

Articolo		Strumenti	Torque di serraggio
	Vite tappo dell'impianto	J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502 J5317.0504 J5317.0503	manual-mente*
	Cappetta di guarigione cilindrica, wide body, wide body narrow emergence e bottleneck		
	Scanbody CAMLOG® Scanbody CAMLOG® multiuso ScanPost CAMLOG® per Sirona®		
	Transfer da impronta Transfer per la registrazione del morso		
	Abutment provvisorio, PEEK Abutment provvisorio, corona e ponte		
	Base in titanio CAD/CAM, corona e ponte Base in titanio CAD/CAM PS, corona		20 Ncm
	Abutment universale Abutment telescopico Abutment in oro-resina		
	Abutment Esthomic®, diritto, angolato a 15° e 20° Abutment Esthomic®, Inset		
	CAM Blank CAMLOG®, Tipo IAC, ME e AG		

* facoltativo per abutment provvisori in titanio: torque di serraggio 20 Ncm ad avvenuta fase di guarigione

Il serraggio di tutte le viti deve essere ripreso almeno dopo 5 minuti con il corrispondente torque!

Articolo	Strumenti	Torque di serraggio
Basi in titanio CAMLOG® CAD/CAM free, corona	J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502 J5317.0504 J5317.0503 J5319.0501* J5319.0502* J5319.0504* J5319.0503*	20 Ncm

* Da utilizzare solo con canale della vite angolato

Prospetto dei torque di serraggio

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	3.3	3.8	4.3	5.0	6.0
Articolo	**Strumenti**				**Torque di serraggio**				
Pilastri a barra, diritti	J5300.0020 J5300.0021			J5300.0025	20 Ncm*			30 Ncm*	
Pilastri a barra, angolati a 17° e 30°	J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502 J5317.0504 J5317.0503				20 Ncm*				
Cappetta di guarigione per pilastro a barra					manualmente				
Cappette di scansione per pilastri a barra									
Cappette in titanio per pilastro a barra, corona/ponte					15 Ncm*				
Base per corona per pilastro a barra, calcinabile									
Basi per pilastri a barra, calcinabile, da sovrafusione, brasabile, saldabile al laser									
Base adesiva in titanio per pilastro a barra, Passive-Fit									
Pilastri Locator R-Tx®					20 Ncm*			30 Ncm*	
Cappetta per presa d'impronta per pilastro a barra, porta-impronte chiuso	J5300.0027 J5300.0028				manualmente				
Pilastri a sfera	J5300.0011				20 Ncm*			30 Ncm*	
Pilastri Locator®	J2253.0001								

* con chiave dinamometrica J5320.1030

Il serraggio di tutte le viti deve essere ripreso almeno dopo 5 minuti con il corrispondente torque!

Materiali

Titanio grado 4			
Proprietà (ASTM F67 e DIN EN ISO 5832-2)			
Composizione chimica (in %)	O	≤	0.4
	Fe	≤	0.5
	C	≤	0.08
	N	≤	0.05
	H	≤	0.0125
	Ti		Residui
Proprietà meccaniche	Resistenza a trazione	≥	550 MPa
	Allungamento alla rottura	≥	12%

Lega di titanio Ti-6Al-4V ELI			
Proprietà (ASTM F136)			
Composizione chimica (in %)	Al		5.5–6.5
	V		3.5–4.5
	Fe	≤	0.25
	C	≤	0.08
	N	≤	0.05
	O	≤	0.13
	H	≤	0.012
	Ti		Residui
Proprietà meccaniche	Resistenza a trazione	≥	860 MPa
	Allungamento alla rottura	≥	10%

Lega aurea per la tecnica di sovrafusione Abutment in oro-resina CAMLOG®			
Proprietà			
Composizione chimica (in %)	Au		60
	Pd		20
	Pt		19
	Ir		1
Proprietà fisiche	Intervallo di fusione		1400–1490 °C
	Densità		17.5 g/cm³
	Modulo di elasticità		136 GPa
	Coefficiente di dilatazione termica (25–500 °C)		11.9 10^{-6} K^{-1}
	Coefficiente di dilatazione termica (25–600 °C)		12.2 10^{-6} K^{-1}
	Colore		bianco
Proprietà meccaniche	Stato		lavorato a freddo
	Durezza HV5	>	215
	Resistenza alla trazione (Rm)	>	750 MPa
	0.2% limite di allungamento (Rp 0.2%)	>	650 MPa
	Allungamento alla rottura	>	2%

Lega aurea per la tecnica di sovrafusione Base per pilastro a barra		
Proprietà		
Composizione chimica (in %)	Au	60
	Pt	19
	Pd	20
	Ir	1
Proprietà fisiche	Densità	17.5 g/cm³
	Colore	bianco
	Fase liquida	1490 °C
	Fase solida	1400 °C
	Coefficiente di dilatazione termica (25–500 °C)	12.5 10^{-6} K^{-1}
	Coefficiente di dilatazione termica (25–600 °C)	12.6 10^{-6} K^{-1}
	Modulo di elasticità	136 GPa
Proprietà meccaniche		dopo tempera 700 °C / 30 min
	Durezza HV5	210
	0.2% limite di allungamento	450–570 MPa
	Allungamento alla rottura	min. 10%
	Resistenza a trazione MPa	530–650

Lega aurea brasabile Base per pilastro a barra		
Proprietà		
Composizione chimica (in %)	Au	68.60
	Pt	2.45
	Ag	11.85
	Pd	3.95
	Cu	10.60
	Zn	2.50
	Ir	0.05
	Rh	-
	Ru	-
Proprietà fisiche	Colore	giallo
	Intervallo di fusione	880–940 °C
Proprietà meccaniche	Durezza dopo ricottura di addolcimento HV5	175
	Durezza dopo tempera HV5	275
	Durezza dopo autotempera HV5	240

Lega CoCr		
Proprietà (ASTM F1537-20 e ISO 5832-12)		
Composizione chimica (in peso %)	Cr	26.0–30.0
	Mo	5.0–7.0
	Fe	≤ 0.75
	Ni	≤ 0.1*
	Mn	< 1.0
	Si	< 1.0
	N	< 0.25
	C	≤ 0.14
	Co	Residui
Proprietà fisiche	Coefficiente di dilatazione termica (25–500 °C)	14.2–14.4 10^{-6} K^{-1}
Proprietà meccaniche	Resistenza a trazione	> 827 MPa
	Resistenza a rottura	1172–1400 MPa
	Allungamento alla rottura	> 12%
	Durezza (HRC)	38–48

* ASTM F1537-20 e ISO 5832-12: ≤ 1.0 peso %

Documentazione supplementare

Per ulteriori informazioni sui prodotti CAMLOG® si rimanda ai seguenti documenti:
- Istruzioni operative CAMLOG®
- Istruzioni per l'uso CAMLOG®
- Istruzioni di ricondizionamento
- Prospetto della letteratura Camlog
- Clinical evidence and science

Questa documentazione può essere richiesta presso il rispettivo referente Camlog locale.

Consultare anche i siti:
https://ifu.camlog.com
www.camlog.com

Italia: www.biohorizonscamlog.it
Svizzera: www.camlog.ch

Bibliografia

[1] Conserva E. Initial stability after placement of a new buttress-threaded implant. A case series study. Implants. 2019(3): 24-28.
[2] Ruppin J. One-year clinical experience with Progressive-Line implants. EDI journal. 2020(4): 54-63.
[3] CAMLOG® IMPLANT SYSTEM/CONELOG® IMPLANT SYSTEM – Die Promote® Oberfläche – eine hochmoderne Titanoberfläche für die Implantologie. M-0173-WPR-DACH-CL-00-022022.
[4] Semper-Hogg W, Kraft S, Stiller S, Mehrhof J, Nelson K. Analytical and experimental position stability of the abutment in different dental implant systems with a conical implant-abutment connection. Clin Oral Investig. 2013;17(3): 1017-23.
[5] Semper-Hogg W, Zulauf K, Mehrhof J, Nelson K. The influence of torque tightening on the position stability of the abutment in conical implant-abutment connections. Int J Prosthodont 2015;28(5):538-41.

Note legali

Esclusione di responsabilità generale
Le informazioni qui fornite hanno esclusivamente finalità commerciali e non istruiscono l'utilizzatore sull'uso dei prodotti in ambito clinico. Per la corretta applicazione dei prodotti, consultare le corrispondenti istruzioni per l'uso e le istruzioni di lavoro prima dell'uso.

Marchi e copyright

Le denominazioni commerciali protette (marchi) non vengono indicate sempre in modo particolare. La mancanza di indicazioni di tale sorta NON implica comunque che si tratti di denominazioni commerciali non protette. Il documento, incluse tutte le sue parti, è protetto da copyright. Il relativo contenuto può essere scaricato per l'uso conforme alla destinazione prevista, tuttavia sono vietate le modifiche o la riproduzione del contenuto. Qualsiasi utilizzo al di fuori dei limiti previsti dalla legge sul copyright senza previa autorizzazione scritta di CAMLOG Biotechnologies GmbH è vietato ed è perseguibile penalmente.

CAMLOG®, COMFOUR®, CONELOG®, DEDICAM®, Esthomic®, Promote® e Tube-in-Tube® sono marchi registrati di CAMLOG Biotechnologies GmbH. Locator®, Locator R-Tx®, R-Tx, ZEST e Zest Dental Solutions, come pure il colore e la forma degli inserti di ritenzione sono marchi registrati di ZEST IP Holdings, LLC. Dalbo®-Plus è un marchio registrato della società Cendres + Métaux SA, Biel, Svizzera.

I marchi indicati potrebbero non essere registrati in tutti i paesi. Tutti i marchi di terzi appartengono ai rispettivi proprietari. CAMLOG Biotechnologies GmbH può commercializzare i prodotti solo a fronte dell'approvazione delle autorità nazionali competenti. Pertanto, i prodotti e i servizi non sono disponibili integralmente in tutti i paesi.

Fabbricante
I prodotti CAMLOG® e CONELOG® sono fabbricati da:
ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Germania
I prodotti DEDICAM® sono fabbricati da:
ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Germania e
Biotech Dental Digital SAS | 305 Allées de Craponne | 13300 Salon de Provence | Francia
Locator® e Locator R-Tx® sono fabbricati da Zest Anchors LLC.
Dalbo®-Plus è fabbricato da Cendres + Métaux SA, Biel, Svizzera.

Appunti

Appunti

CE 0123

Art.-Nr. J8001.0005 Rev. 11 05/2024

+E219J8001000051F

+$01101148800FW

Svizzera
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Svizzera
Telefono +41 61 565 41 41 | Fax +41 61 565 41 42 | sales.ch@camlog.com | www.camlog.ch

Italia
BioHorizons Camlog Italia | Via Ettore Cristoni, 88 | 40033 Casalecchio di Reno (BO) | Italia
marketing.italia@biohorizons.com | www.biohorizonscamlog.it
Servizio Clienti: Numero Verde 800063040 | ordini@biohorizons.com

Headquarters
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Svizzera
Telefono +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

Inspiring excellence in oral reconstruction

biohorizons camlog