CONELOG®
SYSTEM

Catalogo prodotti
Sistema implantare CONELOG®

Valido a partire da maggio 2024

biohorizons
camlog

Indice

Servizi

Evidenze cliniche e fondamenti scientifici 2

Informazioni sul sistema

Il sistema implantare CONELOG® 3

Chirurgia

Pianificazione 18
PROGRESSIVE-LINE Impianti e strumenti 20
PROGRESSIVE-LINE Guide System Strumenti 26
PROGRESSIVE-LINE Flex Strumenti 33
SCREW-LINE Impianti e strumenti 37
SCREW-LINE Guide System strumenti 45
Strumenti chirurgici generali 48
SCREW-LINE Set per osteotomia 54
Viti tappo 59
Cappette di guarigione 59

Tecnica protesica

Scanbody 62
Presa d'impronta 63
Registrazione del morso 64
Realizzazione del modello 64
Abutment provvisori 65
Basi in titanio CAD/CAM 66
Basi in titanio CAD/CAM free 68
CAM Blank 69
Abutment Esthomic® 71
Abutment universali 73
Abutment in oro-resina 73
COMFOUR® 74
Pilastro a sfera 79
Locator® 80
Locator R-Tx® 82
Ricostruzione a doppia corona 84
Viti per abutment e da laboratorio 84
Strumenti protesici 86
Strumenti odontotecnici 89
Selezione dell'abutment 90

Articoli aggiuntivi

Impianti per esercitazione 92
Applicatore 92
Modelli dimostrativi 93
Macromodelli 93
Letteratura 94

Informazioni aggiuntive

Prospetto delle indicazioni 96
Panoramica degli impianti 98
Prospetto dei componenti protesici 99
Prospetto delle viti 106
Prospetto dei torque di serraggio 110
Materiali 114

Documentazione supplementare

Documentazione supplementare 117
Note legali 117

Evidenze cliniche e fondamenti scientifici

Camlog ha imposto fin dall'inizio standard elevati per la documentazione scientifica di tutte le caratteristiche fondamentali dei propri sistemi implantari.

Nel documento **Evidenze cliniche e fondamenti scientifici** abbiamo sintetizzato l'attuale stato dell'arte della ricerca sui sistemi implantari Camlog.

Siamo lieti di poter offrire queste pillole di conoscenza ai nostri clienti. La versione cartacea del documento è disponibile su richiesta.

E-book

Il sistema implantare CONELOG®

Il sistema implantare CONELOG® si basa su una pluriennale esperienza clinica e di laboratorio e si caratterizza per la sua facilità d'uso e la sua versatilità protesica.

Tutti i prodotti CONELOG® vengono fabbricati secondo il più recente stato dell'arte. Il sistema implantare CONELOG® viene costantemente perfezionato dal team di ricerca e sviluppo interno all'azienda in collaborazione con cliniche, università e odontotecnici, quindi continuamente allineato alle ultime tecnologie.

I sistemi implantari CAMLOG® e CONELOG® sono documentati in modo ottimale a livello scientifico. Lo dimostrano studi* riguardanti i più svariati parametri, come ad esempio la superficie dell'impianto, la procedura di inserimento e/o del carico dell'impianto, la stabilità primaria e il design della connessione.

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 117

Impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE

Gli impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE consentono di realizzare più facilmente moderni concetti di trattamento come la protesizzazione immediata o il carico immediato, che richiedono un'elevata stabilità primaria.[1, 2*]

La geometria dell'impianto mira di conseguenza ad ottenere un'elevata stabilità iniziale:
- L'impianto a vite automaschiante presenta una parte apicale conica, che consente di ottenere un'eccellente stabilità primaria anche in presenza di osso morbido.[1, 2*]
- Filettatura estesa fino all'apice per un efficace ancoraggio in interventi di impianto immediato.[1, 2*]
- Filettatura crestale per una migliore tenuta in presenza di altezza ossea residua limitata.[2*]

Gli impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE sono provvisti della superficie Promote® plus, che riveste tutto il corpo dell'impianto fino alla spalla dell'impianto conica di 45° mordenzata con acido. In base alla situazione clinica, questa configurazione superficiale consente di ottenere un posizionamento dell'impianto leggermente sopracrestale nel senso di un impianto "bone-level" classico.

Gli impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE con applicatore avvitato possono essere utilizzati per procedure di chirurgia guidata.

Gli impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE dispongono di una connessione conica impianto-abutment CONELOG® ultraprecisa con Platform-Switching integrato. La ricostruzione protesica viene effettuata con abutment CONELOG®.

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 117

Impianto CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Promote® plus

Diametro dell'impianto

3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm

Lunghezze dell'impianto

7 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | 16 mm

Superficie Promote®

Gli impianti CONELOG® sono disponibili con la superficie Promote® sabbiata e mordenzata con acido. La superficie risponde agli attuali requisiti in campo scientifico e favorisce una rapida osteointegrazione. I risultati scientifici di indagini con colture cellulari, istologia ossea e prove di estrazione confermano queste straordinarie caratteristiche.[3*]

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 117

Impianto CONELOG® SCREW-LINE Promote® plus

Impianti CONELOG® SCREW-LINE

Gli impianti CONELOG® SCREW-LINE sono impianti a vite leggermente conici con filettatura automaschiante. Consentono un facile inserimento grazie all'auto-centratura e al contatto uniforme con l'osso, garantendo un'elevata stabilità primaria.

Gli impianti CONELOG® sono provvisti della superficie Promote® sabbiata e mordenzata con acido, estesa fino alla spalla dell'impianto conica di 45° mordenzata con acido, quindi consentono la massima flessibilità nella determinazione della posizione verticale dell'impianto. L'arrotondamento della geometria apicale garantisce un inserimento conservativo degli impianti CONELOG® SCREW-LINE nell'osso, anche in prossimità del seno mascellare.

Gli impianti CONELOG® SCREW-LINE con applicatore avvitato possono essere utilizzati per procedure di chirurgia guidata.

Gli impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE dispongono di una connessione conica impianto-abutment CONELOG® ultraprecisa con Platform-Switching integrato. La ricostruzione protesica viene effettuata con abutment CONELOG®.

Diametro dell'impianto

3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm

Lunghezze dell'impianto

7 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | 16 mm

Tutti gli impianti CONELOG® vengono forniti in confezione sterile, pre-montati su un applicatore con codifica di colore in base al diametro dell'impianto.

Gli applicatori degli impianti CONELOG®

Gli impianti PROGRESSIVE-LINE e SCREW-LINE sono disponibili rispettivamente con due varianti di applicatore.
Gli strumenti necessari per inserire l'impianto sono gli stessi indipendentemente dalla variante di applicatore prescelta.
Per la chirurgia guidata non sono necessari strumenti separati.

- Parte di trasferimento pre-montata – applicazione e trasferimento semplificati nel cavo orale del paziente
- Diametro piccolo – accesso facilitato negli spazi interdentali e nella regione posteriore
- Applicatore codificato per colore in base al diametro dell'impianto – facile orientamento durante l'intervento
- Utilizzo come perno parallelizzatore – per allineare la posizione di più impianti

Adattatore di rimozione –
una misura per tutti i diametri



Applicatore innestato (snap-in)

- Applicatore standard: facile rimozione dopo l'inserimento dell'impianto
- Il punto di rottura prestabilito protegge la connessione dell'impianto dall'eccessiva sollecitazione
- Adattatore di rimozione per rimuovere l'impianto dopo la rottura dell'applicatore nel punto di rottura prestabilito

Applicatore avvitato (screw-mounted)

- Per la chirurgia guidata (Guide)
- Fissaggio con l'impianto tramite una vite: consente adattamenti verticali della posizione dell'impianto nel sito implantare

Connessione impianto-abutment CONELOG®

La geometria della connessione impianto-abutment CONELOG® consente un Platform-Switching integrato e convince con il suo straordinario feedback tattile durante l'inserimento degli abutment.

Con una lieve rotazione dell'abutment, l'indicizzazione sulle tre scanalature/camme consente di incastrare le camme percettibilmente nelle scanalature dell'impianto, facendole scivolare in posizione finale. È così garantito un facile, rapido e sicuro orientamento sull'asse longitudinale dell'impianto.
La connessione conica precisa riduce al minimo i micromovimenti e presenta una stabilità superiore rispetto ad altre connessioni coniche.[4, 5*]

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 117

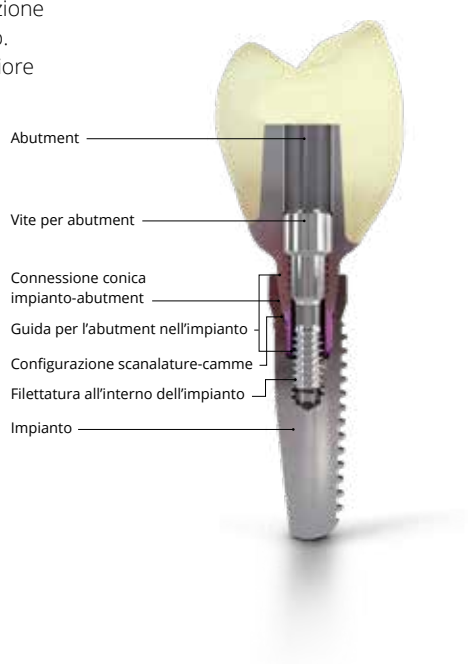

Tutti i vantaggi della connessione CONELOG®

- Posizionamento dell'abutment semplice, rapido e preciso con feedback tattile chiaramente percettibile
- Connessione conica impianto-abutment precisa con stabilità superiore rispetto ad altre connessioni coniche[1, 2*]
- Platform-Switching integrato

Per un posizionamento ottimale dell'abutment, l'impianto deve essere inserito nell'osso in modo che una delle tre scanalature sia orientata in direzione vestibolare.
Per quanto riguarda gli impianti CONELOG®, gli inseritori sono provvisti di apposite tacche corrispondenti alle tre scanalature della configurazione interna dell'impianto.

* vedere "Documentazione supplementare" a pagina 117

Componenti protesici CONELOG®

Per la protesizzazione degli impianti CONELOG® è disponibile un'ampia gamma di componenti protesici versatili e ottimizzati dal punto di vista anatomico. Gli abutment CONELOG® sono codificati per colore in base al diametro dell'impianto.

Cappette di guarigione CONELOG®

Le cappette di guarigione CONELOG® appoggiano sulla spalla dell'impianto macchinata, tuttavia non la coprono completamente, consentendo un adattamento del tessuto molle alla spalla dell'impianto, senza alcun contatto con le superfici della connessione conica.

Le cappette di guarigione vengono impiegate per procedure in uno o due tempi in base all'indicazione. Le cappette di guarigione sono disponibili in tre geometrie (cilindrica, wide body e bottleneck) e vengono avvitate direttamente nell'impianto.

Presa d'impronta CONELOG®

La presa d'impronta dell'impianto CONELOG® può essere effettuata con transfer da impronta per porta-impronte forato o chiuso. I transfer da impronta CONELOG® sono codificati per colore in base al diametro dell'impianto, hanno un profilo d'emergenza formalmente congruente con le cappette di guarigione e sono forniti sterili. I componenti ultraprecisi assicurano il corretto trasferimento delle caratteristiche anatomiche intraorali.

I transfer da impronta CONELOG® non si incastrano nel cono dell'impianto, ma appoggiano sulla spalla dell'impianto. In tal modo si evita una sfasatura in altezza durante la presa d'impronta. La protezione anti-rotazione è garantita dalla configurazione scanalature-camme CONELOG®.

Abutment provvisori CONELOG®

Gli abutment provvisori CONELOG® in lega di titanio sono disponibili nelle versioni per corona e per ponte per la realizzazione di ricostruzioni provvisorie. Gli abutment possono essere utilizzati sia per un impianto immediato sia in seguito ad esposizione della gengiva.

Abutment CONELOG® Esthomic®

Gli abutment anatomici consentono una realizzazione ottimale del moncone. Gli abutment CONELOG® Esthomic® sono disponibili sia in versione diritta che angolata, in diverse altezze gengivali, con profilo della spalla anatomico, di forma ovale. Gli abutment Esthomic® angolati sono disponibili nelle varianti A e B, che si differenziano per una disposizione delle camme sfalsata di 60°. Si ottengono in tal modo sei diverse posizioni di rotazione per un orientamento assiale protesico ottimale.

Orientamento delle camme dell'abutment CONELOG® Esthomic®

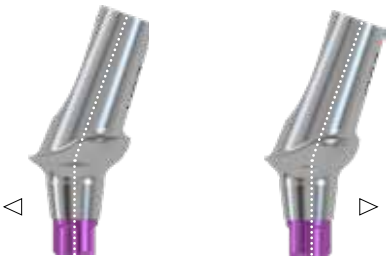

Tipo A
Orientamento delle camme opposto all'angolazione

Tipo B
Orientamento delle camme in direzione dell'angolazione

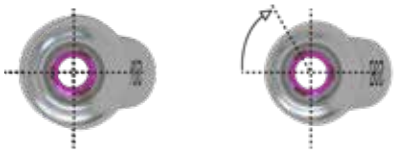

Tipo A

Tipo B
Camme sfasate di 60°

Estrattore CONELOG® per abutment CONELOG®

La connessione impianto-abutment CONELOG® è caratterizzata da un cono auto-bloccante. Per rimuovere facilmente gli abutment CONELOG® dagli impianti e/o analoghi da laboratorio CONELOG®, è disponibile uno speciale estrattore CONELOG®. In primo luogo si rimuove la vite per abutment CONELOG® o la vite da laboratorio, poi si avvita l'estrattore nel canale della vite finché l'abutment non si stacca dal cono interno dell'impianto e/o analogo da laboratorio CONELOG®.

Abutment universali e telescopici CONELOG®

Gli abutment universali e telescopici CONELOG® possono essere utilizzati per realizzare in modo personalizzato ricostruzioni a ponte e a corona e ricostruzioni a doppia corona cementabili. Gli abutment sono prodotti in lega di titanio e possono essere lavorati in modo personalizzato.

Basi in titanio CAD/CAM CONELOG® e basi in titanio CONELOG® CAD/CAM free

Le basi in titanio CAD/CAM CONELOG® e le basi in titanio CONELOG® CAD/CAM free fungono da basi adesive per protesi su impianti personalizzate realizzate con adeguati materiali. Le ricostruzioni sono realizzate con l'ausilio di tecniche CAD/CAM. Le basi in titanio CAD/CAM CONELOG® sono disponibili nelle versioni per corona e per ponte, nelle altezze gengivale di 1.0 e 2.0 mm. Le basi in titanio CONELOG® CAD/CAM free per il canale della vite angolato sono disponibili nella versione per corona in due altezze del camino e due altezze gengivali.

Pilastri a sfera, pilastri Locator® e pilastri a barra diritti CONELOG®

Per il sistema implantare CONELOG® sono disponibili pilastri a sfera, pilastri Locator® e pilastri a barra diritti. Questi pilastri si distinguono dagli abutment per i diversi design della connessione nella parte apicale. I pilastri a sfera, pilastri Locator® e pilastri a barra diritti sono componenti monopezzo, provvisti nella parte apicale di una filettatura che si incastra nella filettatura interna dell'impianto CONELOG®. Questi pilastri vengono avvitati nell'impianto CONELOG® mediante i corrispondenti inseritori.

Esempio: pilastro a sfera CONELOG® (Ø 4.3 mm) in un impianto CONELOG® SCREW-LINE

Effetto dell'opzione Platform Switching

Il sistema implantare CONELOG® è provvisto di un Platform-Switching integrato, poiché la spalla dell'impianto non viene coperta dalle cappette di guarigione e dagli abutment. Il Platform Switching assicura supporto ai tessuti duri e molli nella regione estetica peri-implantare. La distanza tra l'interfaccia impianto-abutment e la cresta alveolare deve essere aumentata per ridurre l'effetto dell'infiltrazione di cellule infiammatorie sul riassorbimento osseo.

Sistema COMFOUR®

Le ricostruzioni avvitate in senso occlusale sono realizzate allo stato dell'arte. Grazie al sistema COMFOUR®, i pazienti edentuli possono contare su ricostruzioni fisse, confortevoli e subito disponibili, di norma su quattro o sei impianti, e quindi su un considerevole valore aggiunto in termini di qualità della vita. Ma anche gli operatori possono contare su un comfort e una libertà di azione di livello notevolmente superiore. Il sistema COMFOUR® permette di attuare contemporaneamente più concetti di trattamento. Oltre a corone e ponti avvitati in senso occlusale per ricostruzioni immediate e tardive, questo sistema versatile consente di realizzare anche ricostruzioni a barra su pilastri a barra diritti e angolati. Il sistema COMFOUR® offre una gamma completa di opzioni per gestire in futuro più facilmente e in minor tempo qualsiasi tipo di sfida nella prassi quotidiana. Oltre che per la sua versatilità, il sistema protesico COMFOUR® convince soprattutto per il suo design sottile.

Tutti i componenti presentano una struttura sottile e un'altezza ribassata, semplificando considerevolmente la ricostruzione implanto-protesica agli odontoiatri e agli odontotecnici. Inoltre, i numerosi highlight tecnici fanno sì che COMFOUR® non sia solo un nome, ma un vero e proprio programma, tanto per gli operatori quanto per i pazienti.

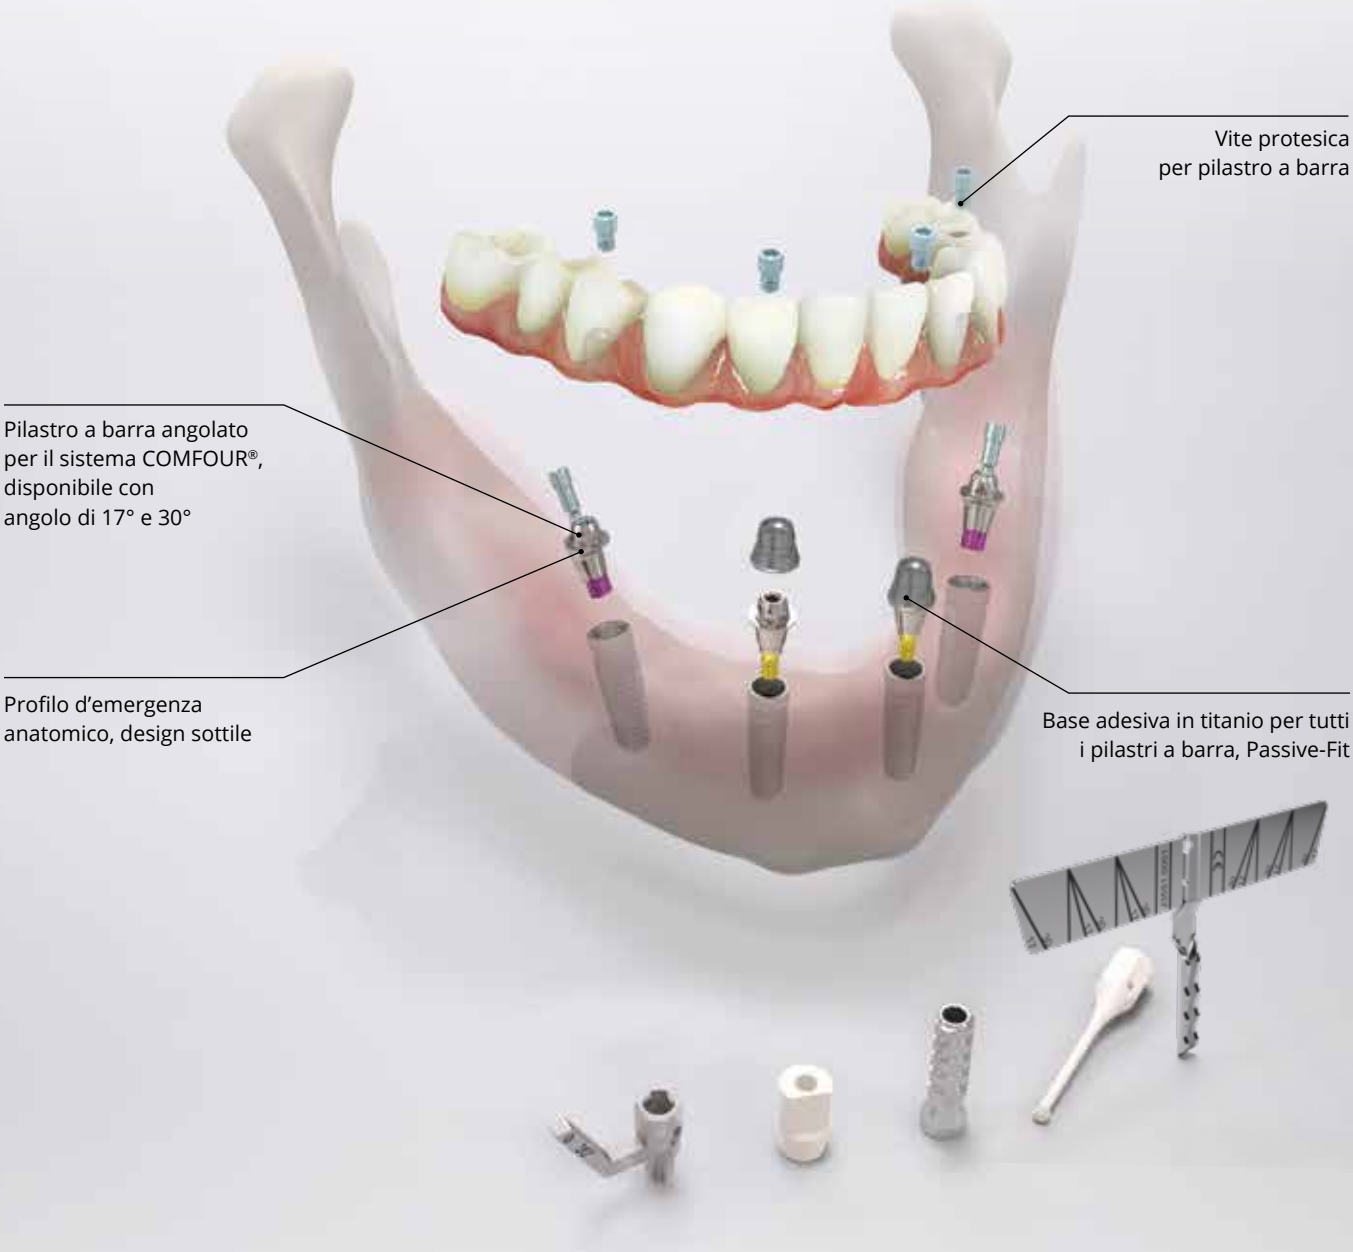

COMFOUR® offre un'ampia scelta di opzioni per rispondere alle esigenze della prassi clinica.

Servizi CAD/CAM

Grazie alla collaborazione con il proprio partner di servizio CAD/CAM DEDICAM®, Camlog offre componenti protesici, cappette di guarigione e transfer da impronta personalizzati realizzati con la tecnica CAD/CAM, servizi di scansione e progettazione, pianificazione di impianti in 3D, guide di fresaggio stampate e modelli mascellari e mandibolari.

L'assistenza personalizzata basata sulla consueta competenza dei nostri collaboratori e i processi ottimizzati nei minimi dettagli garantiscono un'elevata sicurezza dei risultati e al tempo stesso la massima libertà individuale.

Per la realizzazione di restauri su impianti sono disponibili estese librerie per i sistemi CAD aperti di 3Shape, exocad e Dental Wings.

DEDICAM®
DIGITAL CONCEPTS

Scoprite le possibilità che vi aspettano ed entrate nel futuro digitale con DEDICAM®.

Spiegazione dei simboli

CE	Marcatura CE
CE 0123	Marcatura CE con numero dell'organismo notificato
	Attenersi alle istruzioni per l'uso
	Attenzione! Rispettare le avvertenze
MD	Dispositivo medico
REF	Numero d'ordine
LOT	Numero di lotto
SN	Numero di serie
STERILE R	Sterilizzazione mediante irradiazione
	Sistema di barriera sterile singola con confezione protettiva esterna
	Sistema di barriera sterile singola
	Non sterile
	Data di produzione
	Da utilizzarsi preferibilmente entro
	Non risterilizzare
	Non riutilizzare
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Non esporre alla luce solare diretta
	Limite di temperatura
	Fabbricante
MR	MR Safe* (sicuro per la RM)
	MR Conditional (a compatibilità RM condizionata)
	Contiene sostanze pericolose
Rx only	Attenzione: Ai sensi della legislazione federale statunitense questi prodotti possono essere venduti direttamente solo a medici esperti o su loro commissione.

Spiegazione delle abbreviazioni

Ø	Diametro
A Ø	Diametro apicale
G Ø	Diametro gengivale
Ø PP	Diametro della piattaforma protesica
L	Lunghezza
AG	Altezza gengivale
PBT	Polibutilentereftalato
PEEK	Poli-etere-etere-chetone
POM	Poliossimetilene
PPSU	Polifenilsulfone

Codifica cromatica dei prodotti chirurgici e protesici CONELOG®

Avvertenze di sicurezza e di natura generale

- Le descrizioni riportate nel presente catalogo prodotti non sono sufficienti per un utilizzo immediato del sistema implantare CONELOG®.
- Si raccomanda di prevedere un addestramento sull'uso del sistema implantare CONELOG® da parte di un operatore esperto. I prodotti devono essere utilizzati esclusivamente da dentisti, medici, chirurghi e odontotecnici. Se necessario, Camlog offre corsi e seminari di addestramento sull'uso del sistema.
- Errori metodologici in fase di trattamento possono causare la perdita degli impianti e una notevole atrofizzazione della sostanza ossea peri-implantare.
- Le immagini riportate nel presente documento hanno esclusivamente scopo di riferimento e possono differire dal prodotto reale.

* per componenti DEDICAM® non metallici

Confezione degli impianti PROGRESSIVE-LINE

Imballaggio secondario
Scatola pieghevole sigillata, provvista di etichetta del prodotto con codifica di colore

Confezione dell'impianto (imballaggio primario)
Sigillato, con codifica di colore

Esempio di etichetta del prodotto sulla confezione esterna dell'impianto

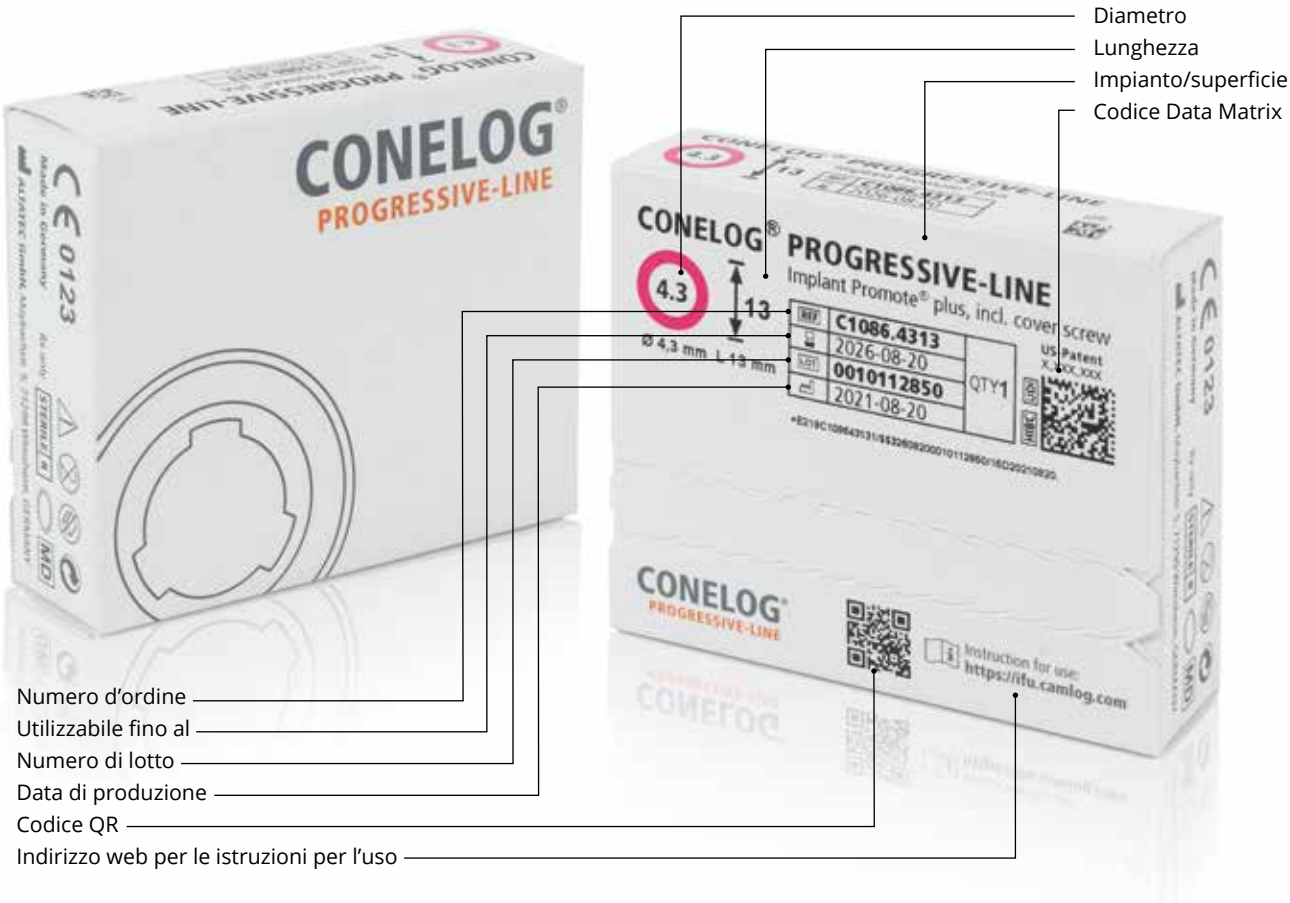

Confezione degli impianti SCREW-LINE

Imballaggio secondario
Scatola pieghevole sigillata, provvista di etichetta del prodotto con codifica di colore

Confezione dell'impianto (imballaggio primario)
Sigillato, con codifica di colore

Esempio di etichetta del prodotto sulla confezione esterna dell'impianto

Unità di imballaggio: salvo diversa indicazione, ogni confezione contiene rispettivamente un prodotto.

Direct part marking (marcatura diretta delle parti) – migliore riconoscibilità e tracciabilità

Prossimamente, tutti gli strumenti Camlog recheranno, oltre al numero d'ordine, una stampigliatura con il codice di lotto e/o il codice UDI. Ciò consente a tutto il personale dello studio odontoiatrico di riconoscere e assegnare più facilmente i prodotti. Le immagini inserite nel catalogo non riportano ancora questi dati.

Chirurgia

Pianificazione implantare

	Articolo	Art. n°	⌀
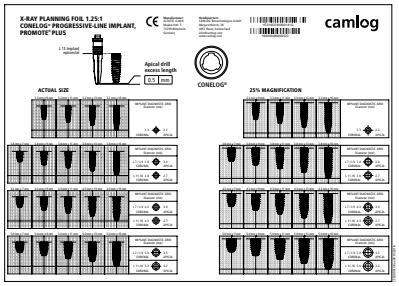	**Pellicola di pianificazione radiografica 1.25:1 Impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** Ingrandimento 25%	C5300.9014	-
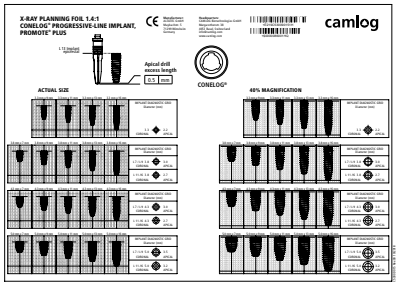	**Pellicola di pianificazione radiografica 1.4:1 Impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** Ingrandimento 40%	C5300.9015	-
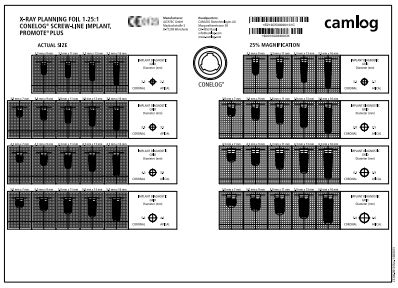	**Pellicola di pianificazione radiografica 1.25:1 Impianti CONELOG® SCREW-LINE** Ingrandimento 25%	C5300.9010	-
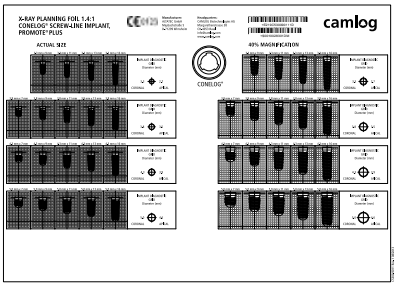	**Pellicola di pianificazione radiografica 1.4:1 Impianti CONELOG® SCREW-LINE** Ingrandimento 40%	C5300.9011	-

Pianificazione mediante TC

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø	L
	Dima per TC per fresa Ø 2.0 mm*, dima di fresaggio scanalata Diametro interno 2.1 mm Diametro esterno 2.5 mm **Materiale** Lega di titanio	10	A2002.2000	-	4.0 mm 10.0 mm
	Dima per TC per fresa Ø 2.2 mm, dima di fresaggio scanalata Diametro interno 2.3 mm Diametro esterno 2.7 mm **Materiale** Lega di titanio	10	A2222.2200	-	4.0 mm 10.0 mm
	Fresa per inserire le dime per TC scanalate (per A2002.2000) **Materiale** Acciaio inossidabile	1	A2050.2600	2.6 mm	-
	Fresa per inserire le dime per TC scanalate (per A2222.2200) **Materiale** Acciaio inossidabile	1	A2050.2800	2.8 mm	-

* per fresa pilota J5051.2003 e fresa pilota SCREW-LINE J5051.2000

PROGRESSIVE-LINE

PROGRESSIVE-LINE

Impianti con applicatore innestato

	Articolo	Art. n°	Ø	L	A Ø
	Impianto CONELOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus incl. applicatore innestato e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	C1086.3309	3.3 mm	9 mm	2.2 mm
		C1086.3311		11 mm	
		C1086.3313		13 mm	
		C1086.3316		16 mm	
		C1086.3807	3.8 mm	7 mm	3.0 mm
		C1086.3809		9 mm	
		C1086.3811		11 mm	2.7 mm
		C1086.3813		13 mm	
		C1086.3816		16 mm	
		C1086.4307	4.3 mm	7 mm	3.0 mm
		C1086.4309		9 mm	
		C1086.4311		11 mm	2.7 mm
		C1086.4313		13 mm	
		C1086.4316		16 mm	
		C1086.5007	5.0 mm	7 mm	3.5 mm
		C1086.5009		9 mm	
		C1086.5011		11 mm	3.2 mm
		C1086.5013		13 mm	
		C1086.5016		16 mm	

Impianti con applicatore avvitato

	Articolo	Art. n°	Ø	L	A Ø
	Impianto CONELOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus incl. applicatore avvitato e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	C1085.3309	3.3 mm	9 mm	2.2 mm
		C1085.3311		11 mm	
		C1085.3313		13 mm	
		C1085.3316		16 mm	
		C1085.3807	3.8 mm	7 mm	3.0 mm
		C1085.3809		9 mm	
		C1085.3811		11 mm	2.7 mm
		C1085.3813		13 mm	
		C1085.3816		16 mm	
		C1085.4307	4.3 mm	7 mm	3.0 mm
		C1085.4309		9 mm	
		C1085.4311		11 mm	2.7 mm
		C1085.4313		13 mm	
		C1085.4316		16 mm	
		C1085.5007	5.0 mm	7 mm	3.5 mm
		C1085.5009		9 mm	
		C1085.5011		11 mm	3.2 mm
		C1085.5013		13 mm	
		C1085.5016		16 mm	

Nota
Per l'inserimento dell'impianto protesicamente guidato con il PROGRESSIVE-LINE Guide System si utilizzano gli impianti con applicatore avvitato (Art. n° C1085.xxxx).

PROGRESSIVE-LINE

Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG®

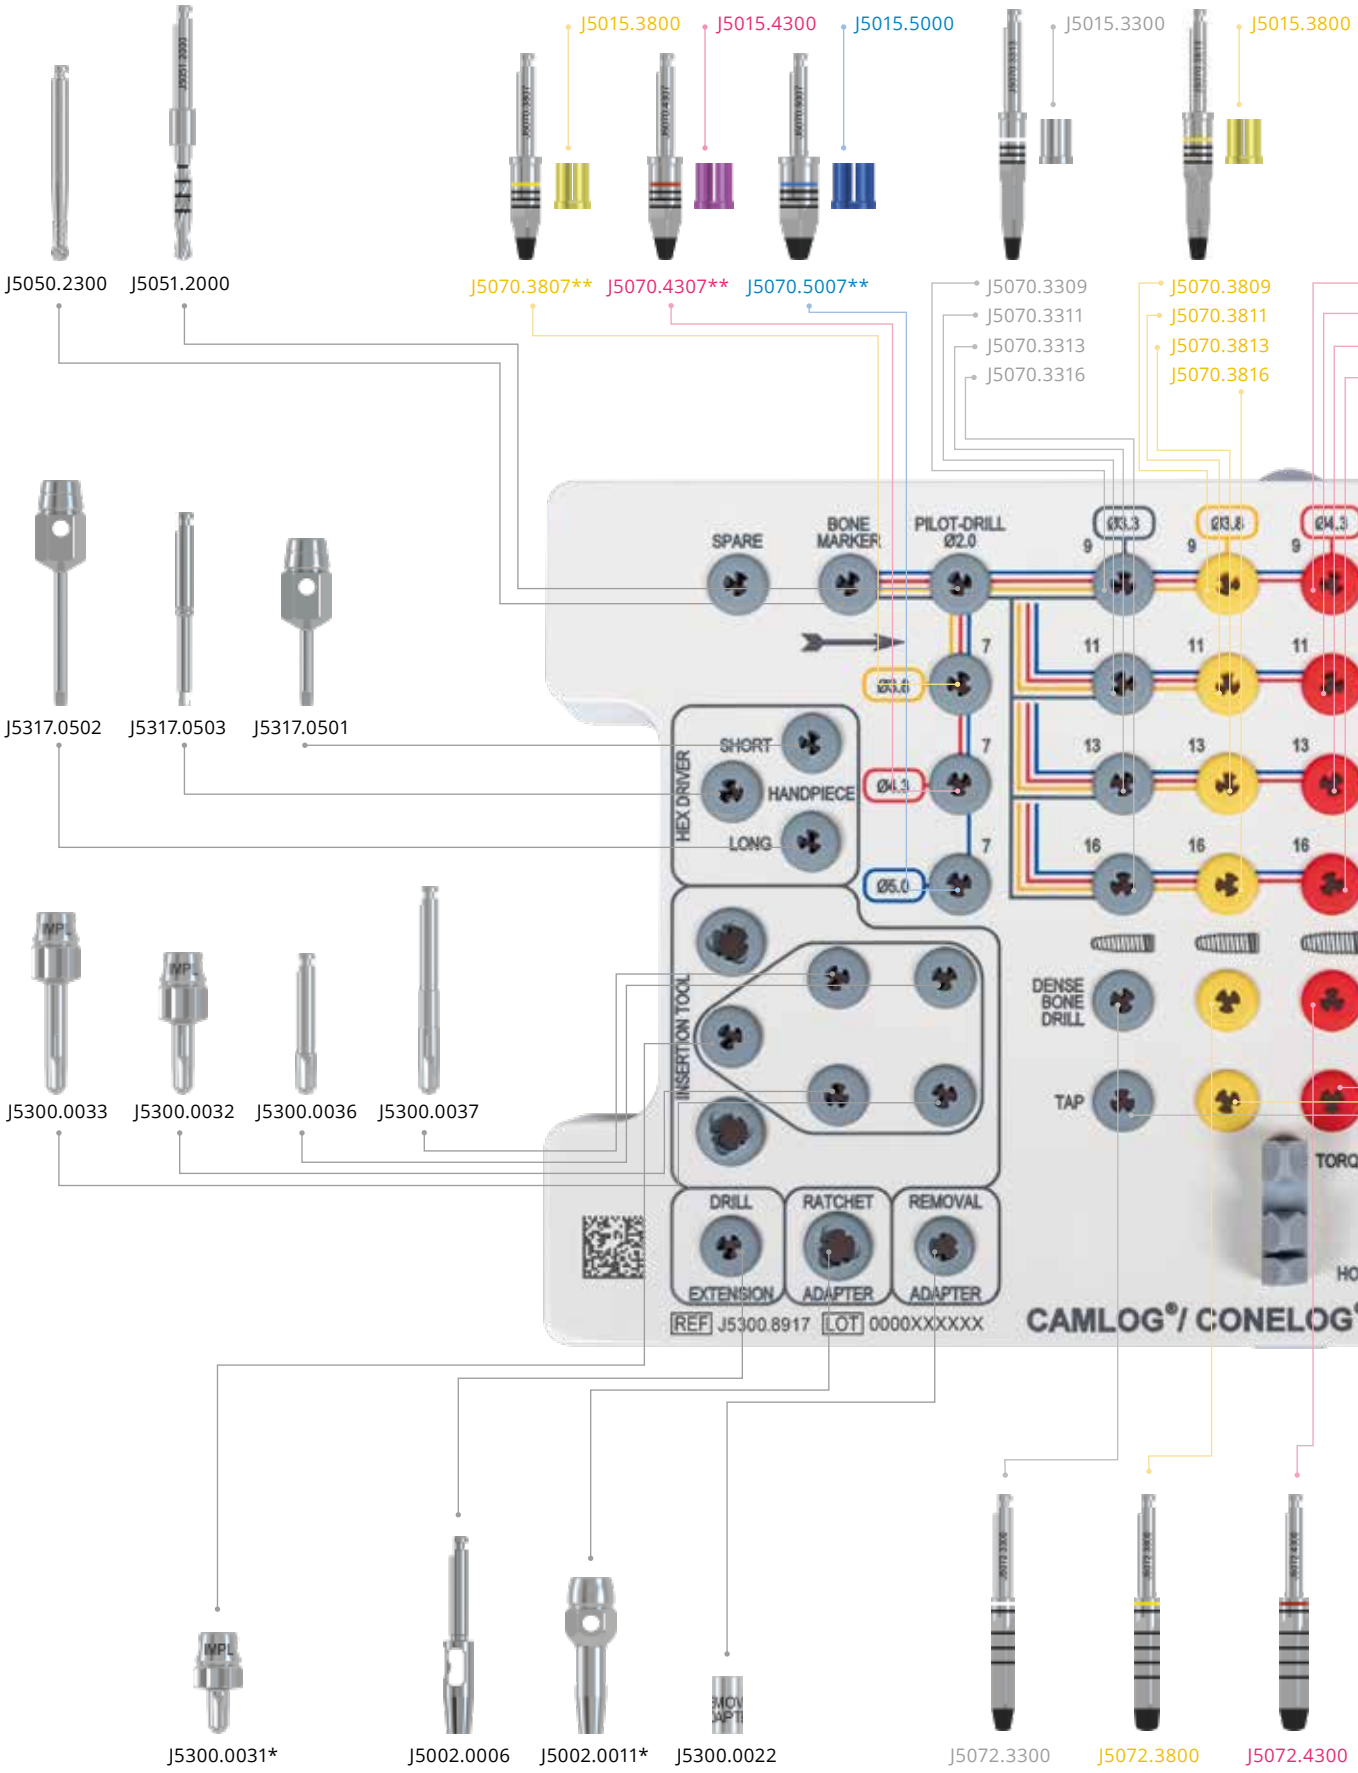

* Questi articoli non sono inclusi nel kit chirurgico e devono essere ordinati separatamente.
** solo per impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE lunghezza 7 mm

Nota

- Le frese sono disposte e/o suddivise nel set in base alle fasi della sequenza del trattamento.
- Le linee colorate evidenziano l'esatta sequenza di utilizzo delle frese.

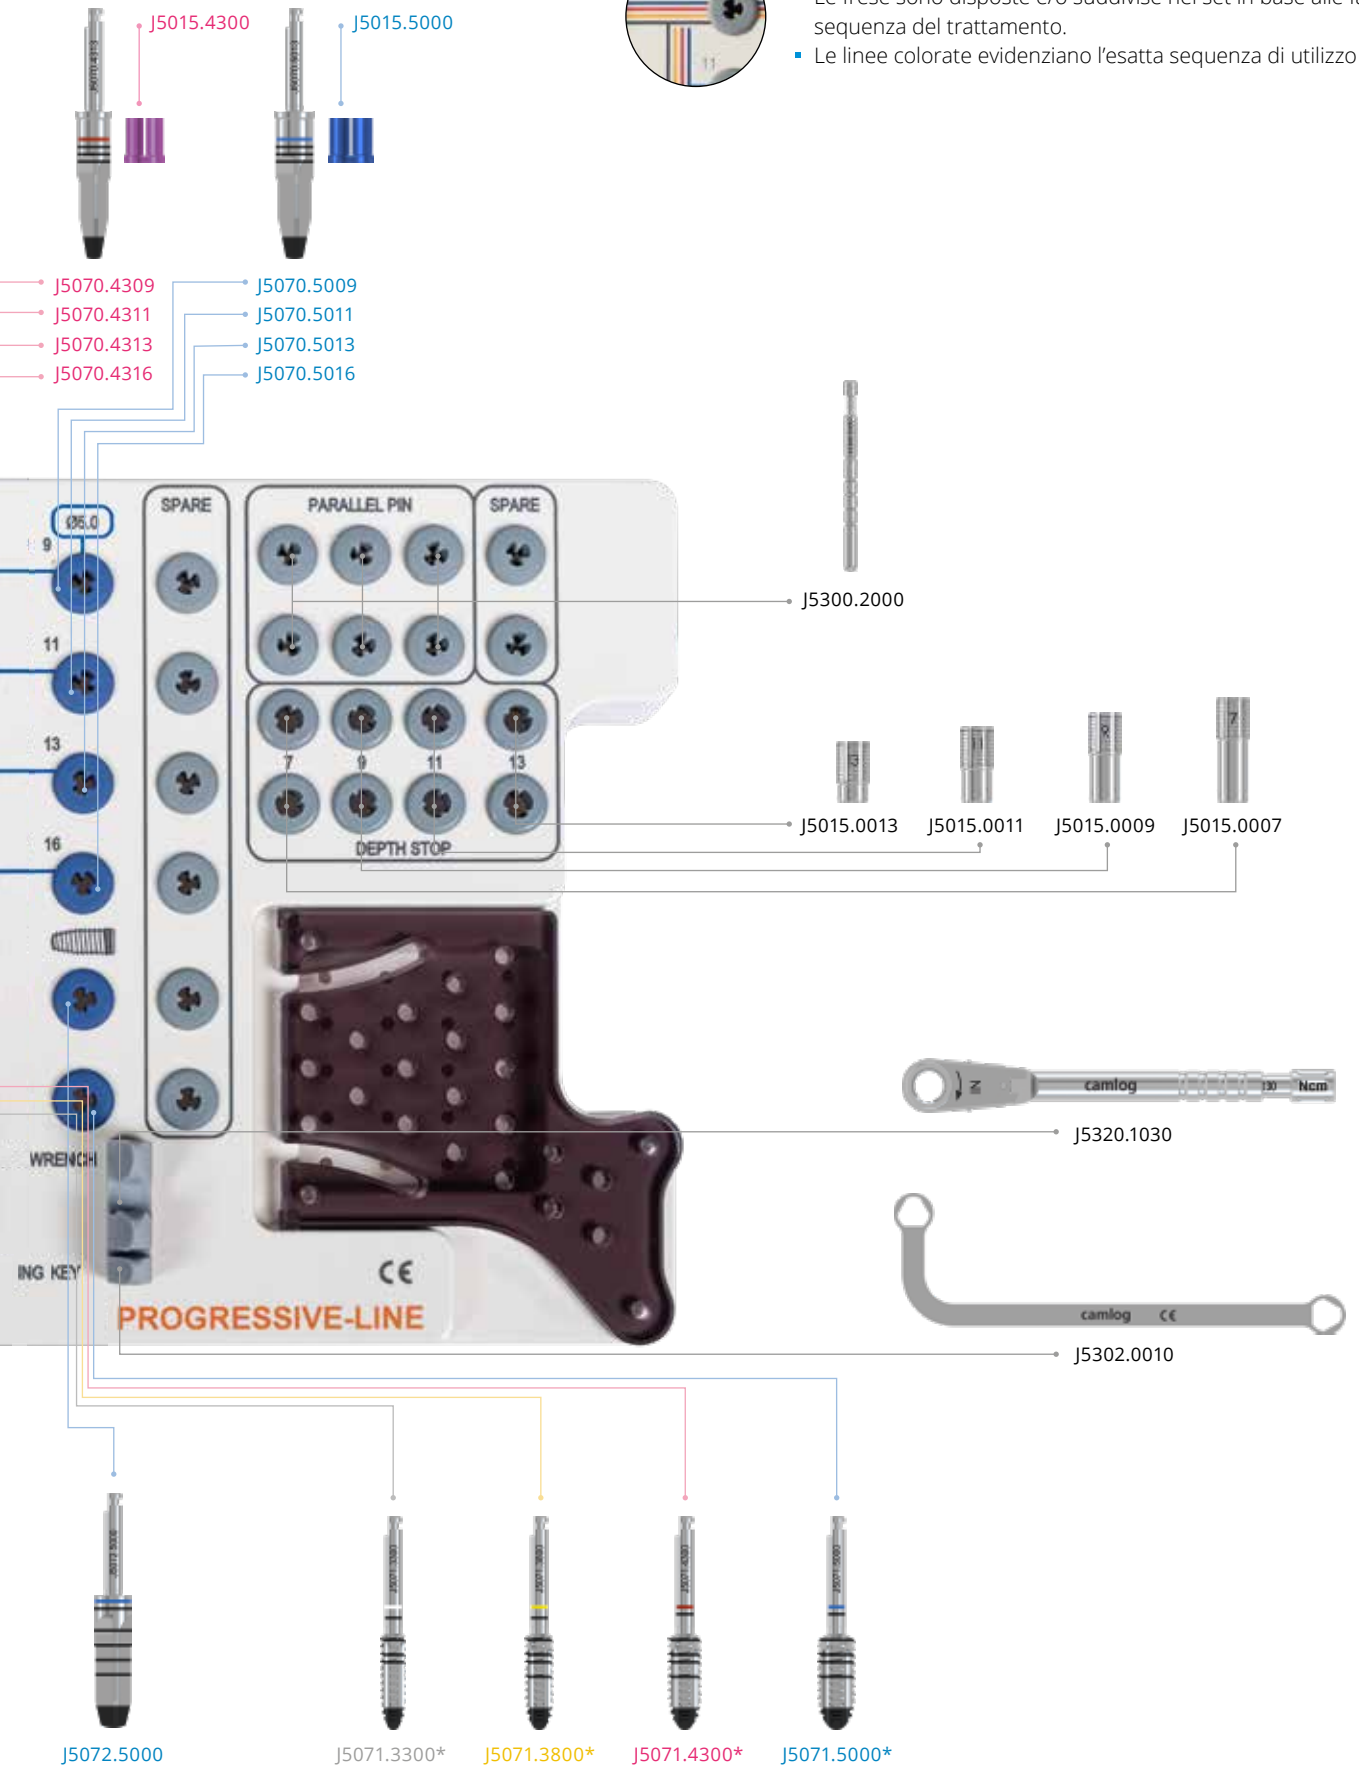

PROGRESSIVE-LINE

Kit chirurgico e wash tray chirurgico

	Articolo	Art. n°
	Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE contiene tutti gli strumenti chirurgici necessari suddivisi per codifica cromatica, comprese la chiave dinamometrica e la chiave ad anello universale (i maschiatori non sono inclusi)	J5300.0065
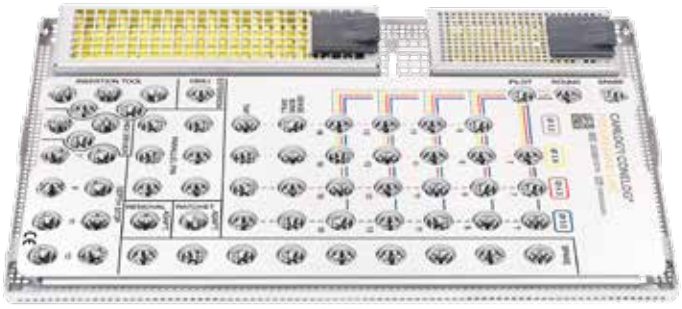	**Wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** incl. mascherina in acciaio, senza contenuto	J5300.8970
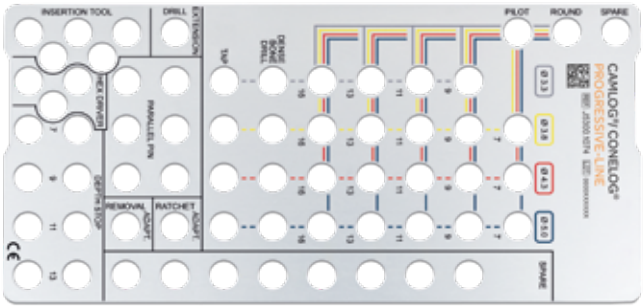	**Mascherina in acciaio per wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** **Materiale** Acciaio inossidabile	J5300.1074

Per la preparazione del sito implantare per gli impianti CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE e gli impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE si utilizzano i medesimi strumenti.

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Fresa a forma PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5070.3309	3.3 mm	9 mm
		J5070.3311		11 mm
		J5070.3313		13 mm
		J5070.3316		16 mm
		J5070.3807	3.8 mm	7 mm
		J5070.3809		9 mm
		J5070.3811		11 mm
		J5070.3813		13 mm
		J5070.3816		16 mm
		J5070.4307	4.3 mm	7 mm
		J5070.4309		9 mm
		J5070.4311		11 mm
		J5070.4313		13 mm
		J5070.4316		16 mm
		J5070.5007	5.0 mm	7 mm
		J5070.5009		9 mm
		J5070.5011		11 mm
		J5070.5013		13 mm
		J5070.5016		16 mm
	Stop di profondità per fresa a forma SCREW-LINE (utilizzabile anche per la fresa a forma PROGRESSIVE-LINE), risterilizzabile **Materiale** Lega di titanio	J5015.3300	3.3 mm	-
		J5015.3800	3.8 mm	
		J5015.4300	4.3 mm	
		J5015.5000	5.0 mm	
	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5072.3300	3.3 mm	-
		J5072.3800	3.8 mm	
		J5072.4300	4.3 mm	
		J5072.5000	5.0 mm	
	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5072.3302	3.3 mm	-
		J5072.3802	3.8 mm	
		J5072.4302	4.3 mm	
		J5072.5002	5.0 mm	
	Maschiatore PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5071.3300	3.3 mm	-
		J5071.3800	3.8 mm	
		J5071.4300	4.3 mm	
		J5071.5000	5.0 mm	
	Perno parallelizzatore con tacche di profondità (per frese pilota Ø 2.0 mm) **Materiale** Lega di titanio	J5300.2000	-	-

PROGRESSIVE-LINE Guide System

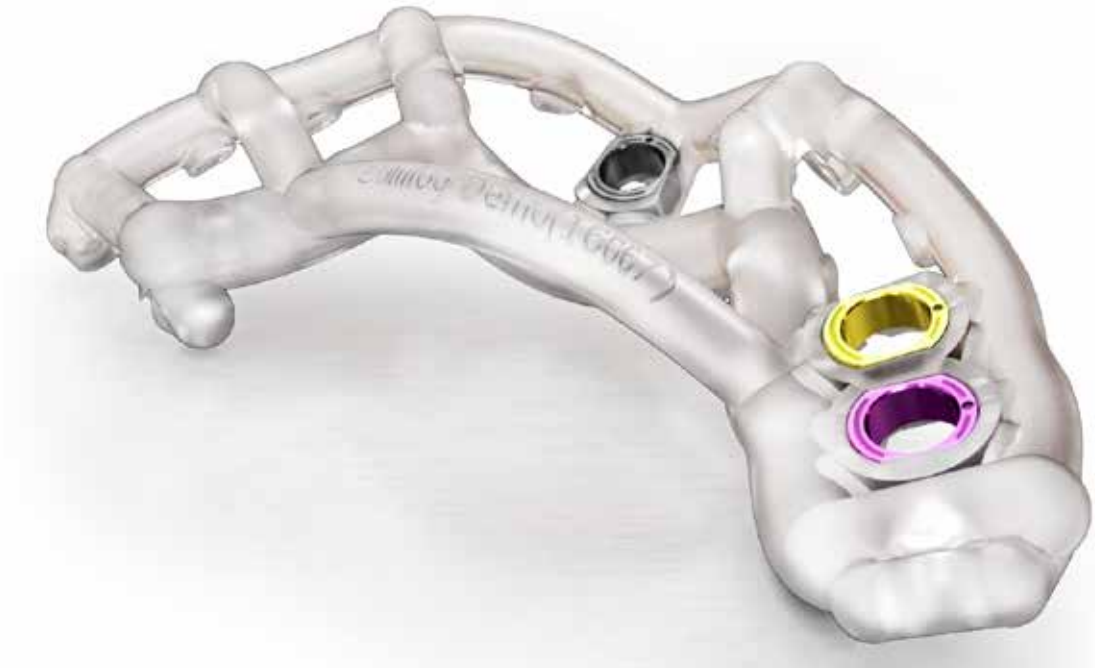

Per la pianificazione di impianti in 3D, la progettazione e la realizzazione di guide di fresaggio è possibile rivolgersi al nostro partner di servizio CAD/CAM DEDICAM®.
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

PROGRESSIVE-LINE Guide System

Tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG®

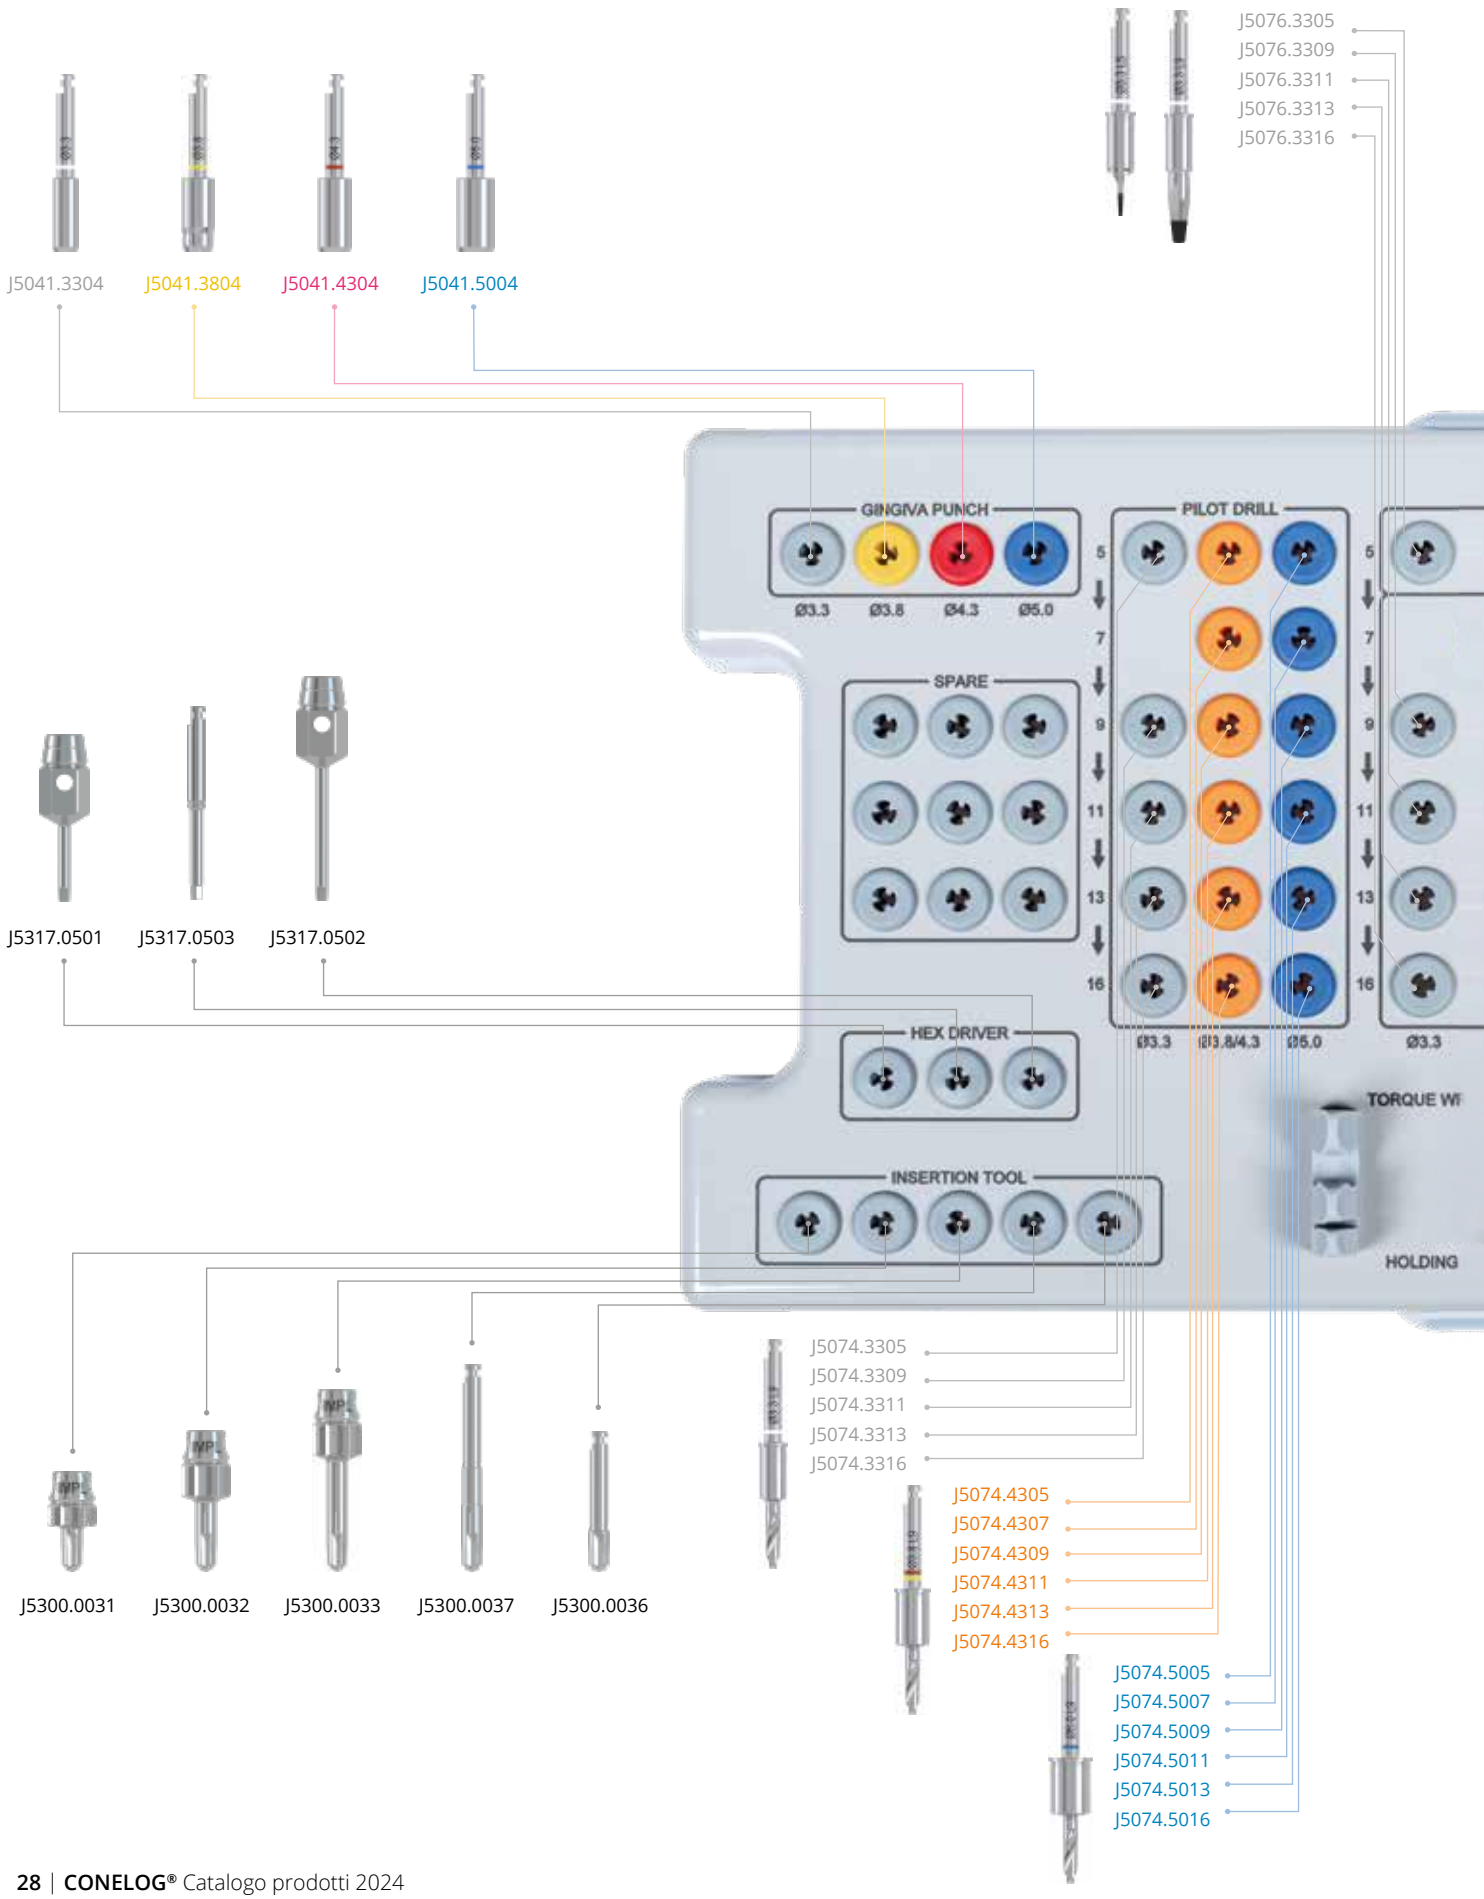

J5076.3805
J5076.3807
J5076.3809
J5076.3811
J5076.3813
J5076.3816

Nota

- Le frese sono disposte e/o suddivise nel set in base alle fasi della sequenza del trattamento.
- Le linee colorate evidenziano l'esatta sequenza di utilizzo delle frese.

J5076.4305
J5076.4307
J5076.4309
J5076.4311
J5076.4313
J5076.4316

J5076.5005
J5076.5007
J5076.5009
J5076.5011
J5076.5013
J5076.5016

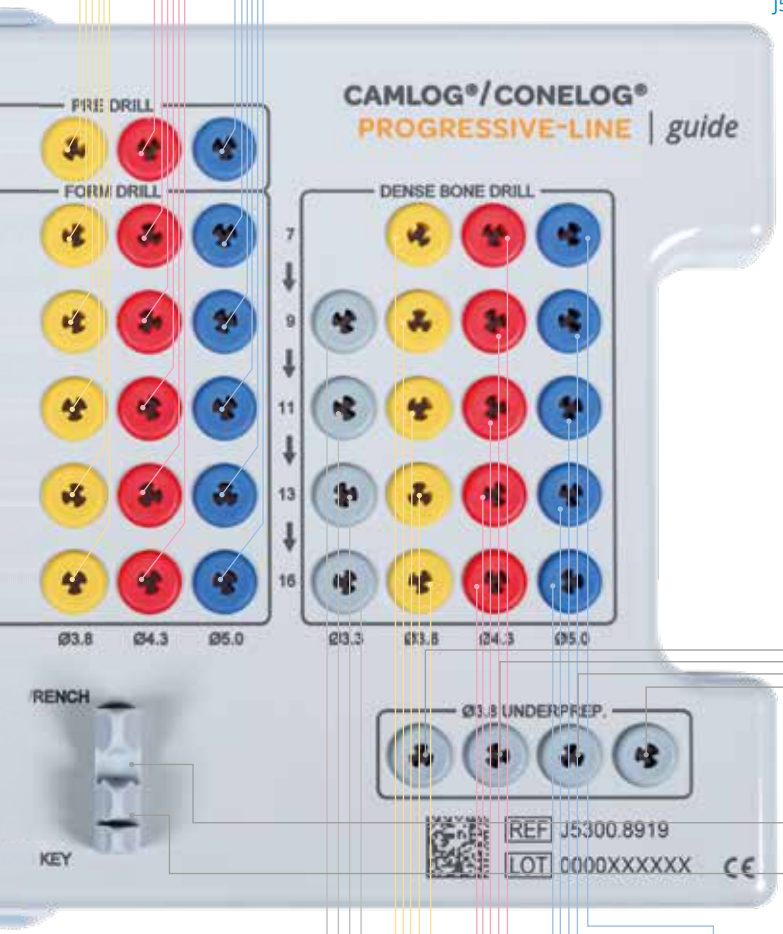

J5077.3316
J5077.3313
J5077.3311
J5077.3309

J5320.1030

J5302.0010

J5078.3309
J5078.3311
J5078.3313
J5078.3316

J5078.3807
J5078.3809
J5078.3811
J5078.3813
J5078.3816

J5078.4307
J5078.4309
J5078.4311
J5078.4313
J5078.4316

J5078.5007
J5078.5009
J5078.5011
J5078.5013
J5078.5016

PROGRESSIVE-LINE Guide System

Tray chirurgico e wash tray chirurgico

	Articolo	Art. n°
	Tray chirurgico Guide System CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE senza contenuto	J5300.8919
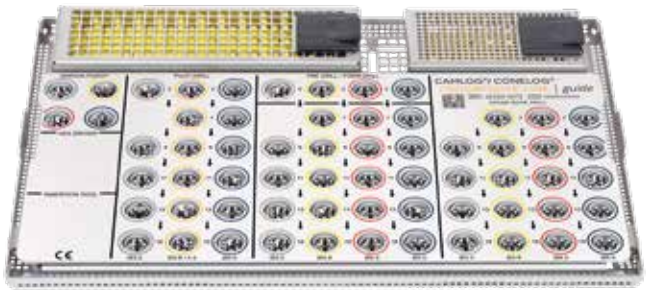	**Wash tray chirurgico Guide System CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** incl. mascherina in acciaio, senza contenuto	J5300.8971
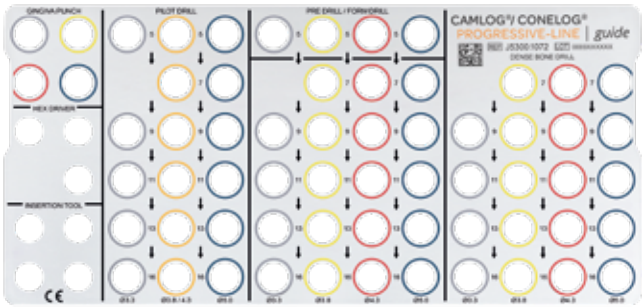	**Mascherina in acciaio per wash tray chirurgico Guide System CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE** **Materiale** Acciaio inossidabile	J5300.1072

Nota
Per l'inserimento dell'impianto protesicamente guidato con il PROGRESSIVE-LINE Guide System si utilizzano gli impianti con applicatore avvitato (Art. n° C1085.xxxx).

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Mucotomo Guide System **PROGRESSIVE-LINE** risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5041.3304	3.3 mm	-
		J5041.3804	3.8 mm	
		J5041.4304	4.3 mm	
		J5041.5004	5.0 mm	
	Fresa pilota Guide System **PROGRESSIVE-LINE** risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5074.3305	3.3 mm	5 mm
		J5074.3309		9 mm
		J5074.3311		11 mm
		J5074.3313		13 mm
		J5074.3316		16 mm
		J5074.4305	3.8 mm / 4.3 mm	5 mm
		J5074.4307		7 mm
		J5074.4309		9 mm
		J5074.4311		11 mm
		J5074.4313		13 mm
		J5074.4316		16 mm
		J5074.5005	5.0 mm	5 mm
		J5074.5007		7 mm
		J5074.5009		9 mm
		J5074.5011		11 mm
		J5074.5013		13 mm
		J5074.5016		16 mm
	Fresa iniziale Guide System **PROGRESSIVE-LINE** risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5076.3305	3	5 mm
		J5076.3805	3.8 mm	
		J5076.4305	4.3 mm	
		J5076.5005	5.0 mm	
	Fresa a forma Guide System **PROGRESSIVE-LINE** risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5076.3309	3.3 mm	9 mm
		J5076.3311		11 mm
		J5076.3313		13 mm
		J5076.3316		16 mm
		J5076.3807	3.8 mm	7 mm
		J5076.3809		9 mm
		J5076.3811		11 mm
		J5076.3813		13 mm
		J5076.3816		16 mm
		J5076.4307	4.3 mm	7 mm
		J5076.4309		9 mm
		J5076.4311		11 mm
		J5076.4313		13 mm
		J5076.4316		16 mm
		J5076.5007	5.0 mm	7 mm
		J5076.5009		9 mm
		J5076.5011		11 mm
		J5076.5013		13 mm
		J5076.5016		16 mm

PROGRESSIVE-LINE Guide System

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Dense bone drill Guide System PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5078.3309	3.3 mm	9 mm
		J5078.3311		11 mm
		J5078.3313		13 mm
		J5078.3316		16 mm
		J5078.3807	3.8 mm	7 mm
		J5078.3809		9 mm
		J5078.3811		11 mm
		J5078.3813		13 mm
		J5078.3816		16 mm
		J5078.4307	4.3 mm	7 mm
		J5078.4309		9 mm
		J5078.4311		11 mm
		J5078.4313		13 mm
		J5078.4316		16 mm
		J5078.5007	5.0 mm	7 mm
		J5078.5009		9 mm
		J5078.5011		11 mm
		J5078.5013		13 mm
		J5078.5016		16 mm
	Fresa a forma Guide System per sottopreparazione di Ø 3.8 mm PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5077.3309	3.3 mm	9 mm
		J5077.3311		11 mm
		J5077.3313		13 mm
		J5077.3316		16 mm
	Boccole Guide System PROGRESSIVE-LINE 2 unità **Materiale** Lega di titanio	J3754.3301*	3.3 mm	-
		J3754.3801*	3.8 mm	
		J3754.4301*	4.3 mm	
		J3754.5001*	5.0 mm	

* Le boccole non sono compatibili con lo SCREW-LINE Guide System.

PROGRESSIVE-LINE Flex

PROGRESSIVE-LINE Flex

Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG®

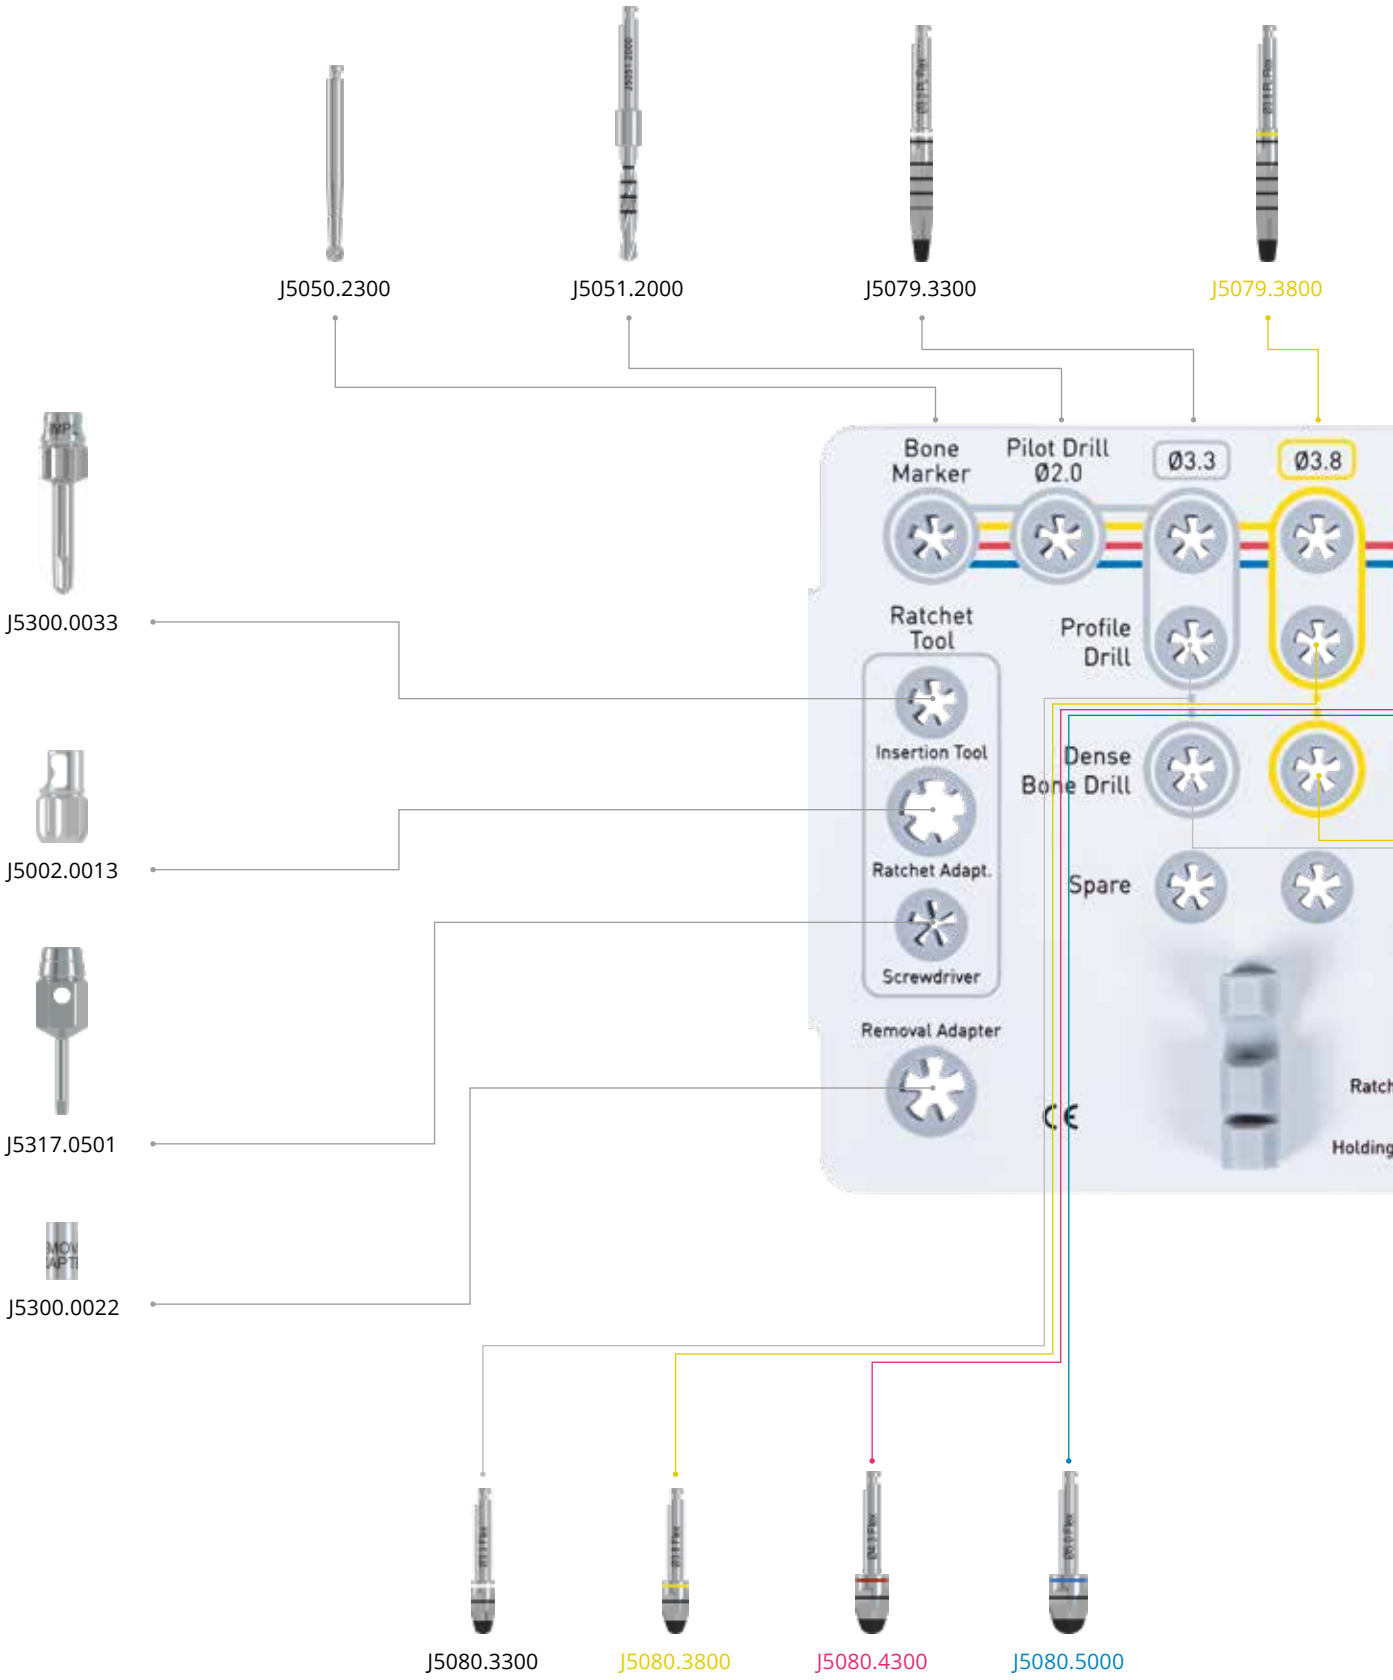

Nota

- Le frese sono disposte e/o suddivise nel set in base alle fasi della sequenza del trattamento.
- Le linee colorate evidenziano l'esatta sequenza di utilizzo delle frese.

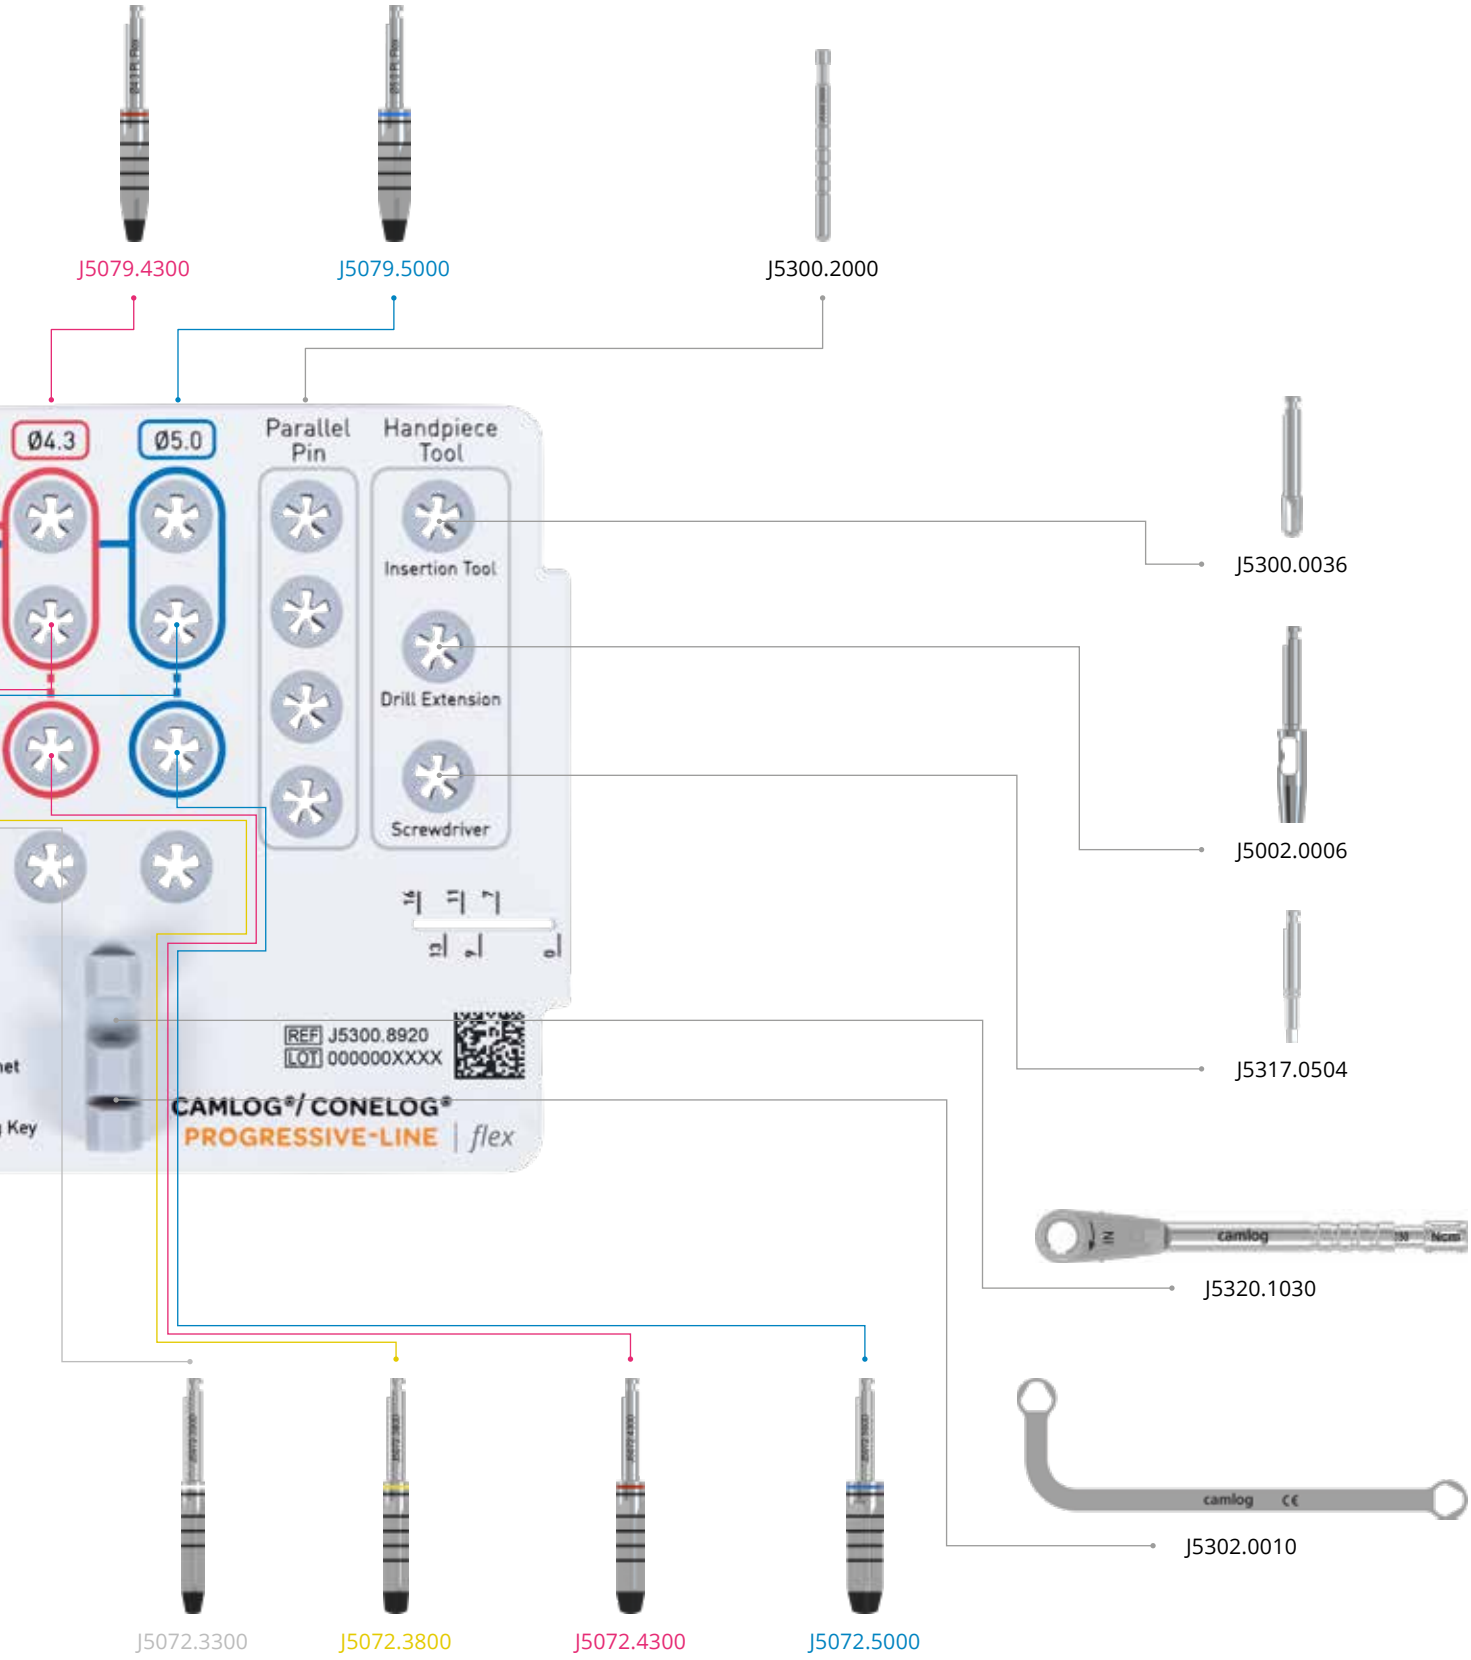

PROGRESSIVE-LINE Flex

Kit chirurgico

	Articolo	Art. n°
	Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex contiene tutti gli strumenti chirurgici necessari suddivisi per codifica cromatica, comprese la chiave dinamometrica e la chiave ad anello universale	J5300.0071

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Fresa PROGRESSIVE-LINE Flex risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5079.3300	3.3 mm	-
		J5079.3800	3.8 mm	
		J5079.4300	4.3 mm	
		J5079.5000	5.0 mm	
	Fresa profilata PROGRESSIVE-LINE Flex risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5080.3300	3.3 mm	-
		J5080.3800	3.8 mm	
		J5080.4300	4.3 mm	
		J5080.5000	5.0 mm	
	Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5072.3300	3.3 mm	-
		J5072.3800	3.8 mm	
		J5072.4300	4.3 mm	
		J5072.5000	5.0 mm	
	Dense bone drill 2 PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5072.3302	3.3 mm	-
		J5072.3802	3.8 mm	
		J5072.4302	4.3 mm	
		J5072.5002	5.0 mm	
	Maschiatore PROGRESSIVE-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5071.3300	3.3 mm	-
		J5071.3800	3.8 mm	
		J5071.4300	4.3 mm	
		J5071.5000	5.0 mm	
	Adattatore per cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	J5002.0013	-	12.5 mm

SCREW-LINE

SCREW-LINE

Impianti con applicatore innestato

	Articolo	Art. n°	Ø	L	A Ø
	Impianto CONELOG® SCREW-LINE, Promote® plus incl. applicatore snap-in e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	C1066.3309	3.3 mm	9 mm	2.7 mm
		C1066.3311		11 mm	
		C1066.3313		13 mm	
		C1066.3316		16 mm	
		C1066.3807	3.8 mm	7 mm	3.5 mm
		C1066.3809		9 mm	
		C1066.3811		11 mm	
		C1066.3813		13 mm	
		C1066.3816		16 mm	
		C1066.4307	4.3 mm	7 mm	3.9 mm
		C1066.4309		9 mm	
		C1066.4311		11 mm	
		C1066.4313		13 mm	
		C1066.4316		16 mm	
		C1066.5007	5.0 mm	7 mm	4.6 mm
		C1066.5009		9 mm	
		C1066.5011		11 mm	
		C1066.5013		13 mm	
		C1066.5016		16 mm	

Impianti con applicatore avvitato

	Articolo	Art. n°	Ø	L	A Ø
	Impianto CONELOG® SCREW-LINE, Promote® plus incl. applicatore avvitato e vite tappo, sterile **Materiale** Titanio grado 4	C1065.3309	3.3 mm	9 mm	2.7 mm
		C1065.3311		11 mm	
		C1065.3313		13 mm	
		C1065.3316		16 mm	
		C1065.3807	3.8 mm	7 mm	3.5 mm
		C1065.3809		9 mm	
		C1065.3811		11 mm	
		C1065.3813		13 mm	
		C1065.3816		16 mm	
		C1065.4307	4.3 mm	7 mm	3.9 mm
		C1065.4309		9 mm	
		C1065.4311		11 mm	
		C1065.4313		13 mm	
		C1065.4316		16 mm	
		C1065.5007	5.0 mm	7 mm	4.6 mm
		C1065.5009		9 mm	
		C1065.5011		11 mm	
		C1065.5013		13 mm	
		C1065.5016		16 mm	

Nota
Per l'inserimento dell'impianto protesicamente guidato con lo SCREW-LINE Guide System si utilizzano gli impianti con applicatore avvitato (Art. n° C1065.xxxx).
Lo SCREW-LINE Guide System è utilizzabile solo per i diametri dell'impianto di 3.3/3.8/4.3.

SCREW-LINE

Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG®

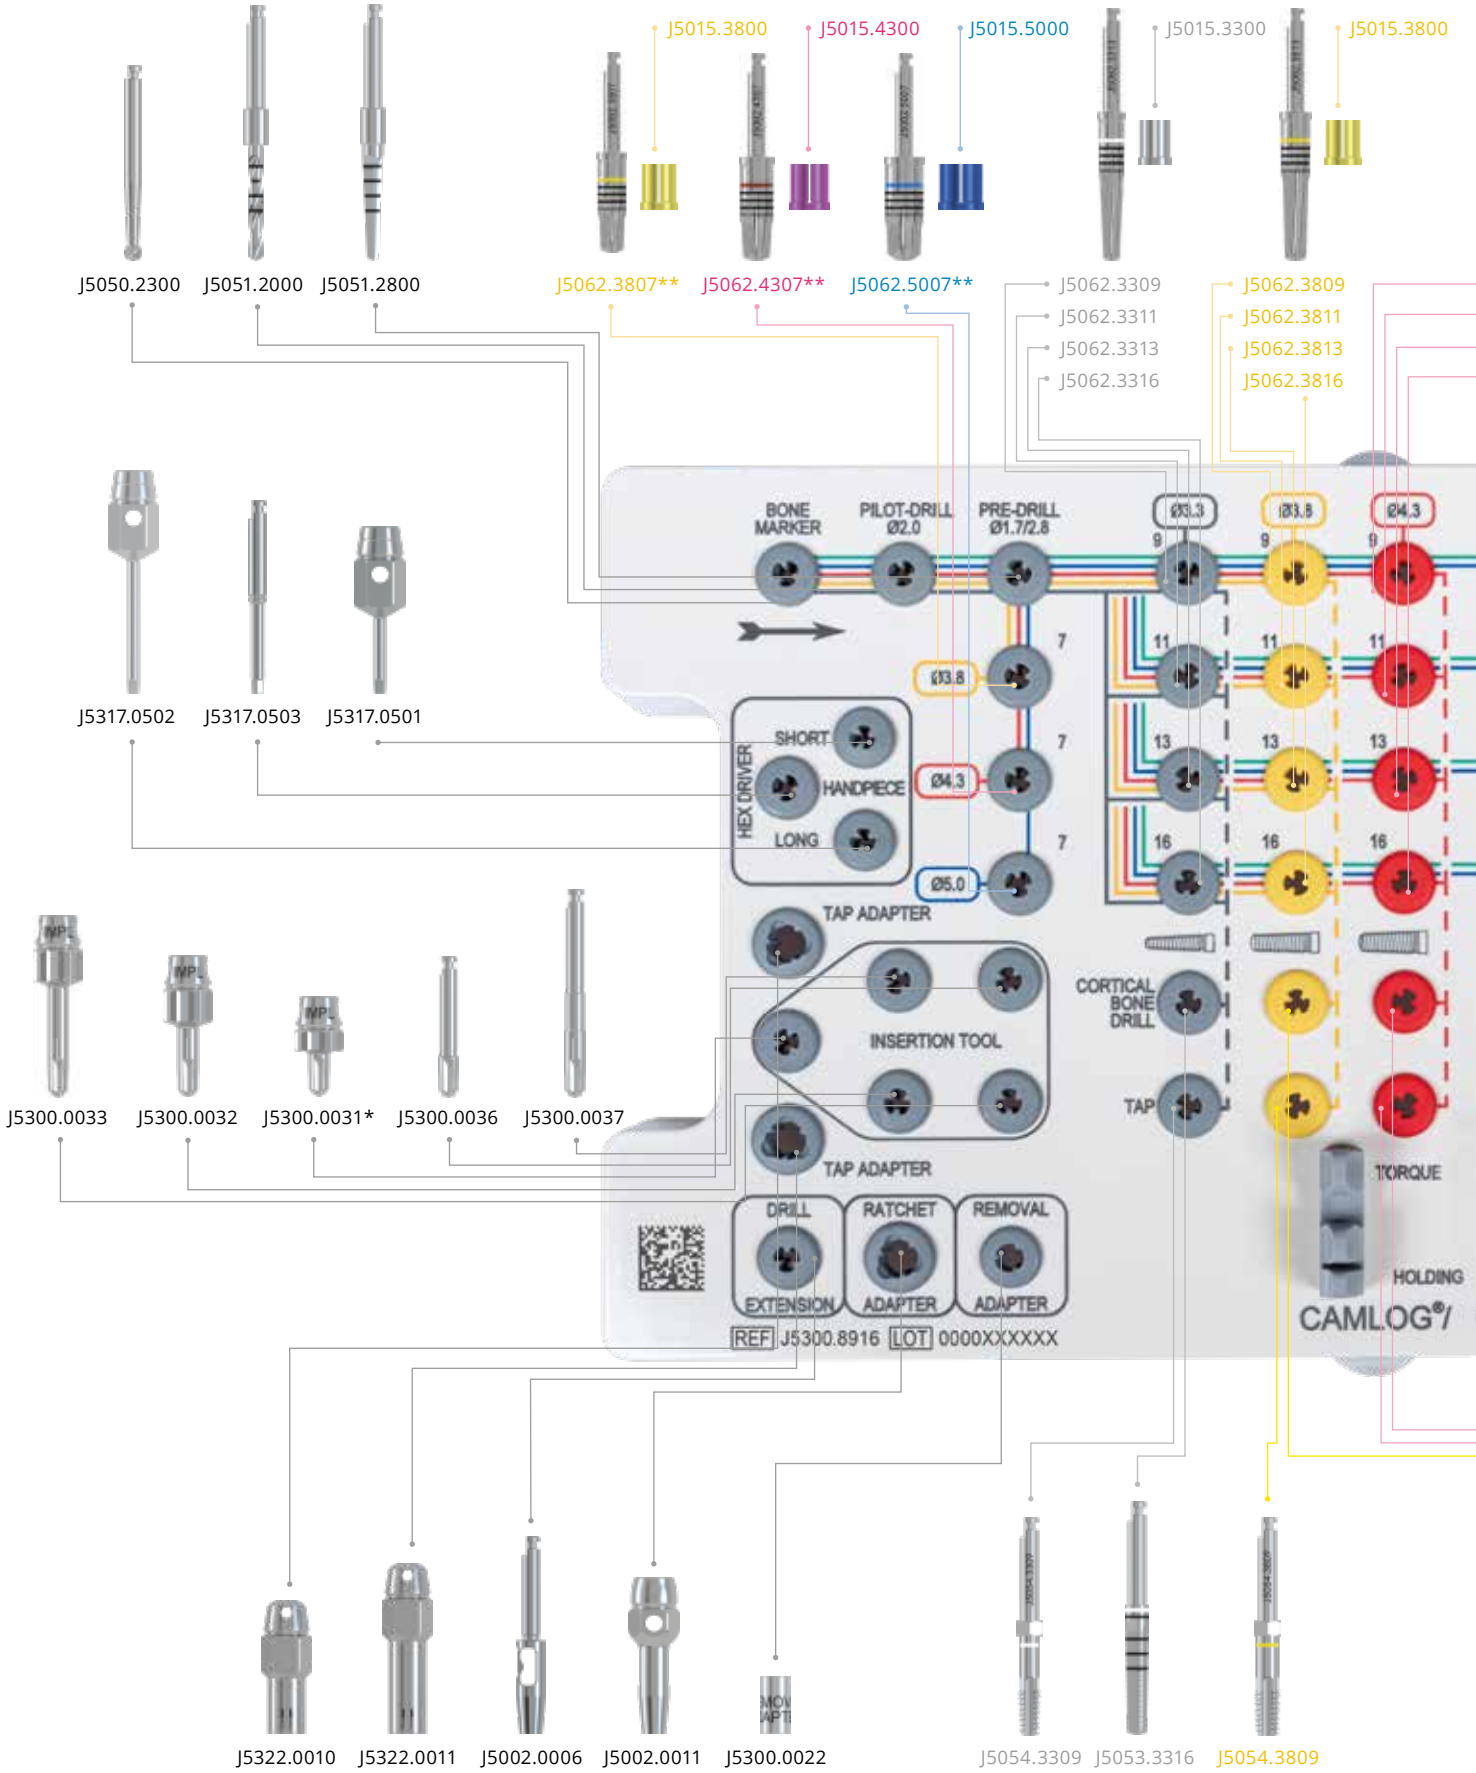

* Questo articolo non è incluso nel kit chirurgico e deve essere ordinato separatamente.
** solo per gli impianti CONELOG® SCREW-LINE con lunghezza di 7 mm

Nota

- Le frese sono disposte e/o suddivise nel set in base alle fasi della sequenza del trattamento.
- Le linee colorate evidenziano l'esatta sequenza di utilizzo delle frese.

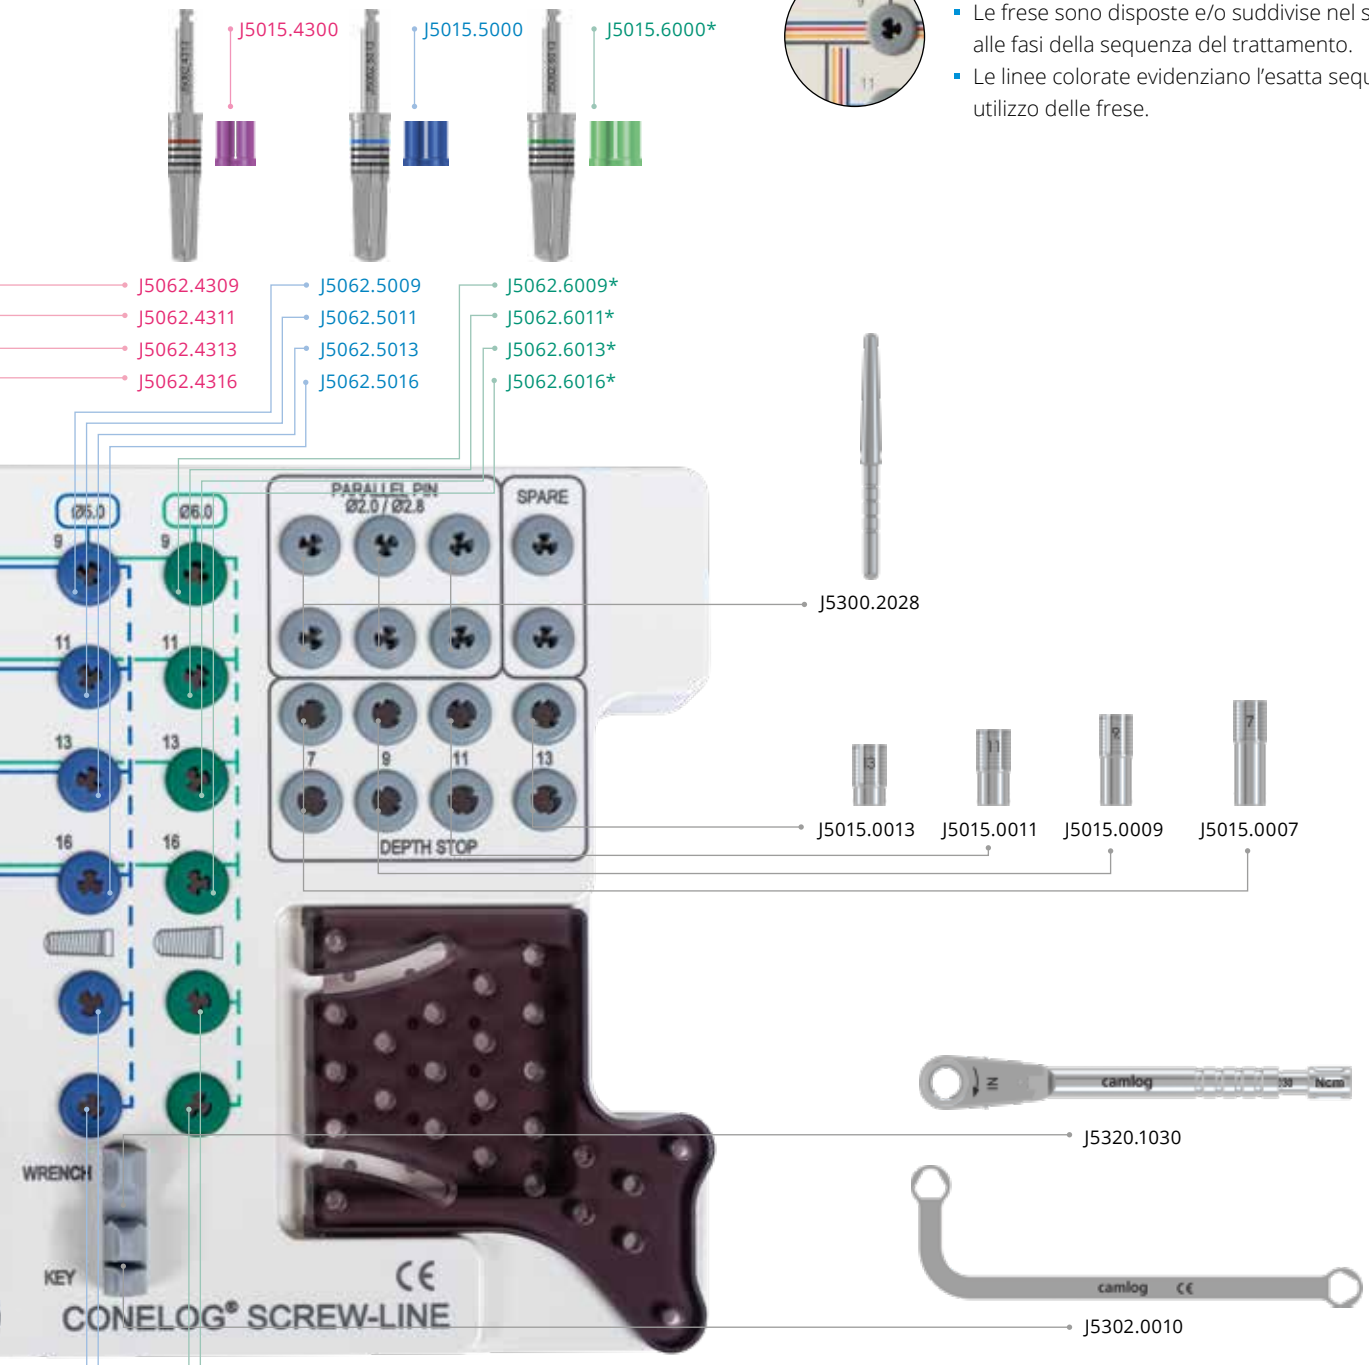

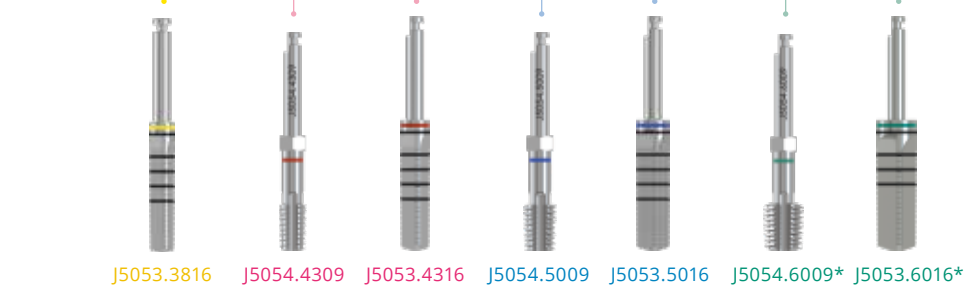

SCREW-LINE

Kit chirurgico e wash tray chirurgico

	Articolo	Art. n°
	Kit chirurgico CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE contiene tutti gli strumenti chirurgici necessari suddivisi per codifica cromatica, comprese la chiave dinamometrica e la chiave ad anello universale (le frese e i maschiatori per Ø 6.0 non sono inclusi)	J5300.0063
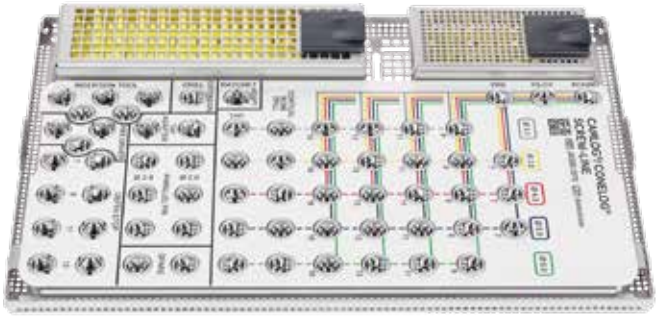	**Wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** incl. mascherina in acciaio, senza contenuto	J5300.8968
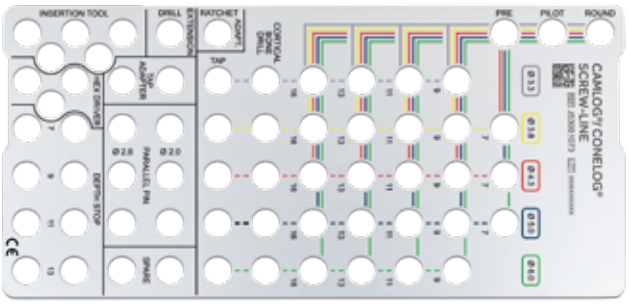	**Mascherina in acciaio per wash tray chirurgico CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** **Materiale** Acciaio inossidabile	J5300.1073

Per la preparazione del sito implantare per gli impianti CAMLOG® SCREW-LINE e gli impianti CONELOG® SCREW-LINE si utilizzano i medesimi strumenti.

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Fresa a forma SCREW-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5062.3309	3.3 mm	9 mm
		J5062.3311		11 mm
		J5062.3313		13 mm
		J5062.3316		16 mm
		J5062.3807	3.8 mm	7 mm
		J5062.3809		9 mm
		J5062.3811		11 mm
		J5062.3813		13 mm
		J5062.3816		16 mm
		J5062.4307	4.3 mm	7 mm
		J5062.4309		9 mm
		J5062.4311		11 mm
		J5062.4313		13 mm
		J5062.4316		16 mm
		J5062.5007	5.0 mm	7 mm
		J5062.5009		9 mm
		J5062.5011		11 mm
		J5062.5013		13 mm
		J5062.5016		16 mm
	Stop di profondità per fresa a forma SCREW-LINE (utilizzabile anche per la fresa a forma PROGRESSIVE-LINE), risterilizzabile **Materiale** Lega di titanio	J5015.3300	3.3 mm	-
		J5015.3800	3.8 mm	
		J5015.4300	4.3 mm	
		J5015.5000	5.0 mm	
	Fresa a forma SCREW-LINE per osso corticale risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5053.3316	3.3 mm	-
		J5053.3816	3.8 mm	
		J5053.4316	4.3 mm	
		J5053.5016	5.0 mm	
	Maschiatore SCREW-LINE con attacco esagonale, risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5054.3309	3.3 mm	-
		J5054.3809	3.8 mm	
		J5054.4309	4.3 mm	
		J5054.5009	5.0 mm	

SCREW-LINE Guide System

Per la pianificazione di impianti in 3D, la progettazione e la realizzazione di guide di fresaggio è possibile rivolgersi al nostro partner di servizio CAD/CAM DEDICAM®.
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

SCREW-LINE Guide System

Strumenti chirurgici

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Set di frese pilota Guide System raffreddamento interno, sterili (per frese pilota Ø 2.0 mm) **Materiale** Acciaio inossidabile	J5063.3309	3.3 mm	9 mm (incl. 5 mm)**
		J5063.3311		11 mm (incl. 5 e 9 mm)**
		J5063.3313		13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)**
		J5064.3316*		16 mm
		J5063.4307	3.8 mm	7 mm (incl. 5 mm)**
			4.3 mm	
		J5063.4309	3.8 mm	9 mm (incl. 5 mm)**
			4.3 mm	
		J5063.4311	3.8 mm	11 mm (incl. 5 e 9 mm)**
			4.3 mm	
		J5063.4313	3.8 mm	13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)**
			4.3 mm	
		J5064.4316*	3.8 mm	16 mm
			4.3 mm	
	Set chirurgico Guide System SCREW-LINE raffreddamento interno, sterile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5065.3309	3.3 mm	9 mm (incl. 5 mm)****
		J5065.3311		11 mm (incl. 5 e 9 mm)****
		J5065.3313		13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)****
		J5066.3316***		16 mm
		J5065.3807	3.8 mm	7 mm (incl. 5 mm)****
		J5065.3809		9 mm (incl. 5 mm)****
		J5065.3811		11 mm (incl. 5 e 9 mm)****
		J5065.3813		13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)****
		J5066.3816***		16 mm
		J5065.4307	4.3 mm	7 mm (incl. 5 mm)****
		J5065.4309		9 mm (incl. 5 mm)****
		J5065.4311		11 mm (incl. 5 e 9 mm)****
		J5065.4313		13 mm (incl. 5, 9 e 11 mm)****
		J5066.4316***		16 mm

* Fresa pilota Guide System necessaria per la lunghezza dell'impianto di 16 mm, dopo aver utilizzato obbligatoriamente il set di frese pilota nella lunghezza di 13 mm.

** Tutti i set di frese pilota Guide System includono una fresa pilota lunga 5 mm e tutte le restanti frese pilota necessarie fino alla lunghezza dell'impianto selezionata.

*** Fresa a forma Guide System necessaria per la lunghezza dell'impianto di 16 mm, dopo aver utilizzato obbligatoriamente il set chirurgico Guide System nella lunghezza di 13 mm.

**** Tutti i set chirurgici Guide System includono una fresa iniziale lunga 5 mm e tutte le restanti frese a forma necessarie fino alla lunghezza dell'impianto selezionata.

Tutte le frese e tutti i mucotomi Guide System SCREW-LINE sono esclusivamente prodotti monouso.

Nota
Per l'inserimento dell'impianto protesicamente guidato con lo SCREW-LINE Guide System si utilizzano gli impianti con applicatore avvitato (Art. n° C1065.xxxx).
Lo SCREW-LINE Guide System è utilizzabile solo per i diametri dell'impianto di 3.3/3.8/4.3.

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Fresa a forma Guide System SCREW-LINE per osso corticale raffreddamento interno, sterile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5068.3309	3.3 mm	9 mm
		J5068.3311		11 mm
		J5068.3313		13 mm
		J5068.3316		16 mm
		J5068.3807	3.8 mm	7 mm
		J5068.3809		9 mm
		J5068.3811		11 mm
		J5068.3813		13 mm
		J5068.3816		16 mm
		J5068.4307	4.3 mm	7 mm
		J5068.4309		9 mm
		J5068.4311		11 mm
		J5068.4313		13 mm
		J5068.4316		16 mm
	Mucotomo Guide System sterile **Materiale** Acciaio inossidabile	J5041.3303	3.3 mm	-
		J5041.3803	3.8 mm	
		J5041.4303	4.3 mm	
	Boccole Guide System Altezza 3.0 mm 2 unità **Materiale** Lega di titanio	J3734.3303*	3.3 mm	-
		J3734.3803*	3.8 mm	
		J3734.4303*	4.3 mm	
	Prolunga della fresa Gambo ISO, per strumenti a raffreddamento interno **Materiale** Acciaio inossidabile	J5002.0005	-	26.6 mm

* Le boccole non sono compatibili con il PROGRESSIVE-LINE Guide System.

Tutte le frese e tutti i mucotomi Guide System SCREW-LINE sono esclusivamente prodotti monouso.

Strumenti chirurgici generali

Strumenti chirurgici generali

	Articolo		Art. n°	Ø	L
	Fresa a rosetta risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5050.2300	2.3 mm	-
	Punta appuntita risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5051.1500	1.5 mm	-
	Fresa pilota senza flangia, risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5051.2003	2.0 mm	-
	Fresa pilota SCREW-LINE (utilizzabile anche per PROGRESSIVE-LINE), risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5051.2000	2.0 mm	-
	Fresa iniziale SCREW-LINE risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5051.2800	1.7–2.8 mm	-
	Stop di profondità SCREW-LINE per fresa pilota (J5051.2000) e fresa iniziale (J5051.2800), con flangia ridotta, risterilizzabile **Materiale** Acciaio inossidabile		J5015.0009	-	9 mm
			J5015.0011		11 mm
			J5015.0013		13 mm
	Profilatore osseo **Materiale** Acciaio inossidabile	Ø 5.0 mm	J5003.3350*	3.3 mm	-
		Ø 6.0 mm	J5003.4360*	3.8 mm	
				4.3 mm	
		Ø 7.0 mm	J5003.5070*	5.0 mm	
	Perno guida per profilatore osseo CONELOG® **Materiale** Lega di titanio		C5002.3300	3.3 mm	-
			C5002.3800	3.8 mm	
			C5002.4300	4.3 mm	
			C5002.5000	5.0 mm	

* Utilizzare sempre in associazione con il corrispondente perno guida!

Strumenti chirurgici generali

	Articolo		Misura	Art. n°	Ø	Misura
	Livellatore **Materiale** Acciaio inossidabile	Ø 4.6 mm	-	J5006.3346	3.3 mm	-
		Ø 5.2 mm		J5006.3852	3.8 mm	
		Ø 5.6 mm		J5006.4356	4.3 mm	
		Ø 6.3 mm		J5006.5063	5.0 mm	
	Fresa di apertura per vite tappo **Materiale** Acciaio inossidabile		-	J5004.3300	3.3 mm	-
				J5004.3800	3.8 mm	
				J5004.4300	4.3 mm	
				J5004.5000	5.0 mm	
	Perno parallelizzatore SCREW-LINE con tacche di profondità **Materiale** Lega di titanio		-	J5300.2028	-	Ø 1.7–2.8 mm/2.0 mm
	Prolunga della fresa Gambo ISO (non per frese con raffreddamento interno) **Materiale** Acciaio inossidabile		-	J5002.0006	-	26.5 mm
	Adattatore per maschiatore per maschiatori SCREW-LINE **Materiale** Acciaio inossidabile		corto	J5322.0010	-	18.0 mm
			lungo	J5322.0011	-	23.0 mm
	Adattatore di rimozione per impianti con applicatore innestato (snap-in) **Materiale** Acciaio inossidabile		-	J5300.0022*	3.3 mm	6.2 mm
					3.8 mm	
					4.3 mm	
					5.0 mm	

* utilizzabile solo con gli impianti CONELOG® PROGRESSIVE-LINE con art. n° C1086.xxx e con gli impianti CONELOG® SCREW-LINE con art. n° C1066.xxxx

	Articolo	Misura	Art. n°	Misura
	Inseritore per impianti a vite, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	extra corto	J5300.0031	13.7 mm
		corto	J5300.0032	19.2 mm
		lungo	J5300.0033	24.8 mm
	Inseritore per impianti a vite, con gambo ISO per contrangolo (senza esagono sul gambo) **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5300.0036	19.1 mm
		lungo	J5300.0037	28.2 mm
	Inseritore per impianti a vite, con gambo ISO per contrangolo, con esagono sul gambo **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5300.0034	19.1 mm
		lungo	J5300.0035	28.2 mm
	Chiave dinamometrica **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5320.1030	-
	Chiave dinamometrica 10–70 Ncm **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5320.1070	-
	Strumento PickUp Supporto per traslare gli impianti **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5300.0030	-
	Adattatore Gambo ISO per contrangolo/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5002.0011	21.0 mm
	Chiave ad anello universale **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5302.0010	-

Strumenti chirurgici generali

	Articolo	Misura	Art. n°	Ø	Misura
	Adattatore CONELOG® per impianti CONELOG® **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	C5302.3311	3.3 mm	28.1 mm
			C5302.4311	3.8 mm	
				4.3 mm	
			C5302.5011	5.0 mm	
		lungo	C5302.3310	3.3 mm	33.1 mm
			C5302.4310	3.8 mm	
				4.3 mm	
	Dima per l'inserimento dell'adattatore nell'impianto a vite **Materiale** Lega di titanio	-	J5302.3300	3.3 mm	-
			J5302.3800	3.8 mm	
			J5302.4300	4.3 mm	
			J5302.5000	5.0 mm	
	**Cacciavite** hex, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	extra corto	J5317.0510	-	14.5 mm
		corto	J5317.0501		22.5 mm
		lungo	J5317.0502		30.3 mm
	Cacciavite hex, gambo ISO **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5317.0504	-	18.0 mm
		lungo	J5317.0503		26.0 mm
	Cacciavite manuale, hex senza attacco per testa a cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5317.0511	-	23.0 mm

	Articolo	Misura	Art. n°	L
	Ago di pulizia per strumenti a raffreddamento interno **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5002.0012	-
	Cannula di pulizia per strumenti a raffreddamento interno **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5002.0020	-

SCREW-LINE
Set per osteotomia

SCREW-LINE Set per osteotomia

diritto convesso

	Articolo	Art. n°	Ø
	Set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE diritto convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5418.0020	-
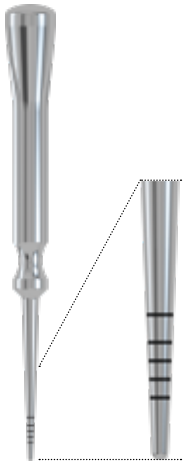	**Pre-osteotomo SCREW-LINE** diritto convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5417.2800*	1.7– 2.8 mm
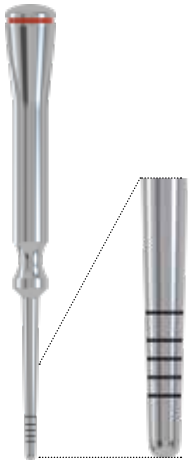	**Osteotomo SCREW-LINE** diritto convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5418.3300*	3.3 mm
		J5418.3800*	3.8 mm
		J5418.4300*	4.3 mm
		J5418.5000*	5.0 mm

* Questi prodotti sono inclusi nel set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE diritto convesso.

SCREW-LINE Set per osteotomia

angolato convesso

	Articolo	Art. n°	Ø
	Set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE angolato convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5418.0030	-
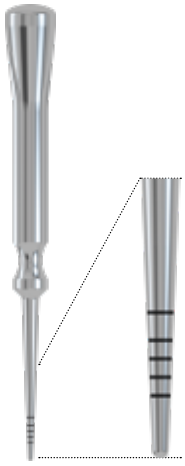	**Pre-osteotomo SCREW-LINE** diritto convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5417.2800*	1.7– 2.8 mm
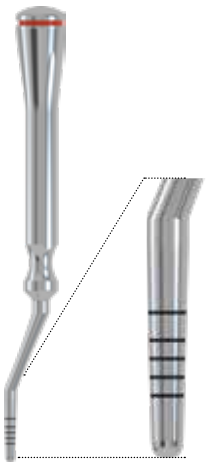	**Osteotomo SCREW-LINE** angolato convesso **Materiale** Acciaio inossidabile	J5418.3310*	3.3 mm
		J5418.3810*	3.8 mm
		J5418.4310*	4.3 mm
		J5418.5010*	5.0 mm

* Questi prodotti sono inclusi nel set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE angolato convesso.

diritto concavo

	Articolo	Art. n°	Ø
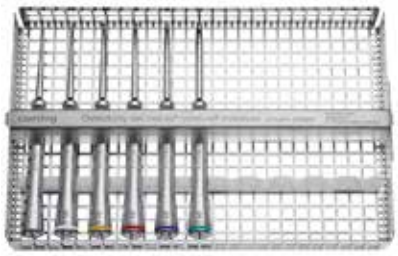	**Set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** diritto concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5420.0020	-
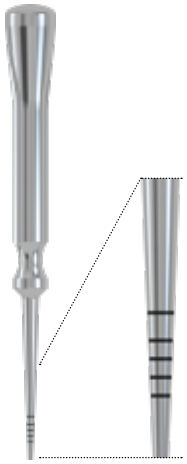	**Pre-osteotomo SCREW-LINE** diritto concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5419.2800*	1.7– 2.8 mm
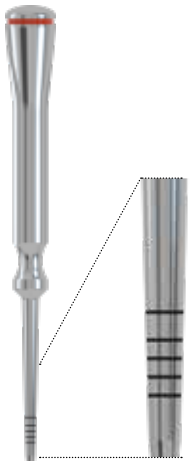	**Osteotomo SCREW-LINE** diritto concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5420.3300*	3.3 mm
		J5420.3800*	3.8 mm
		J5420.4300*	4.3 mm
		J5420.5000*	5.0 mm

* Questi prodotti sono inclusi nel set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE diritto concavo.

SCREW-LINE Set per osteotomia

angolato concavo

	Articolo	Art. n°	Ø
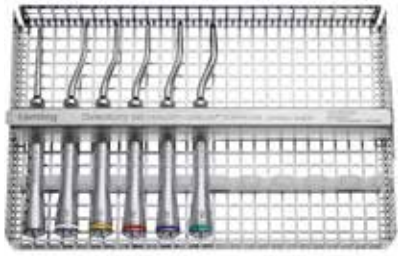	**Set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE** angolato concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5420.0030	-
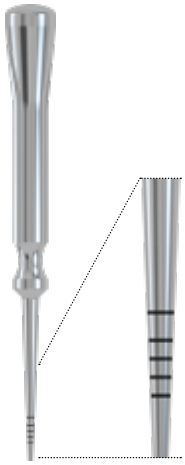	**Pre-osteotomo SCREW-LINE** diritto concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5419.2800*	1.7– 2.8 mm
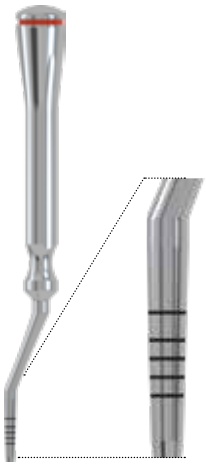	**Osteotomo SCREW-LINE** angolato concavo **Materiale** Acciaio inossidabile	J5420.3310*	3.3 mm
		J5420.3810*	3.8 mm
		J5420.4310*	4.3 mm
		J5420.5010*	5.0 mm

* Questi prodotti sono inclusi nel set per osteotomia CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE angolato concavo.

Viti tappo e cappette di guarigione

Viti tappo

	Articolo	Art. n°	⌀
	Vite tappo per impianto CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2019.3300	3.3 mm
		C2019.3800	3.8 mm
		C2019.4300	4.3 mm
		C2019.5000	5.0 mm

Le viti tappo per impianto sono esclusivamente monouso e non devono essere risterilizzate.

Cappette di guarigione

	Articolo	Art. n°	⌀	AG	G ⌀
	Cappetta di guarigione CONELOG®, cilindrica sterile **Materiale** Lega di titanio	C2015.3320	3.3 mm	2.0 mm	3.3 mm
		C2015.3340		4.0 mm	3.3 mm
		C2015.3360		6.0 mm	3.3 mm
		C2015.3820	3.8 mm	2.0 mm	3.8 mm
		C2015.3840		4.0 mm	3.8 mm
		C2015.3860*		6.0 mm	3.8 mm
		C2015.4320	4.3 mm	2.0 mm	4.0 mm
		C2015.4340		4.0 mm	4.0 mm
		C2015.4360*		6.0 mm	4.0 mm
		C2015.5020	5.0 mm	2.0 mm	4.7 mm
		C2015.5040		4.0 mm	4.7 mm
		C2015.5060*		6.0 mm	4.7 mm
	**Cappetta di guarigione CONELOG®, wide body** sterile **Materiale** Lega di titanio	C2014.3340	3.3 mm	4.0 mm	4.8 mm
		C2014.3360		6.0 mm	4.8 mm
		C2014.3840	3.8 mm	4.0 mm	5.3 mm
		C2014.3860		6.0 mm	5.3 mm
		C2014.4340	4.3 mm	4.0 mm	5.8 mm
		C2014.4360		6.0 mm	5.8 mm
		C2014.5040	5.0 mm	4.0 mm	6.5 mm
		C2014.5060		6.0 mm	6.5 mm
	Cappetta di guarigione CONELOG®, bottleneck sterile **Materiale** Lega di titanio	C2011.3340	3.3 mm	4.0 mm	3.3 mm
		C2011.3840	3.8 mm	4.0 mm	3.8 mm
		C2011.3860		6.0 mm	3.8 mm
		C2011.4340	4.3 mm	4.0 mm	4.0 mm
		C2011.4360		6.0 mm	4.0 mm
		C2011.5040	5.0 mm	4.0 mm	4.7 mm
		C2011.5060		6.0 mm	4.7 mm

* adatta per la registrazione del morso

Le cappette di guarigione sono esclusivamente monouso e non devono essere risterilizzate.

Tramite il nostro partner di servizio CAD/CAM DEDICAM® è possibile ricevere cappette di guarigione personalizzate.
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

Tecnica protesica

Scanbody

	Articolo	Art. n°	Ø
	Scanbody CONELOG®* incl. vite per abutment CONELOG®, sterile **Materiale** PEEK	C2600.3310	3.3 mm
		C2600.4310	3.8 mm
			4.3 mm
		C2600.5010	5.0 mm
	Scanbody CONELOG® multiuso* incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2630.3300	3.3 mm
		C2630.4300	3.8 mm
			4.3 mm
		C2630.5000	5.0 mm
	ScanPost CONELOG® per Sirona® incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2620.3306	3.3 mm
		C2620.3806	3.8 mm
		C2620.4306	4.3 mm
		C2620.5006	5.0 mm

* Verificare che lo scanbody CONELOG® sia disponibile nel software CAD utilizzato.
Le librerie CAD per componenti protesici CONELOG® selezionati possono essere scaricate gratuitamente qui:
www.biohorizonscamlog.com/cad-libraries
Svizzera: www.camlog.ch/cad-bibliotheken

Scanbody Sirona® misura S adatti per lo ScanPost CONELOG® e la base in titanio CAD/CAM CONELOG® per corona con Ø 3.3/3.8/4.3 mm:
Numero d'ordine 6431311

Scanbody Sirona® misura L adatti per lo ScanPost CONELOG® e la base in titanio CAD/CAM CONELOG® per corona con Ø 5.0 mm:
Numero d'ordine 6431329

Gli scanbody Sirona® possono essere richiesti a Dentsply Sirona o a rivenditori specializzati di prodotti dentali.

Presa d’impronta

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
Nuovo	**Transfer da impronta CONELOG®, cilindrico, porta-impronte forato** incl. vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio	1	C2125.3300	3.3 mm
			C2125.3800	3.8 mm
			C2125.4300	4.3 mm
			C2125.5000	5.0 mm
Nuovo 	**Transfer da impronta CONELOG®, cilindrico, porta-impronte chiuso** incl. ausilio di riposizionamento, cappetta per la registrazione del morso e vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio/PBT	1	C2115.3300	3.3 mm
			C2115.3800	3.8 mm
			C2115.4300	4.3 mm
			C2115.5000	5.0 mm
Nuovo 	**Transfer da impronta CONELOG®, wide body, porta-impronte forato** incl. vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio	1	C2124.3300	3.3 mm
			C2124.3800	3.8 mm
			C2124.4300	4.3 mm
			C2124.5000	5.0 mm
Nuovo 	**Transfer da impronta CONELOG®, wide body, porta-impronte chiuso** incl. ausilio di riposizionamento, cappetta per la registrazione del morso e vite di ritenzione, sterile **Materiale** Lega di titanio/PBT	1	C2114.3300	3.3 mm
			C2114.3800	3.8 mm
			C2114.4300	4.3 mm
			C2114.5000	5.0 mm
Nuovo	**Ausilio di riposizionamento** per transfer da impronta, porta-impronte chiuso, sterile **Materiale** PBT	6	J2111.3310	3.3 mm
			J2111.3810	3.8 mm
			J2111.4310	4.3 mm
			J2111.5010	5.0 mm

Tramite il nostro partner di servizio CAD/CAM DEDICAM® è possibile ricevere transfer da impronta personalizzati, formalmente congruenti con cappette di guarigione personalizzate.
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/Camlog locale.

Registrazione del morso

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
Nuovo	**Transfer per la registrazione del morso CONELOG®** incl. vite di ritenzione e cappetta per la registrazione del morso, sterile **Materiale** Lega di titanio/PBT	1	C2141.3300	3.3 mm
			C2141.3800	3.8 mm
			C2141.4300	4.3 mm
			C2141.5000	5.0 mm
Nuovo	**Cappetta per la registrazione del morso** sterile **Materiale** PBT	6	J2112.3310	3.3 mm
			J2112.3810	3.8 mm
			J2112.4310	4.3 mm
			J2112.5010	5.0 mm

Realizzazione del modello

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	Analogo da laboratorio CONELOG® per modelli colati **Materiale** Lega di titanio	1	C3010.3300	3.3 mm
			C3010.3800	3.8 mm
			C3010.4300	4.3 mm
			C3010.5000	5.0 mm
		3	C3010.3303	3.3 mm
			C3010.3803	3.8 mm
			C3010.4303	4.3 mm
			C3010.5003	5.0 mm
	Analogo d'impianto CONELOG® per modelli stampati e colati **Materiale** Lega di titanio	1	C3025.3300	3.3 mm
			C3025.3800	3.8 mm
			C3025.4300	4.3 mm
			C3025.5000	5.0 mm
		3	C3025.3303	3.3 mm
			C3025.3803	3.8 mm
			C3025.4303	4.3 mm
			C3025.5003	5.0 mm

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	Strumento manuale per analogo d'impianto **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J3025.0010	3.3 mm
				3.8 mm
				4.3 mm
			J3025.0015	5.0 mm
				6.0 mm
	DIM-Analog® per il sistema implantare CONELOG® per modelli stampati, incl. vite a testa zigrinata **Materiale** Lega di titanio/Acciaio inossidabile	1	COL 5.DIM.330	3.3 mm
			COL 5.DIM.384	3.8 mm
				4.3 mm
			COL 5.DIM.500	5.0 mm

Fabbricante DIM-Analog®: NT-Trading GmbH & Co. KG | G.-Braun-Straße 18 | 76187 Karlsruhe | Germania
DIM-Analog® è un marchio registrato dell'azienda NT-Trading GmbH & Co. KG.

Abutment provvisori

	Articolo	Art. n°	Ø
	Abutment provvisorio CONELOG®, per corona incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2239.3300*	3.3 mm
		C2239.3800	3.8 mm
		C2239.4300	4.3 mm
		C2239.5000	5.0 mm
	Abutment provvisorio CONELOG®, per ponte incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2339.3300	3.3 mm
		C2339.3800	3.8 mm
		C2339.4300	4.3 mm
		C2339.5000	5.0 mm

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori

Le viti per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

Basi in titanio CAD/CAM

	Articolo	Art. n°	Ø	AG
	Base in titanio CAD/CAM CONELOG®, corona incl. vite per abutment CONELOG® anodizzata viola scuro e ausilio per incollaggio CONELOG® (POM) **Materiale** Lega di titanio/POM	C2242.3308*	3.3 mm	0.8 mm
		C2242.3808	3.8 mm	
		C2242.4308	4.3 mm	
		C2242.5008	5.0 mm	
		C2242.3320*	3.3 mm	2.0 mm
		C2242.3820	3.8 mm	
		C2242.4320	4.3 mm	
		C2242.5020	5.0 mm	
	Base in titanio CAD/CAM CONELOG®, ponte incl. vite per abutment CONELOG® anodizzata viola scuro e ausilio per incollaggio CONELOG® (POM) **Materiale** Lega di titanio/POM	C2342.3308	3.3 mm	0.8 mm
		C2342.3808	3.8 mm	
		C2342.4308	4.3 mm	
		C2342.5008	5.0 mm	
		C2342.3320	3.3 mm	2.0 mm
		C2342.3820	3.8 mm	
		C2342.4320	4.3 mm	
		C2342.5020	5.0 mm	

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori

Le viti per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

Sono disponibili le geometrie delle basi in titanio CAD/CAM CONELOG® per i principali sistemi dentali CAD sotto forma di libreria CAD.
Le librerie possono essere scaricate gratuitamente qui:
www.biohorizonscamlog.com/cad-libraries
Svizzera: www.camlog.ch/cad-bibliotheken

Componenti protesici CAD/CAM DEDICAM® di Camlog
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/ Camlog locale.

	Articolo	Art. n°	Ø	Filettatura
	Ausilio per modellazione CONELOG® per base in titanio CAD/CAM CONELOG®, per corona calcinabile **Materiale** POM	C2242.3302	3.3 mm	-
		C2242.3802	3.8 mm	
		C2242.4302	4.3 mm	
		C2242.5002	5.0 mm	
	Ausilio per incollaggio CONELOG®/iSy® 2 unità **Materiale** POM	C4019.1600	3.3 mm	M1.6
			3.8 mm	
			4.3 mm	
	Ausilio per incollaggio CONELOG® 2 unità **Materiale** POM	C4019.2000	5.0 mm	M2.0
			6.0 mm	
	Vite per abutment CONELOG® per base in titanio CAD/CAM CONELOG® hex, anodizzata viola scuro **Materiale** Lega di titanio	C4015.1601	3.3 mm	M1.6
			3.8 mm	
			4.3 mm	
		C4015.2001	5.0 mm	M2.0
	Vite da laboratorio CONELOG® per base in titanio CAD/CAM CONELOG® hex, parzialmente anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	C4016.1601	3.3 mm	M1.6
			3.8 mm	
			4.3 mm	
		C4016.2001	5.0 mm	M2.0

Basi in titanio CAD/CAM free

	Articolo	Misura	Art. n°	Ø	AG
	Base in titanio CONELOG® CAD/CAM free, per corona incl. vite per abutment e vite da laboratorio **Materiale** Lega di titanio	corto	C2247.3308*	3.3 mm	0.8
			C2247.3808	3.8 mm	1.0
			C2247.4308	4.3 mm	
			C2247.5008	5.0 mm	
			C2247.3320*	3.3 mm	2.0
			C2247.3820	3.8 mm	
			C2247.4320	4.3 mm	
			C2247.5020	5.0 mm	
	Base in titanio CONELOG® CAD/CAM free, per corona incl. vite per abutment e vite da laboratorio **Materiale** Lega di titanio	lungo	C2265.3808	3.8 mm	1.0
			C2265.4308	4.3 mm	
			C2265.5008	5.0 mm	
			C2265.3820	3.8 mm	2.0
			C2265.4320	4.3 mm	
			C2265.5020	5.0 mm	

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori

Per serrare la vite per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) si utilizzano i cacciaviti Ballpoint (in caso di canale della vite angolato) e i cacciaviti, hex (in caso di canale della vite diritto) (vedere pagina 86).

Sono disponibili le geometrie delle basi in titanio CAD/CAM CONELOG® per i principali sistemi dentali CAD sotto forma di libreria CAD.
Le librerie possono essere scaricate gratuitamente qui:
www.biohorizonscamlog.com/cad-libraries
Svizzera: www.camlog.ch/cad-bibliotheken

Componenti protesici CAD/CAM DEDICAM® di Camlog
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/ Camlog locale.

CAM Blank

Tipo AG

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
Nuovo	**CONELOG® CAM Blank in titanio, tipo AG** per il sistema CAD/CAM Ceramill® di Amann Girrbach, Ø 12 mm; spedizione comprensiva di 2 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	2	C2471.3327*	3.3 mm
			C2471.3827	3.8 mm
			C2471.4327	4.3 mm
			C2471.5027	5.0 mm

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori (Ø 3.3 mm non per ricostruzioni a doppia corona)

I monconi in titanio CAM, tipo AG, sono stati sviluppati congiuntamente da CAMLOG Biotechnologies GmbH e da Amann Girrbach AG. Sono provvisti della geometria di connessione brevettata di Amann Girrbach® per l'alloggiamento del moncone e sono compatibili con il sistema CAD/CAM Ceramill®.
Le corrispondenti librerie CAD possono essere scaricate sia dal biohorizonscamlog.com/cad-libraries che dal portale AG.live di Amann Girrbach® oppure sono disponibili tramite il Software-Manager di Amann Girrbach stessa.

Tipo ME

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	CONELOG® CAM Blank in titanio, tipo ME Ø 12 mm, lunghezza 20 mm; spedizione comprensiva di 2 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	2	C2441.3320*	3.3 mm
			C2441.3820	3.8 mm
			C2441.4320	4.3 mm
			C2441.5020	5.0 mm
	CONELOG® CAM Blank in titanio, tipo ME Ø 12 mm, lunghezza 20 mm; spedizione comprensiva di 10 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	10	C2442.3320*	3.3 mm
			C2442.3820	3.8 mm
			C2442.4320	4.3 mm
			C2442.5020	5.0 mm
	CONELOG® CAM Blank in CoCr, tipo ME Ø 12 mm, lunghezza 20 mm; spedizione comprensiva di 2 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di cobalto-cromo	2	C2461.3320*	3.3 mm
			C2461.4320	3.8 mm
				4.3 mm
			C2461.5020	5.0 mm

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori (Ø 3.3 mm non per ricostruzioni a doppia corona)

Per la lavorazione tecnica di fresaggio si fissa il moncone CAM tipo ME a una sezione cilindrica opposta alla connessione impianto-abutment. Come dispositivi di serraggio specifici della macchina possono essere impiegati gli appositi supporti per abutment PreFace® di Medentika®. Questi supporti sono disponibili per macchine selezionate dei rispettivi fabbricanti. I monconi necessitano di librerie CAM specifiche del prodotto.
Per domande sulla compatibilità rivolgersi al Servizio Tecnico di DEDICAM® all'indirizzo di posta elettronica dedicam.cad@camlog.com.

Medentika® e PreFace® sono marchi registrati di Medentika GmbH, D-Hügelsheim.

CAM Blank

Tipo IAC

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	CONELOG® CAM Blank in titanio, tipo IAC Ø 12 mm, lunghezza 12.5 mm; spedizione comprensiva di 2 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	2	C2431.3313*	3.3 mm
			C2431.3813	3.8 mm
			C2431.4313	4.3 mm
			C2431.5013	5.0 mm
	CONELOG® CAM Blank in titanio, tipo IAC Ø 12 mm, lunghezza 12.5 mm; spedizione comprensiva di 10 viti per abutment confezionate separatamente **Materiale** Lega di titanio	10	C2432.3313*	3.3 mm
			C2432.3813	3.8 mm
			C2432.4313	4.3 mm
			C2432.5013	5.0 mm
	Alloggiamento CONELOG® per CAM Blank in titanio, tipo IAC Ø 6 mm, lunghezza 17 mm, iinclude 2 viti di fissaggio CONELOG® per CAM Blank titanio, tipo IAC **Materiale** Acciaio inossidabile	1	C3720.3300	3.3 mm
			C3720.4300	3.8 mm
				4.3 mm
			C3720.5000	5.0 mm

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori (Ø 3.3 mm non per ricostruzioni a doppia corona)

Per la lavorazione tecnica di fresaggio si fissa il moncone in titanio CAM tipo IAC alla connessione impianto-abutment tramite l'alloggiamento CONELOG® per monconi CAM. Il supporto e/o l'adattatore specifico della macchina per l'alloggiamento, nonché le tecniche di fresaggio devono essere predisposti dall'utilizzatore.

Sono disponibili le geometrie dei monconi CAM CONELOG® per i principali sistemi dentali CAD sotto forma di libreria CAD.
Le librerie possono essere scaricate gratuitamente qui:
www.biohorizonscamlog.com/cad-libraries
Svizzera: www.camlog.ch/cad-bibliotheken

Le viti per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

Abutment Esthomic®

	Articolo	Art. n°	Ø	AG
	Abutment CONELOG® Esthomic®, diritti incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2226.3815	3.8 mm	1.5–2.5 mm
		C2226.3830		3.0–4.5 mm
		C2226.4315	4.3 mm	1.5–2.5 mm
		C2226.4330		3.0–4.5 mm
		C2226.5015	5.0 mm	1.5–2.5 mm
		C2226.5030		3.0–4.5 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, Inset incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2235.3320*	3.3 mm	2.0–3.3 mm
		C2235.3820	3.8 mm	
		C2235.4320	4.3 mm	
		C2235.5020	5.0 mm	

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori

Le viti per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

Abutment Esthomic®

	Articolo	Art. n°	Ø	AG
	Abutment CONELOG® Esthomic®, angolati a 15°, tipo A incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2227.3815	3.8 mm	1.5–2.5 mm
		C2227.3830		3.0–4.5 mm
		C2227.4315	4.3 mm	1.5–2.5 mm
		C2227.4330		3.0–4.5 mm
		C2227.5015	5.0 mm	1.5–2.5 mm
		C2227.5030		3.0–4.5 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, angolati a 15°, tipo B incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2228.3815	3.8 mm	1.5–2.5 mm
		C2228.3830		3.0–4.5 mm
		C2228.4315	4.3 mm	1.5–2.5 mm
		C2228.4330		3.0–4.5 mm
		C2228.5015	5.0 mm	1.5–2.5 mm
		C2228.5030		3.0–4.5 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, angolati a 20°, tipo A incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2231.3815	3.8 mm	1.5–2.5 mm
		C2231.3830		3.0–4.5 mm
		C2231.4315	4.3 mm	1.5–2.5 mm
		C2231.4330		3.0–4.5 mm
		C2231.5015	5.0 mm	1.5–2.5 mm
		C2231.5030		3.0–4.5 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, angolati a 20°, tipo B incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2232.3815	3.8 mm	1.5–2.5 mm
		C2232.3830		3.0–4.5 mm
		C2232.4315	4.3 mm	1.5–2.5 mm
		C2232.4330		3.0–4.5 mm
		C2232.5015	5.0 mm	1.5–2.5 mm
		C2232.5030		3.0–4.5 mm

Abutment universali

	Articolo	Art. n°	Ø	Misura
	Abutment universale CONELOG® incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2211.3300*	3.3 mm	-
		C2211.3800	3.8 mm	
		C2211.4300	4.3 mm	
		C2211.5000	5.0 mm	

Abutment in oro-resina

	Articolo	Art. n°	Ø	Peso del metallo prezioso
	Abutment in oro-resina CONELOG® da sovrafusione, incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega aurea per la tecnica di sovrafusione/POM	C2246.3300*	3.3 mm	circa 0.31 g
		C2246.3800	3.8 mm	circa 0.36 g
		C2246.4300	4.3 mm	circa 0.36 g
		C2246.5000	5.0 mm	circa 0.55 g

* solo per ricostruzioni a corona nella regione degli incisivi laterali superiori e degli incisivi laterali e centrali inferiori (Ø 3.3 mm non per ricostruzioni a doppia corona)

Le viti per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

COMFOUR®

	Articolo	Art. n°	Tipo	Ø	AG	Ø PP
	Pilastri a barra CONELOG®, diritti sterile **Materiale** Lega di titanio	C2254.3310	-	3.3 mm	1.0 mm	4.3 mm
		C2254.3325			2.5 mm	
		C2254.3810		3.8 mm	1.0 mm	
		C2254.3825			2.5 mm	
		C2254.3840			4.0 mm	
		C2254.4310		4.3 mm	1.0 mm	
		C2254.4325			2.5 mm	
		C2254.4340			4.0 mm	
		C2254.5010		5.0 mm	1.0 mm	6.0 mm
		C2254.5025			2.5 mm	
		C2254.5040			4.0 mm	
	Pilastri a barra CONELOG®, angolati a 17° incl. vite per abutment CONELOG® anodizzata azzurro, con testa ridotta, hex, sterile **Materiale** Lega di titanio	C2256.3325	A	3.3 mm	2.5 mm	4.3 mm
		C2256.3340			4.0 mm	
		C2257.3325	B		2.5 mm	
		C2257.3340			4.0 mm	
		C2256.3825	A	3.8 mm	2.5 mm	
		C2256.3840			4.0 mm	
		C2257.3825	B		2.5 mm	
		C2257.3840			4.0 mm	
		C2256.4325	A	4.3 mm	2.5 mm	
		C2256.4340			4.0 mm	
		C2257.4325	B		2.5 mm	
		C2257.4340			4.0 mm	
		C2256.5025	A	5.0 mm	2.5 mm	6.0 mm
		C2256.5040			4.0 mm	
		C2257.5025	B		2.5 mm	
		C2257.5040			4.0 mm	
	Pilastri a barra CONELOG®, angolati a 30° incl. vite per abutment CONELOG® anodizzata azzurro, con testa ridotta, hex, sterile **Materiale** Lega di titanio	C2258.3325	A	3.3 mm	2.5 mm	4.3 mm
		C2258.3340			4.0 mm	
		C2259.3325	B		2.5 mm	
		C2259.3340			4.0 mm	
		C2258.3825	A	3.8 mm	2.5 mm	
		C2258.3840			4.0 mm	
		C2259.3825	B		2.5 mm	
		C2259.3840			4.0 mm	
		C2258.4325	A	4.3 mm	2.5 mm	
		C2258.4340			4.0 mm	
		C2259.4325	B		2.5 mm	
		C2259.4340			4.0 mm	
		C2258.5035	A	5.0 mm	3.5 mm	6.0 mm
		C2258.5050			5.0 mm	
		C2259.5035	B		3.5 mm	
		C2259.5050			5.0 mm	

Tipo A e B, vedere pagina 8

Per serrare la vite per abutment CONELOG® con testa ridotta, hex, si utilizzano i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

	Articolo	Misura	Art. n°	Ø	Dimensioni
	**Inseritore per pilastri a barra diritti** **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5300.0020	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	18.6 mm
			J5300.0025	5.0 mm	
		lungo	J5300.0021	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	28.0 mm
	Dima per orientamento COMFOUR® per foro pilota Ø 2.0 mm **Materiale** Nitinol	-	J3551.0001	-	-
	Ausilio di orientamento per pilastri a barra angolati, per applicatori **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J2269.0005	-	17°
			J2269.0006	-	30°
	Indicatore di altezza gengivale, diritto **Materiale** Lega di titanio	-	J3550.3300	3.3 mm	-
			J3550.3800	3.8 mm	
			J3550.4300	4.3 mm	
			J3550.5000	5.0 mm	
	Cappetta di guarigione per pilastro a barra parzialmente anodizzata azzurro, sterile **Materiale** Lega di titanio	-	J2029.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
			J2029.6000	5.0 mm / 6.0 mm	
	Cappetta per presa d'impronta per pilastro a barra, porta-impronte chiuso (ponte) parzialmente anodizzata azzurro, sterile **Materiale** Lega di titanio	corta	J2129.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	6.5 mm
			J2129.6000	5.0 mm / 6.0 mm	7.0 mm
		lunga	J2129.4310	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	11.0 mm
			J2129.6010	5.0 mm / 6.0 mm	
	Inseritore per transfer da impronta e cappette di guarigione per pilastri a barra **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5300.0027	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	19.1 mm
			J5300.0028	5.0 mm / 6.0 mm	
	Analogo da laboratorio per barra per pilastri a barra, per modelli colati **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J3020.4300	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm	-
			J3020.6000	5.0 mm / 6.0 mm	

COMFOUR®

	Articolo	Art. n°	Ø			Dimensioni
	Analogo d'impianto per barra per pilastri a barra, per modelli stampati e colati **Materiale** Acciaio inossidabile	J3025.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J3025.6000	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta di scansione per pilastri a barra incl. vite protesica anodizzata azzurro, sterile **Materiale** PEEK	J2610.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2610.6000	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta di scansione per pilastri a barra CAMLOG®/CONELOG® incl. vite protesica anodizzata azzurro, multiuso **Materiale** Lega di titanio	J2630.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2630.6000	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta in titanio per pilastro a barra, per corona incl. vite protesica anodizzata azzurro, sterile **Materiale** Lega di titanio	J2259.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2259.6001	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta in titanio per pilastro a barra, per ponte incl. vite protesica anodizzata azzurro, sterile **Materiale** Lega di titanio	J2259.4302	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2259.6002	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta in titanio senza ritenzione per pilastro a barra, per ponte incl. vite protesica anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	J2259.4322	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2259.6022	5.0 mm	6.0 mm		
	Base per corona per pilastro a barra calcinabile **Materiale** POM	J2256.4306	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2256.6006	5.0 mm	6.0 mm		
	Base per pilastro a barra calcinabile **Materiale** POM	J2257.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2257.6001	5.0 mm	6.0 mm		
	Base per pilastro a barra da sovrafusione **Materiale** Lega aurea per la tecnica di sovrafusione/POM	J2263.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	circa 0.48 g
		J2263.6000	5.0 mm	6.0 mm		circa 0.70 g
	Base per pilastro a barra brasabile **Materiale** Lega aurea brasabile	J2258.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2258.6000	5.0 mm	6.0 mm		

	Articolo	Art. n°	Ø			Dimensioni
	Base per pilastro a barra, titanio saldabile al laser **Materiale** Titanio grado 4	J2262.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2262.6000	5.0 mm	6.0 mm		
	Base adesiva in titanio per pilastro a barra Passive-Fit **Materiale** Lega di titanio	J2260.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2260.6001	5.0 mm	6.0 mm		
	Cappetta per base adesiva in titanio calcinabile, Passive-Fit, incl. vite protesica per pilastro a barra, hex (solo per la realizzazione della struttura colata in combinazione con cappette per base adesiva in titanio Passive-Fit) **Materiale** POM	J2261.4301	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	-
		J2261.6001	5.0 mm	6.0 mm		
	Protettivo per lucidare cappette e basi per pilastro a barra **Materiale** Lega di titanio	J3021.4300	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		J3021.6000	5.0 mm	6.0 mm		M2.0
	Vite per abutment CONELOG® con testa ridotta, hex, anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	C4004.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		C4004.2001	5.0 mm			M2.0
	Vite da laboratorio CONELOG® con testa ridotta, hex, parzialmente anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	C4004.1600	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		C4004.2000	5.0 mm			M2.0
	Vite protesica per pilastro a barra hex, anodizzata azzurro (per il fissaggio definitivo della ricostruzione) **Materiale** Lega di titanio	J4012.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		J4012.2001	5.0 mm	6.0 mm		M2.0
	Vite protesica da laboratorio per pilastro a barra, hex, anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	J4013.1601	3.3 mm	3.8 mm	4.3 mm	M1.6
		J4013.2001	5.0 mm	6.0 mm		M2.0

Le viti da laboratorio non devono essere utilizzate sul paziente!

Le viti per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) e le viti protesiche per pilastri a barra (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

COMFOUR®

	Articolo	Art. n°	Lunghezza	Filettatura
	**Vite, hex** per pilastro a barra, anodizzata azzurro, sterile **Materiale** Lega di titanio	J4012.1610	10 mm	M1.6
		J4012.2010		M2.0
		J4012.1615	15 mm	M1.6
		J4012.2015		M2.0
		J4012.1620	20 mm	M1.6
		J4012.2020		M2.0
	Vite in PEEK, per pilastro a barra hex, lunghezza 27 mm, sterile **Materiale** PEEK	J4009.1627	-	M1.6
		J4009.2027		M2.0

Pilastro a sfera

	Articolo	Art. n°	Ø	AG	L
	Pilastro a sfera CONELOG®, patrice incl. anello di stabilizzazione **Materiale** Lega di titanio/Resina	C2249.3315	3.3 mm	1.5 mm	-
		C2249.3330		3.0 mm	
		C2249.3815	3.8 mm	1.5 mm	
		C2249.3830		3.0 mm	
		C2249.3845		4.5 mm	
		C2249.4315	4.3 mm	1.5 mm	
		C2249.4330		3.0 mm	
		C2249.4345		4.5 mm	
		C2249.5015	5.0 mm	1.5 mm	
		C2249.5030		3.0 mm	
		C2249.5045		4.5 mm	
	Inseritore per pilastro a sfera, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	J5300.0011	-	-	18.3 mm
	Matrice CM Dalbo®-Plus per pilastro a sfera, incl. inserto di ritenzione lamellare e ausilio di duplicazione **Materiale** Titanio grado 4 / Lega aurea	05003503	3.3 mm	-	-
			3.8 mm		
			4.3 mm		
			5.0 mm		
	Inserto di ritenzione lamellare per matrice CM Dalbo®-Plus **Materiale** Lega aurea	05003504	3.3 mm	-	-
			3.8 mm		
			4.3 mm		
			5.0 mm		
	Analogo del pilastro a sfera incl. anello di stabilizzazione **Materiale** Lega di titanio/Resina	C3015.3300	3.3 mm	-	-
			3.8 mm		
			4.3 mm		
		C3015.5000	5.0 mm		

Dalbo®-Plus è un marchio registrato della società Cendres + Métaux SA, Biel, Svizzera.

Locator®

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø	AG	L
	Pilastro CONELOG® Locator® **Materiale** Lega di titanio/TiN	1	C2253.3310	3.3 mm	1.0 mm	-
			C2253.3320		2.0 mm	
			C2253.3330		3.0 mm	
			C2253.3340		4.0 mm	
			C2253.3810	3.8 mm	1.0 mm	
			C2253.3820		2.0 mm	
			C2253.3830		3.0 mm	
			C2253.3840		4.0 mm	
			C2253.3850		5.0 mm	
			C2253.4310	4.3 mm	1.0 mm	
			C2253.4320		2.0 mm	
			C2253.4330		3.0 mm	
			C2253.4340		4.0 mm	
			C2253.4350		5.0 mm	
			C2253.5010	5.0 mm	1.0 mm	
			C2253.5020		2.0 mm	
			C2253.5030		3.0 mm	
			C2253.5040		4.0 mm	
			C2253.5050		5.0 mm	
	Inseritore per pilastri Locator® manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0001	-	-	24.3 mm
	Strumento Locator® in 3 parti **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0002	-	-	83.0 mm
	Cappetta per presa d'impronta Locator® **Materiale** Alluminio/Polietilene	4	J2253.0200	-	-	-
	Analogo Locator® **Materiale** Alluminio	4	J2253.0340	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm 5.0 mm	-	-
	Anello di bloccaggio Locator® **Materiale** Teflon	20	J2253.0401	-	-	-
	Inserto di lavorazione Locator® **Materiale** Polietilene	4	J2253.0402	-	-	-

	Articolo	Quantità	Colore	Ritenzione	Divergenza	Art. n°
	**Set da laboratorio Locator®** **Contenuto del set:** 1 alloggiamento di ritenzione con inserto di lavorazione, 1 anello di bloccaggio bianco, 1 inserto di ritenzione trasparente, 1 inserto di ritenzione rosa, 1 inserto di ritenzione blu **Materiale** Lega di titanio/Polietilene/Teflon/ Nylon	2	-	-	-	J2253.0102
	Set da laboratorio Locator® per angolazione estesa **Contenuto del set:** 1 alloggiamento di ritenzione con inserto di lavorazione, 1 anello di bloccaggio bianco, 1 inserto di ritenzione verde, 1 inserto di ritenzione arancio, 1 inserto di ritenzione rosso **Materiale** Lega di titanio/Polietilene/Teflon/ Nylon	2	-	-	-	J2253.0112
	Inserto di ritenzione Locator® **Materiale** Nylon	4	tra-sparente	forte	0°–10°	J2253.1005
		4	rosa	medio	0°–10°	J2253.1003
		4	blu	leggero	0°–10°	J2253.1002
	Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa **Materiale** Nylon	4	verde	forte	10°–20°	J2253.2004*
		4	arancio	medio	10°–20°	J2253.2003*
		4	rosso	leggero	10°–20°	J2253.2002*
		4	grigio	nessuna	0°–20°	J2253.2000*

* non ammesso per Ø impianto di 3.3 mm

Fabbricante Locator®: Zest Anchors | 2875 Loker Avenue East, Carlsbad | California 92010 | USA
Locator® e Locator R-Tx® sono marchi registrati di Zest Anchors.

Locator R-Tx®

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø	AG
	Pilastro CONELOG® Locator R-Tx® incl. alloggiamento di ritenzione con inserto di lavorazione nero, anello di bloccaggio bianco e quattro diversi inserti di ritenzione **Materiale** Lega di titanio/Nylon	1	30805-01	3.3 mm	1.0 mm
			30805-02		2.0 mm
			30805-03		3.0 mm
			30805-04		4.0 mm
			30806-01	3.8 mm	1.0 mm
			30806-02		2.0 mm
			30806-03		3.0 mm
			30806-04		4.0 mm
			30806-05		5.0 mm
			30807-01	4.3 mm	1.0 mm
			30807-02		2.0 mm
			30807-03		3.0 mm
			30807-04		4.0 mm
			30807-05		5.0 mm
			30808-01	5.0 mm	1.0 mm
			30808-02		2.0 mm
			30808-03		3.0 mm
			30808-04		4.0 mm
			30808-05		5.0 mm
	Strumento per inserto di ritenzione Locator R-Tx® con maniglia in plastica **Materiale** Acciaio inossidabile	1	30021-01	-	-
	Cappetta per presa d'impronta Locator R-Tx® **Materiale** Polietilene	4	30017-01	-	-
	Analogo Locator R-Tx® **Materiale** Alluminio	4	30014-01	3.3 mm	-
				3.8 mm	
				4.3 mm	
			30016-01	5.0 mm	-

I pilastri CONELOG® Locator R-Tx® vengono serrati con i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

	Articolo	Quantità	Colore	Ritenzione	Art. n°
	Alloggiamento di ritenzione Locator R-Tx® con inserto di lavorazione **Materiale** Lega di titanio/Polietilene	4	nero	-	30013-01
	Anello di bloccaggio Locator® **Materiale** Teflon	20	bianco	-	J2253.0401
	Inserto di lavorazione Locator R-Tx® **Materiale** Polietilene	4	nero	-	30012-01
	Distanziale da laboratorio/ ausilio di duplicazione Locator R-Tx® **Materiale** Polietilene	4	-	-	30018-01
	Inserto di ritenzione Locator R-Tx® **Materiale** Nylon	4	grigio	nessuna	30001-01
		4	blu	leggero	30002-01
		4	rosa	medio	30003-01
		4	bianco	forte	30004-01

Ricostruzione a doppia corona

	Articolo	Art. n°	Ø
	Abutment universale CONELOG® per la tecnica a doppia corona incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2211.3800	3.8 mm
		C2211.4300	4.3 mm
		C2211.5000	5.0 mm
	Abutment telescopico CONELOG® per la tecnica a doppia corona incl. vite per abutment CONELOG® **Materiale** Lega di titanio	C2212.3800	3.8 mm
		C2212.4300	4.3 mm
		C2212.5000	5.0 mm

Le viti per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) vengono serrate con i cacciaviti, hex (vedere pagina 86).

Viti per abutment e da laboratorio

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø	Filettatura
	Vite per abutment CONELOG®, hex **Materiale** Lega di titanio	1	C4005.1601	3.3 mm	M1.6
				3.8 mm	
				4.3 mm	
			C4005.2001	5.0 mm	M2.0
	Vite da laboratorio CONELOG®, hex anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	1	C4006.1601	3.3 mm	M1.6
				3.8 mm	
				4.3 mm	
			C4006.2001	5.0 mm	M2.0
		3	C4006.1603	3.3 mm	M1.6
				3.8 mm	
				4.3 mm	
			C4006.2003	5.0 mm	M2.0

	Articolo	Art. n°	Ø	Filettatura
	Vite per abutment CONELOG® con testa ridotta, hex, anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	C4004.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
		C4004.2001	5.0 mm	M2.0
	Vite da laboratorio CONELOG® con testa ridotta, hex, parzialmente anodizzata azzurro **Materiale** Lega di titanio	C4004.1600	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
		C4004.2000	5.0 mm	M2.0
	Vite per abutment CONELOG® **per base in titanio CAD/CAM** hex, anodizzata viola scuro **Materiale** Lega di titanio	C4015.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
		C4015.2001	5.0 mm	M2.0
	Vite da laboratorio CONELOG® **per base in titanio CAD/CAM CONELOG®** hex, parzialmente anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	C4016.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
		C4016.2001	5.0 mm	M2.0
	Vite protesica per pilastro a barra hex, anodizzata azzurro (per il fissaggio definitivo della ricostruzione) **Materiale** Lega di titanio	J4012.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
		J4012.2001	5.0 mm 6.0 mm	M2.0
	Vite protesica da laboratorio per pilastro a barra, hex, anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	J4013.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6
		J4013.2001	5.0 mm 6.0 mm	M2.0

Per le basi in titanio devono essere utilizzate “viti per abutment CONELOG® per basi in titanio CAD/CAM CONELOG®, anodizzate viola scuro“ (vedere pagina 67).

Per serrare le viti per abutment CONELOG® (M1.6/M2.0) si utilizzano i cacciaviti Ballpoint (in caso di canale della vite angolato) e i cacciaviti, hex (in caso di canale della vite diritto) (vedere pagina 86).

Le viti da laboratorio non devono essere utilizzate sul paziente!

Strumenti protesici

	Articolo	Misura	Art. n°	L
	Chiave dinamometrica fino a max. 30 Ncm **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5320.1030	-
	**Cacciavite** hex, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	extra corto	J5317.0510	14.5 mm
		corto	J5317.0501	22.5 mm
		lungo	J5317.0502	30.3 mm
	**Cacciavite** hex, gambo ISO **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5317.0504	18.0 mm
		lungo	J5317.0503	26.0 mm
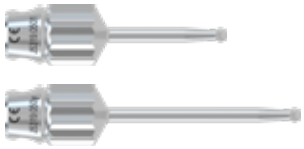	**Cacciavite Ballpoint** hex, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5319.0501*	24 mm
		lungo	J5319.0502*	32 mm
	Cacciavite Ballpoint hex, gambo ISO **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5319.0504*	27 mm
		lungo	J5319.0503*	35 mm
	Cacciavite manuale hex, senza attacco per testa a cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5317.0511	23.0 mm

* Da utilizzare solo con canale della vite angolato

	Articolo	Misura	Art. n°	Ø	Filettatura	L
	Estrattore CONELOG® per abutment CONELOG® **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	C5300.1601	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6	-
			C5300.2001	5.0 mm	M2.0	
		lungo	C5300.1603	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	M1.6	-
			C5300.2003	5.0 mm	M2.0	
	**Inseritore per pilastri a barra diritti** **Materiale** Acciaio inossidabile	corto	J5300.0020	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	-	18.6 mm
			J5300.0025	5.0 mm		
		lungo	J5300.0021	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	-	28.0 mm
	**Inseritore per transfer da impronta e cappette di guarigione per pilastri a barra** **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5300.0027	3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm	-	19.1 mm
			J5300.0028	5.0 mm		
	Inseritore per pilastro a sfera, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	-	J5300.0011	-	-	18.3 mm
	Cacciavite Attivatore per matrice di pilastro a sfera CM Dalbo®-Plus **Materiale** Acciaio inossidabile	-	07000389	-	-	-

Strumenti protesici

	Articolo	Quantità	Art. n°	L
	Inseritore per Locator®, manuale/cricchetto **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0001	24.3 mm
	Strumento Locator® in 3 parti **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0002	83.0 mm
	Guaina per sostegno per pilastri Locator® per componenti dorati dello strumento Locator® **Materiale** Polisolfone	4	08394	-
	Calibro per misura angolare Locator® **Materiale** Acciaio inossidabile	1	J2253.0003	-
	Perno per misura angolare Locator® **Materiale** Polietilene	4	J2253.0004	-
	Strumento per inserto di ritenzione Locator R-Tx® con maniglia in plastica **Materiale** Acciaio inossidabile	1	30021-01	-
	Tray per componenti protesici universale (senza contenuto) risterilizzabile **Materiale** Radel®, silicone	1	J5330.8700	162 × 73 × 29 mm

Strumenti odontotecnici

	Articolo	Art. n°	Ø
	Strumento manuale per analogo d'impianto **Materiale** Acciaio inossidabile	J3025.0010	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
		J3025.0015	5.0 mm
	Supporto universale incl. 2 viti da laboratorio CONELOG®, hex, e 1 alloggiamento per abutment CONELOG® Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm **Materiale** Acciaio inossidabile/Lega di titanio	C3709.0010	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
			5.0 mm
	Supporto universale **Materiale** Acciaio inossidabile	J3709.0015	-
	Alloggiamento per abutment CONELOG® per supporto universale **Materiale** Lega di titanio	C3709.3300	3.3 mm
		C3709.3800	3.8 mm
		C3709.4300	4.3 mm
		C3709.5000	5.0 mm
	Strumento di finitura, base per pilastro a barra superficie piana/cono, per cappette calcinabili **Materiale** Acciaio inossidabile/Ottone	J3711.0010	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
		J3711.0015	5.0 mm
			6.0 mm
	Strumento di finitura, base per pilastro a barra sede vite, per cappette calcinabili **Materiale** Acciaio inossidabile/Ottone	J3711.0020	3.3 mm
			3.8 mm
			4.3 mm
		J3711.0025	5.0 mm
			6.0 mm

Selezione dell’abutment

	Articolo	Art. n°
	Set di abutment per selezione dell’abutment CONELOG® (Contenuto: 2 unità cad., secondo la tabella sottostante)	C8011.1000

Contenuto: set di abutment per selezione dell’abutment CONELOG®					
Articolo	Materiale	Ø			AG
Abutment per selezione di: CONELOG® Esthomic®, diritto*	POM	3.8 mm	4.3 mm	5.0 mm	1.5–2.5
					3.0–4.5
Abutment per selezione di: CONELOG® Esthomic®, angolato a 15°, tipo A*					1.5–2.5
Abutment per selezione di: CONELOG® Esthomic®, angolato a 15°, tipo B*					
Abutment per selezione di: CONELOG® Esthomic®, angolato a 20°, tipo A*					
Abutment per selezione di: CONELOG® Esthomic®, angolato a 20°, tipo B*					

* Questi prodotti non sono disponibili singolarmente.

Non utilizzare gli abutment per selezione sul paziente!

Articoli aggiuntivi

Impianti per esercitazione

	Articolo	Art. n°	Ø	L
	Impianto per esercitazione CONELOG® PROGRESSIVE-LINE incl. applicatore innestato e vite tappo, anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	C1901.3813	3.8 mm	13 mm
		C1901.4313	4.3 mm	
	Impianto per esercitazione CONELOG® SCREW-LINE incl. applicatore e vite tappo, anodizzata marrone **Materiale** Lega di titanio	C1069.3813	3.8 mm	13 mm
		C1069.4313	4.3 mm	

Non utilizzare gli impianti per esercitazione sul paziente!

Applicatore

	Articolo	Quantità	Art. n°	Ø
	Applicatore CONELOG®, avvitato per analogo d'impianto/analogo da laboratorio CONELOG®, incl. vite di ritenzione **Materiale** Lega di titanio	2	C2026.3303	3.3 mm
			C2026.3803	3.8 mm
			C2026.4303	4.3 mm
			C2026.5003	5.0 mm

Modelli dimostrativi

	Articolo	Art. n°
	**Modello dimostrativo CONELOG®, vetro acrilico** mascellare superiore, 4 impianti CONELOG® SCREW-LINE, 4 × Ø 4.3 mm **Materiale** Vetro acrilico/Titanio	C8070.1020
	Modello dimostrativo CONELOG®, vetro acrilico mascellare inferiore, 4 impianti CONELOG® SCREW-LINE, 4 × Ø 4.3 mm **Materiale** Vetro acrilico/Titanio	C8050.1040
	Mascellare inferiore edentulo incl. placca di montaggio **Materiale** Resina	J8070.2050

Macromodelli

	Articolo	Art. n°
	Macromodello CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Scala: 3:1 **Contenuto:** 1 impianto CONELOG® PROGRESSIVE-LINE 1 abutment CONELOG® Esthomic®, diritto 1 vite per abutment CONELOG®, hex 1 cacciavite, hex CONELOG® 1 premolare, adatto per abutment CONELOG® Esthomic®, diritto 1 supporto in vetro acrilico **Materiale** Resina/Acciaio inossidabile	C8010.1400
	Macromodello CONELOG® SCREW-LINE Scala: 3:1 **Contenuto:** 1 impianto CONELOG® SCREW-LINE 1 abutment CONELOG® Esthomic®, diritto 1 vite per abutment CONELOG®, hex 1 cacciavite, hex 1 premolare, adatto per abutment CONELOG® Esthomic®, diritto 1 supporto in vetro acrilico **Materiale** Resina/Acciaio inossidabile	C8010.1010

Letteratura

	Articolo	Documento n° / Art. n°
	Dente mancante o danneggiato? Ritrova il sorriso grazie alle moderne soluzioni odontoiatriche.	M-0446-FLY-IT-INT-BHCL-00-082021
	Denti mancanti? Scopri le nostre soluzioni confortevoli, affidabili ed estetiche.	M-0447-FLY-IT-INT-BHCL-00-082021
	Ritrova il sorriso. Soluzioni moderne per uno stile di vita sano.	M-0448-FLY-IT-INT-BHCL-00-082021
	Passaporto implantare Documentazione e scheda dell'impianto per il paziente	ML0180ITit REV A JUN 2021
	Poster Formato: 50 × 70 cm	M-0449-PST-IT-INT-BHCL-00-082021

Prospetto delle indicazioni

Ricostruzione di denti singoli		Ricostruzione
Cementata	**Avvitata**	**Cementata**
	Abutment provvisori, lega di titanio, corona	
Abutment Esthomic®		Abutment Esthomic®
	Pilastri a barra	
Base in titanio CAD/CAM, corona	Base in titanio CAD/CAM, corona	Base in titanio CAD/CAM, ponte
Basi in titanio CAD/CAM free	Basi in titanio CAD/CAM free	
Abutment universale CAM Blank		Abutment universale CAM Blank
Abutment in oro-resina	Abutment in oro-resina	Abutment in oro-resina

a ponte	Ricostruzioni ibride
Avvitata	**Mobile (protesi totale)**
Abutment provvisori, lega di titanio, ponte	
Pilastri a barra	Pilastri a barra
Base in titanio CAD/CAM, ponte	
	Sistema di ancoraggio Locator®
	Pilastro a sfera
	Ricostruzione a doppia corona Abutment universale CAM Blank
	Abutment telescopico
	Abutment in oro-resina
	Base in titanio CAD/CAM, corona

Panoramica degli impianti

PROGRESSIVE-LINE

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Articolo	Art. n°				L
Impianto CONELOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus con applicatore innestato	-	C1086.3807	C1086.4307	C1086.5007	7 mm
	C1086.3309	C1086.3809	C1086.4309	C1086.5009	9 mm
	C1086.3311	C1086.3811	C1086.4311	C1086.5011	11 mm
	C1086.3313	C1086.3813	C1086.4313	C1086.5013	13 mm
	C1086.3316	C1086.3816	C1086.4316	C1086.5016	16 mm
Impianto CONELOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus con applicatore avvitato	-	C1085.3807	C1085.4307	C1085.5007	7 mm
	C1085.3309	C1085.3809	C1085.4309	C1085.5009	9 mm
	C1085.3311	C1085.3811	C1085.4311	C1085.5011	11 mm
	C1085.3313	C1085.3813	C1085.4313	C1085.5013	13 mm
	C1085.3316	C1085.3816	C1085.4316	C1085.5016	16 mm

SCREW-LINE

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Articolo	Art. n°				L
Impianto CONELOG® SCREW-LINE, Promote® plus con applicatore innestato	-	C1066.3807	C1066.4307	C1066.5007	7 mm
	C1066.3309	C1066.3809	C1066.4309	C1066.5009	9 mm
	C1066.3311	C1066.3811	C1066.4311	C1066.5011	11 mm
	C1066.3313	C1066.3813	C1066.4313	C1066.5013	13 mm
	C1066.3316	C1066.3816	C1066.4316	C1066.5016	16 mm
Impianto CONELOG® SCREW-LINE, Promote® plus con applicatore avvitato	-	C1065.3807	C1065.4307	C1065.5007	7 mm
	C1065.3309	C1065.3809	C1065.4309	C1065.5009	9 mm
	C1065.3311	C1065.3811	C1065.4311	C1065.5011	11 mm
	C1065.3313	C1065.3813	C1065.4313	C1065.5013	13 mm
	C1065.3316	C1065.3816	C1065.4316	C1065.5016	16 mm

Prospetto dei componenti protesici

Presa d'impronta digitale

	Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	AG
		Art. n°				
	Scanbody CONELOG®	C2600.3310	C2600.4310	C2600.4310	C2600.5010	-
	Scanbody CONELOG® multiuso	C2630.3300	C2630.4300	C2630.4300	C2630.5000	-
	ScanPost CONELOG® per Sirona®	C2620.3306	C2620.3806	C2620.4306	C2620.5006	-

Presa d'impronta convenzionale

	Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	AG
		Art. n°				
	Transfer da impronta CONELOG®, cilindrico, porta-impronte forato	C2125.3300	C2125.3800	C2125.4300	C2125.5000	-
	Transfer da impronta CONELOG®, cilindrico, porta-impronte chiuso	C2115.3300	C2115.3800	C2115.4300	C2115.5000	-
	Transfer da impronta CONELOG®, wide body, porta-impronte forato	C2124.3300	C2124.3800	C2124.4300	C2124.5000	-
	Transfer da impronta CONELOG®, wide body, porta-impronte chiuso	C2114.3300	C2114.3800	C2114.4300	C2114.5000	-

Registrazione del morso

	Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	AG
		Art. n°				
	Transfer per la registrazione del morso CONELOG® incl. vite di ritenzione e cappetta per la registrazione del morso, sterile	C2141.3300	C2141.3800	C2141.4300	C2141.5000	-

Prospetto dei componenti protesici

Realizzazione del modello

	Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	AG
		Art. n°				
	Analogo da laboratorio CONELOG® per modelli colati	C3010.3300	C3010.3800	C3010.4300	C3010.5000	-
		C3010.3303	C3010.3803	C3010.4303	C3010.5003	
	Analogo d'impianto CONELOG® per modelli stampati e colati	C3025.3300	C3025.3800	C3025.4300	C3025.5000	-
		C3025.3303	C3025.3803	C3025.4303	C3025.5003	
	DIM-Analog® per il sistema implantare CONELOG® per modelli stampati	COL 5.DIM.330	COL 5.DIM.384	COL 5.DIM.384	COL 5.DIM.500	-

Abutment per corone e ricostruzioni a ponte

	Articolo	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	AG
		Art. n°				
	Abutment provvisorio CONELOG®, per corona	C2239.3300	C2239.3800	C2239.4300	C2239.5000	-
	Abutment provvisorio CONELOG®, per ponte	C2339.3300	C2339.3800	C2339.4300	C2339.5000	-
	Abutment CONELOG® Esthomic®, diritti	-	C2226.3815	C2226.4315	C2226.5015	1.5–2.5 mm
			C2226.3830	C2226.4330	C2226.5030	3.0–4.5 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, Inset	C2235.3320	C2235.3820	C2235.4320	C2235.5020	2.0–3.3 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, angolati a 15°, tipo A	-	C2227.3815	C2227.4315	C2227.5015	1.5–2.5 mm
			C2227.3830	C2227.4330	C2227.5030	3.0–4.5 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, angolati a 15°, tipo B	-	C2228.3815	C2228.4315	C2228.5015	1.5–2.5 mm
			C2228.3830	C2228.4330	C2228.5030	3.0–4.5 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, angolati a 20°, tipo A	-	C2231.3815	C2231.4315	C2231.5015	1.5–2.5 mm
			C2231.3830	C2231.4330	C2231.5030	3.0–4.5 mm
	Abutment CONELOG® Esthomic®, angolati a 20°, tipo B	-	C2232.3815	C2232.4315	C2232.5015	1.5–2.5 mm
			C2232.3830	C2232.4330	C2232.5030	3.0–4.5 mm

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Articolo	Art. n°				AG
Abutment universale CONELOG®	C2211.3300	C2211.3800	C2211.4300	C2211.5000	-
Abutment in oro-resina CONELOG®	C2246.3300	C2246.3800	C2246.4300	C2246.5000	-
Base in titanio CAD/CAM CONELOG®, corona	C2242.3308	C2242.3808	C2242.4308	C2242.5008	0.8 mm
	C2242.3320	C2242.3820	C2242.4320	C2242.5020	2.0 mm
Base in titanio CAD/CAM CONELOG®, ponte	C2342.3308	C2342.3808	C2342.4308	C2342.5008	0.8 mm
	C2342.3320	C2342.3820	C2342.4320	C2342.5020	2.0 mm
Base in titanio CONELOG® CAD/CAM free, per corona, corta	C2247.3308	-	-	-	0.8 mm
	-	C2247.3808	C2247.4308	C2247.5008	1.0 mm
	C2247.3320	C2247.3820	C2247.4320	C2247.5020	2.0 mm
Base in titanio CONELOG® CAD/CAM free, per corona, lunga	-	C2265.3808	C2265.4308	C2265.5008	1.0 mm
	-	C2265.3820	C2265.4320	C2265.5020	2.0 mm

Prospetto dei componenti protesici

Pilastri COMFOUR®

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Articolo	Art. n°				AG
Pilastri a barra CONELOG®, diritti	C2254.3310	C2254.3810	C2254.4310	C2254.5010	1.0 mm
	C2254.3325	C2254.3825	C2254.4325	C2254.5025	2.5 mm
	-	C2254.3840	C2254.4340	C2254.5040	4.0 mm
Pilastri a barra CONELOG®, angolati a 17°, tipo A	C2256.3325	C2256.3825	C2256.4325	C2256.5025	2.5 mm
	C2256.3340	C2256.3840	C2256.4340	C2256.5040	4.0 mm
Pilastri a barra CONELOG®, angolati a 17°, tipo B	C2257.3325	C2257.3825	C2257.4325	C2257.5025	2.5 mm
	C2257.3340	C2257.3840	C2257.4340	C2257.5040	4.0 mm
Pilastri a barra CONELOG®, angolati a 30°, tipo A	C2258.3325	C2258.3825	C2258.4325	C2258.5035	2.5 mm/ 3.5 mm*
	C2258.3340	C2258.3840	C2258.4340	C2258.5050	4.0 mm/ 5.0 mm*
Pilastri a barra CONELOG®, angolati a 30°, tipo B	C2259.3325	C2259.3825	C2259.4325	C2259.5035	2.5 mm/ 3.5 mm*
	C2259.3340	C2259.3840	C2259.4340	C2259.5050	4.0 mm/ 5.0 mm*
Cappetta di guarigione per pilastro a barra	J2029.4300	J2029.4300	J2029.4300	J2029.6000	-
Cappetta per presa d'impronta, corta, per pilastro a barra, porta-impronte chiuso	J2129.4300	J2129.4300	J2129.4300	J2129.6000	-
Cappetta per presa d'impronta, lunga, per pilastro a barra, porta-impronte chiuso (ponte/barra)	J2129.4310	J2129.4310	J2129.4310	J2129.6010	-
Cappetta di scansione per pilastri a barra	J2610.4300	J2610.4300	J2610.4300	J2610.6000	-
Cappetta di scansione per pilastri a barra CAMLOG®/CONELOG®	J2630.4300	J2630.4300	J2630.4300	J2630.6000	-
Cappetta in titanio per pilastro a barra, per corona	J2259.4301	J2259.4301	J2259.4301	J2259.6001	-
Cappetta in titanio per pilastro a barra, per ponte	J2259.4302	J2259.4302	J2259.4302	J2259.6002	-
Cappetta in titanio senza ritenzione per pilastro a barra, per ponte	J2259.4322	J2259.4322	J2259.4322	J2259.6022	-
Base per corona per pilastro a barra, calcinabile	J2256.4306	J2256.4306	J2256.4306	J2256.6006	-
Base per pilastro a barra, calcinabile	J2257.4301	J2257.4301	J2257.4301	J2257.6001	-

* AG 3.5 e 5.0 mm solo per Ø 5.0 mm

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Articolo	Art. n°				AG
Base per pilastro a barra, da sovrafusione	J2263.4300	J2263.4300	J2263.4300	J2263.6000	-
Base per pilastro a barra, brasabile	J2258.4300	J2258.4300	J2258.4300	J2258.6000	-
Base per pilastro a barra, titanio, saldabile al laser	J2262.4300	J2262.4300	J2262.4300	J2262.6000	-
Base adesiva in titanio per pilastro a barra, Passive-Fit	J2260.4301	J2260.4301	J2260.4301	J2260.6001	-
Cappetta per base adesiva in titanio, calcinabile, Passive-Fit	J2261.4301	J2261.4301	J2261.4301	J2261.6001	-

Ricostruzioni ibride

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Articolo	Art. n°				AG
Pilastro a sfera CONELOG®, patrice	C2249.3315	C2249.3815	C2249.4315	C2249.5015	1.5 mm
	C2249.3330	C2249.3830	C2249.4330	C2249.5030	3.0 mm
	-	C2249.3845	C2249.4345	C2249.5045	4.5 mm
Matrice CM Dalbo®-Plus	05003503	05003503	05003503	05003503	-
Analogo del pilastro a sfera	C3015.3300	C3015.3300	C3015.3300	C3015.5000	-
Pilastro CONELOG® Locator®	C2253.3310	C2253.3810	C2253.4310	C2253.5010	1.0 mm
	C2253.3320	C2253.3820	C2253.4320	C2253.5020	2.0 mm
	C2253.3330	C2253.3830	C2253.4330	C2253.5030	3.0 mm
	C2253.3340	C2253.3840	C2253.4340	C2253.5040	4.0 mm
	-	C2253.3850	C2253.4350	C2253.5050	5.0 mm
Cappetta per presa d'impronta Locator®	J2253.0200	J2253.0200	J2253.0200	J2253.0200	-
Analogo Locator®	J2253.0340	J2253.0340	J2253.0340	J2253.0340	-
Set da laboratorio Locator®	J2253.0102	J2253.0102	J2253.0102	J2253.0102	-
Set da laboratorio Locator® per angolazione estesa	-	J2253.0112	J2253.0112	J2253.0112	-

Prospetto dei componenti protesici

Ricostruzioni ibride

		Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Articolo		Art. n°				AG
	Inserto di ritenzione Locator® trasparente, forte	J2253.1005	J2253.1005	J2253.1005	J2253.1005	-
	Inserto di ritenzione Locator® rosa, medio	J2253.1003	J2253.1003	J2253.1003	J2253.1003	-
	Inserto di ritenzione Locator® blu, leggero	J2253.1002	J2253.1002	J2253.1002	J2253.1002	-
	Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa, verde, forte	-	J2253.2004	J2253.2004	J2253.2004	-
	Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa, arancio, medio	-	J2253.2003	J2253.2003	J2253.2003	-
	Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa, rosso, leggero	-	J2253.2002	J2253.2002	J2253.2002	-
	Inserto di ritenzione Locator® per angolazione estesa, grigio, nessuna ritenzione	-	J2253.2000	J2253.2000	J2253.2000	-
	Pilastro CONELOG® Locator R-Tx®	30805-01	30806-01	30807-01	30808-01	1.0 mm
		30805-02	30806-02	30807-02	30808-02	2.0 mm
		30805-03	30806-03	30807-03	30808-03	3.0 mm
		30805-04	30806-04	30807-04	30808-04	4.0 mm
		-	30806-05	30807-05	30808-05	5.0 mm
	Cappetta per presa d'impronta Locator R-Tx®	30017-01	30017-01	30017-01	30017-01	-
	Analogo Locator R-Tx®	30014-01	30014-01	30014-01	30016-01	-
	Alloggiamento di ritenzione Locator R-Tx®	30013-01	30013-01	30013-01	30013-01	-
	Inserto di lavorazione Locator R-Tx®	30012-01	30012-01	30012-01	30012-01	-
	Distanziale da laboratorio/ausilio di duplicazione Locator R-Tx®	30018-01	30018-01	30018-01	30018-01	-
	Inserto di ritenzione Locator R-Tx®, grigio, nessuna ritenzione	30001-01	30001-01	30001-01	30001-01	-
	Inserto di ritenzione Locator R-Tx®, blu, leggero	30002-01	30002-01	30002-01	30002-01	-
	Inserto di ritenzione Locator R-Tx®, rosa, medio	30003-01	30003-01	30003-01	30003-01	-
	Inserto di ritenzione Locator R-Tx®, bianco, forte	30004-01	30004-01	30004-01	30004-01	-
	Abutment universale CONELOG®	-	C2211.3800	C2211.4300	C2211.5000	-
	Abutment telescopico CONELOG®	-	C2212.3800	C2212.4300	C2212.5000	-

CAM Blank

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
Articolo	Art. n°				AG
CONELOG® CAM Blank in titanio, tipo IAC	C2431.3313	C2431.3813	C2431.4313	C2431.5013	-
	C2432.3313	C2432.3813	C2432.4313	C2432.5013	
CONELOG® CAM Blank in titanio, tipo ME	C2441.3320	C2441.3820	C2441.4320	C2441.5020	-
	C2442.3320	C2442.3820	C2442.4320	C2442.5020	
CONELOG® CAM Blank in CoCr, tipo ME	C2461.3320	C2461.4320	C2461.4320	C2461.5020	-
CONELOG® CAM Blank in titanio, tipo AG	C2471.3327	C2471.3827	C2471.4327	C2471.5027	-

Componenti protesici CAD/CAM DEDICAM® di Camlog
I servizi DEDICAM® non sono disponibili integralmente in tutti i paesi. Per eventuali domande rivolgetevi al vostro referente BioHorizons/ Camlog locale.

Prospetto delle viti Viti per abutment e protesiche - uso intraorale

Connessione impianto-abutment

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
	M1.6			M2.0	
Articolo	**Vite per abutment CONELOG®**				**Torque di serraggio**
Scanbody **ScanPost per Sirona®**					manual-mente**
Abutment provvisori in titanio, corona e ponte					
Abutment Esthomic®		8.9 mm C4005.1601		8.9 mm C4005.2001	20 Ncm*
Abutment universale **Abutment telescopico** **Abutment in oro-resina**					
Base in titanio CONELOG® CAD/CAM free, corona					
Monconi CAM CONELOG® Tipo AG, ME e IAC					
	Viti per abutment CONELOG® per base in titanio CAD/CAM, anodizzate viola scuro				
Base in titanio CAD/CAM, corona e ponte		8.9 mm C4015.1601		8.9 mm C4015.2001	20 Ncm*
	Viti per abutment CONELOG® con testa ridotta, anodizzate azzurro				
COMFOUR® Pilastri a barra, angolati a 17° e 30°		7.8 mm C4004.1601		7.8 mm C4004.2001	20 Ncm*

* con chiave dinamometrica J5320.1030

** facoltativo per abutment provvisori in titanio: torque di serraggio 20 Ncm ad avvenuta fase di guarigione

Il serraggio di tutte le viti deve essere ripreso almeno dopo 5 minuti con il corrispondente torque!

Connessione abutment-protesi

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
	M1.6			M2.0	
Articolo	**Viti protesiche per pilastri a barra, anodizzate azzurro**				**Torque di serraggio**
Cappette e basi per pilastri a barra	3.6 mm J4012.1601			3.8 mm J4012.2001	15 Ncm*
COMFOUR® Pilastri a barra diritti, angolati a 17° e 30°					

Prospetto delle viti ausiliarie Uso intraorale ed extraorale

Connessione abutment-protesi

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
	M1.6			M 2.0	
Articolo	**Viti protesiche per pilastri a barra, anodizzate azzurro**				**Torque di serraggio**
Cappette di scansione per pilastri a barra	3.6 mm J4012.1601			3.8 mm J4012.2001	manual-mente
	Viti per pilastri a barra, per presa d'impronta con porta-impronte forato e per brasatura, anodizzate azzurro				
COMFOUR® Pilastri a barra, diritti, angolati a 17° e 30°	12 mm J4012.1610			12.2 mm J4012.2010	manual-mente
	17 mm J4012.1615			17.2 mm J4012.2015	
	22 mm J4012.1620			22.2 mm J4012.2020	
	Viti in resina per pilastro a barra, come ausilio per fissaggio e incollaggio, beige				
	29 mm J4009.1627			29.2 mm J4009.2027	manual-mente

* con chiave dinamometrica J5320.1030

Il serraggio di tutte le viti deve essere ripreso almeno dopo 5 minuti con il corrispondente torque!

Prospetto delle viti Viti da laboratorio – uso extraorale

Connessione analogo da laboratorio-abutment

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
	M1.6			M2.0	
Articolo	**Viti da laboratorio* CONELOG®, anodizzate marrone**				**Torque di serraggio**
Scanbody **ScanPost per Sirona®**	8.9 mm C4006.1601			8.9 mm C4006.2001	manual-mente
Abutment provvisori in titanio, corona e ponte					
Abutment Esthomic®					
Abutment universale **Abutment telescopico** **Abutment in oro-resina**					
Base in titanio CONELOG® CAD/CAM free, corona					
Monconi CAM CONELOG® Tipo AG, ME e IAC					
	Viti da laboratorio* CONELOG® per base in titanio CAD/CAM, parzialmente anodizzate marrone				
Base in titanio CAD/CAM, corona e ponte	8.9 mm C4016.1601			8.9 mm  C4016.2001	manual-mente
	Ausili per incollaggio CONELOG®				
Base in titanio CAD/CAM, corona e ponte	26 mm C4019.1600			26 mm C4019.2000	manual-mente
	Viti da laboratorio* CONELOG® con testa ridotta, parzialmente anodizzate azzurro				
COMFOUR® Pilastri a barra, angolati a 17° e 30°	7.8 mm  C4004.1600			7.8 mm C4004.2000	manual-mente

* Le viti da laboratorio non devono essere utilizzate sul paziente!

Connessione abutment-protesi

		Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	
		M1.6			M2.0	
	Articolo	**Viti protesiche da laboratorio* per pilastri a barra, anodizzate marrone**				**Torque di serraggio**
	Cappette di scansione per pilastri a barra					
	COMFOUR® Pilastri a barra, diritti, angolati a 17° e 30°		3.6 mm J4013.1601		3.8 mm J4013.2001	manual-mente
	Analogo da laboratorio a barra per pilastri a barra					
		Viti protesiche per pilastri a barra*, per realizzare la modellazione sulla cappetta calcinabile per base adesiva in titanio, Passive-Fit, sull'analogo da laboratorio a barra				
	Base adesiva in titanio per pilastro a barra e cappetta per base adesiva in titanio calcinabile, Passive-Fit		5.5 mm J4005.1602		5.5 mm J4005.2002	manual-mente

* Le viti da laboratorio non devono essere utilizzate sul paziente!

Prospetto dei torque di serraggio

Articolo	Strumenti	Torque di serraggio
Vite tappo dell'impianto	J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502 J5317.0504 J5317.0503	manual-mente*
Cappetta di guarigione cilindrica, wide body, bottleneck		
Scanbody CONELOG® Scanbody CONELOG® multiuso ScanPost per Sirona®		
Transfer da impronta Transfer per la registrazione del morso		
Abutment provvisorio, corona e ponte		
Base in titanio CAD/CAM, corona e ponte		20 Ncm
Abutment universale Abutment telescopico Abutment in oro-resina		
Abutment Esthomic®, diritto, angolato a 15° e 20° Abutment Esthomic®, Inset		
Moncone CAM CONELOG® Tipo IAC, ME e AG		

* facoltativo per abutment provvisori in titanio: torque di serraggio 20 Ncm ad avvenuta fase di guarigione

Il serraggio di tutte le viti deve essere ripreso almeno dopo 5 minuti con il corrispondente torque!

Articolo	Strumenti	Torque di serraggio
Base in titanio CONELOG® CAD/CAM free, corona	J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502 J5317.0504 J5317.0503 J5319.0501* J5319.0502* J5319.0504* J5319.0503*	20 Ncm

* Da utilizzare solo con canale della vite angolato

Prospetto dei torque di serraggio

	Ø 3.3 mm	Ø 3.8 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.0 mm	3.3	3.8	4.3	5.0
Articolo	**Strumenti**				**Torque di serraggio**			
Pilastri a barra, diritti	J5300.0020 J5300.0021			J5300.0025	20 Ncm*		30 Ncm*	
Pilastri a barra, angolati a 17° e 30°	J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502 J5317.0504 J5317.0503				20 Ncm*			
Cappetta di guarigione per pilastro a barra					manualmente			
Cappette di scansione per pilastro a barra								
Cappette in titanio per pilastro a barra, corona/ponte					15 Ncm*			
Base per corona per pilastro a barra, calcinabile								
Basi per pilastri a barra, calcinabile, da sovrafusione, brasabile, saldabile al laser								
Base adesiva in titanio per pilastro a barra, Passive-Fit								
Pilastri Locator R-Tx®					20 Ncm*		30 Ncm*	
Cappetta per presa d'impronta per pilastro a barra, porta-impronte chiuso (ponte/barra)	J5300.0027 J5300.0028				manualmente			
Pilastri a sfera	J5300.0011				20 Ncm*		30 Ncm*	
Pilastri Locator®	J2253.0001							

* con chiave dinamometrica J5320.1030

Il serraggio di tutte le viti deve essere ripreso almeno dopo 5 minuti con il corrispondente torque!

Materiali

Titanio grado 4			
Proprietà (ASTM F67 e DIN EN ISO 5832-2)			
Composizione chimica (in %)	O	≤	0.4
	Fe	≤	0.5
	C	≤	0.08
	N	≤	0.05
	H	≤	0.0125
	Ti		Residui
Proprietà meccaniche Proprietà	Resistenza a trazione	≥	550 MPa
	Allungamento alla rottura	≥	12%

Lega di titanio Ti-6Al-4V ELI			
Proprietà (ASTM F136)			
Composizione chimica (in %)	Al		5.5–6.5
	V		3.5–4.5
	Fe	≤	0.25
	C	≤	0.08
	N	≤	0.05
	O	≤	0.13
	H	≤	0.012
	Ti		Residui
Proprietà meccaniche	Resistenza a trazione	≥	860 MPa
	Allungamento alla rottura	≥	10%

Lega aurea per la tecnica di sovrafusione Abutment in oro-resina CONELOG®		
Proprietà		
Composizione chimica (in %)	Au	60
	Pd	20
	Pt	19
	Ir	1
Proprietà fisiche	Intervallo di fusione	1400–1490 °C
	Densità	17.5 g/cm³
	Modulo di elasticità	136 GPa
	Coefficiente di dilatazione termica (25–500 °C)	11.9 10^{-6} K^{-1}
	Coefficiente di dilatazione termica (25–600 °C)	12.2 10^{-6} K^{-1}
	Colore	bianco
Proprietà meccaniche	Stato	lavorato a freddo
	Durezza HV5	> 215
	Resistenza alla trazione (Rm)	> 750 MPa
	0.2% limite di allungamento (Rp 0.2%)	> 650 MPa
	Allungamento alla rottura	> 2%

Lega aurea per la tecnica di sovrafusione Base per pilastro a barra		
Proprietà		
Composizione chimica (in %)	Au	60
	Pt	19
	Pd	20
	Ir	1
Proprietà fisiche	Densità	17.5 g/cm³
	Colore	bianco
	Fase liquida	1490 °C
	Fase solida	1400 °C
	Coefficiente di dilatazione termica (25–500 °C)	12.5 10^{-6} K^{-1}
	Coefficiente di dilatazione termica (25–600 °C)	12.6 10^{-6} K^{-1}
	Modulo di elasticità	136 GPa
Proprietà meccaniche		dopo tempera 700 °C/30 min
	Durezza HV5	210
	0.2% limite di allungamento	450–570 MPa
	Allungamento alla rottura	min. 10%
	Resistenza a trazione MPa	530–650

Lega aurea brasabile Base per pilastro a barra		
Proprietà		
Composizione chimica (in %)	Au	68.60
	Pt	2.45
	Ag	11.85
	Pd	3.95
	Cu	10.60
	Zn	2.50
	Ir	0.05
	Rh	-
	Ru	-
Proprietà fisiche	Colore	giallo
	Intervallo di fusione	880–940 °C
Proprietà meccaniche	Durezza	
	dopo ricottura di addolcimento HV5	175
	dopo tempera HV5	275
	dopo autotempera HV5	240

Lega CoCr		
Proprietà (ASTM F1537-20 e ISO 5832-12)		
Composizione chimica (in peso %)	Cr	26.0–30.0
	Mo	5.0–7.0
	Fe	≤ 0.75
	Ni	≤ 0.1*
	Mn	< 1.0
	Si	< 1.0
	N	< 0.25
	C	≤ 0.14
	Co	Residui
Proprietà fisiche	Coefficiente di dilatazione termica (25–500 °C)	14.2–14.4 10^{-6} K^{-1}
Proprietà meccaniche	Resistenza a trazione	> 827 MPa
	Resistenza a rottura	1172–1400 MPa
	Allungamento alla rottura	> 12%
	Durezza (HRC)	38–48

* ASTM F1537-20 e ISO 5832-12: ≤ 1.0 peso %

Documentazione supplementare

Per ulteriori informazioni sui prodotti CONELOG® si rimanda ai seguenti documenti:
- Istruzioni operative CONELOG®
- Istruzioni per l'uso CONELOG®
- Istruzioni di ricondizionamento
- Prospetto della letteratura Camlog
- Clinical evidence and science

Questa documentazione può essere richiesta presso il rispettivo referente Camlog locale.

Consultare anche i siti:
https://ifu.camlog.com
www.camlog.com

Italia: www.biohorizonscamlog.it
Svizzera: www.camlog.ch

Bibliografia

[1] Conserva E. Initial stability after placement of a new buttress-threaded implant. A case series study. Implants. 2019(3): 24-28.
[2] Ruppin J. One-year clinical experience with Progressive-Line implants. EDI journal. 2020(4): 54-63.
[3] CAMLOG® IMPLANT SYSTEM/CONELOG® IMPLANT SYSTEM – Die Promote® Oberfläche – eine hochmoderne Titanoberfläche für die Implantologie. M-0173-WPR-DACH-CL-00-022022.
[4] Semper-Hogg W, Kraft S, Stiller S, Mehrhof J, Nelson K. Analytical and experimental position stability of the abutment in different dental implant systems with a conical implant-abutment connection. Clin Oral Investig. 2013;17(3): 1017-23.
[5] Semper-Hogg W, Zulauf K, Mehrhof J, Nelson K. The influence of torque tightening on the position stability of the abutment in conical implant-abutment connections. Int J Prosthodont 2015;28(5):538-41.

Note legali

Esclusione di responsabilità generale
Le informazioni qui fornite hanno esclusivamente finalità commerciali e non istruiscono l'utilizzatore sull'uso dei prodotti in ambito clinico. Per la corretta applicazione dei prodotti, consultare le corrispondenti istruzioni per l'uso e le istruzioni di lavoro prima dell'uso.

Marchi e copyright

Le denominazioni commerciali protette (marchi) non vengono indicate sempre in modo particolare. La mancanza di indicazioni di tale sorta NON implica comunque che si tratti di denominazioni commerciali non protette. Il documento, incluse tutte le sue parti, è protetto da copyright. Il relativo contenuto può essere scaricato per l'uso conforme alla destinazione prevista, tuttavia sono vietate le modifiche o la riproduzione del contenuto. Qualsiasi utilizzo al di fuori dei limiti previsti dalla legge sul copyright senza previa autorizzazione scritta di CAMLOG Biotechnologies GmbH è vietato ed è perseguibile penalmente.

CAMLOG®, COMFOUR®, CONELOG®, DEDICAM®, Esthomic® e Promote® sono marchi registrati di CAMLOG Biotechnologies GmbH. Locator®, Locator R-Tx®, R-Tx, ZEST e Zest Dental Solutions, come pure il colore e la forma degli inserti di ritenzione sono marchi registrati di ZEST IP Holdings, LLC. Dalbo®-Plus è un marchio registrato della società Cendres + Métaux SA, Biel, Svizzera.

I marchi indicati potrebbero non essere registrati in tutti i paesi. Tutti i marchi di terzi appartengono ai rispettivi proprietari. CAMLOG Biotechnologies GmbH può commercializzare i prodotti solo a fronte dell'approvazione delle autorità nazionali competenti. Pertanto, i prodotti e i servizi non sono disponibili integralmente in tutti i paesi.

Fabbricante
I prodotti CAMLOG® e CONELOG® sono fabbricati da:
ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Germania
I prodotti DEDICAM® sono fabbricati da:
ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Germania e
Biotech Dental Digital SAS | 305 Allées de Craponne | 13300 Salon de Provence | Francia
Locator® e Locator R-Tx® sono fabbricati da Zest Anchors LLC.
Dalbo®-Plus è fabbricato da Cendres + Métaux SA, Biel, Svizzera.

Appunti

Appunti

CE 0123

Art.-Nr. J8001.0011 Rev. 09 05/2024

Svizzera
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Svizzera
Telefono +41 61 565 41 41 | Fax +41 61 565 41 42 | sales.ch@camlog.com | www.camlog.ch

Italia
BioHorizons Camlog Italia | Via Ettore Cristoni, 88 | 40033 Casalecchio di Reno (BO) | Italia
marketing.italia@biohorizons.com | www.biohorizonscamlog.it
Servizio Clienti: Numero Verde 800063040 | ordini@biohorizons.com

Headquarters
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Svizzera
Telefono +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

Inspiring excellence in oral reconstruction

biohorizons camlog